



# HistoCore SPECTRA ST

## Fargemaskin



Brukerhåndbok  
Norsk

**Bestillingsnr.: 14 0512 80110- Revisjon R**

Oppbevar alltid brukerhåndboken sammen med instrumentet.  
Les håndboken nøye før instrumentet tas i bruk.

CE



Informasjonen, de numeriske dataene, merknadene og verdivurderingene i denne brukerhåndboken er basert på nåværende status for vitenskapelig kunnskap og den nyeste teknologien slik vi oppfatter det etter grundige undersøkelser på dette feltet.

Vi er ikke forpliktet til å oppdatere den nåværende brukerhåndboken med jevne mellomrom og på løpende basis i takt med den nyeste teknologiske utviklingen, heller ikke å gi kundene ekstra eksemplarer, oppdateringer osv. av denne brukerhåndboken.

Vi fraskriver oss ansvaret for feilaktige opplysninger, tekniske illustrasjoner osv. i denne brukerhåndboken, i den grad dette tillates i henhold til de nasjonale lover som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Særlig fraskriver vi oss alt ansvar for eventuelle økonomiske tap eller skader som skyldes eller har å gjøre med overholdelse av erklæringer eller annen informasjon i denne brukerhåndboken.

Påstander, tegninger, illustrasjoner og annen informasjon som gjelder innholdet eller de tekniske detaljene i denne brukerhåndboken, må ikke anses for å være garanterte egenskaper for våre produkter.

Disse reguleres utelukkende av vilkårene i kontrakten mellom oss og våre kunder.

Leica forbeholder seg retten til å endre de tekniske spesifikasjonene og produksjonsprosessene uten forvarsel. Bare på denne måten er det mulig å gjøre kontinuerlige forbedringer i teknologien og produksjonsteknikkene som benyttes i våre produkter.

Dette dokumentet er beskyttet av lov om opphavsrett. Alle opphavsrettigheter knyttet til denne dokumentasjonen, tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH.

En eventuell reproduksjon av tekst og illustrasjoner (eller deler av disse) i form av utskrift, fotokopiering, mikrofiche, webkameraer eller andre reproduksjonsmetoder – herunder bruk av elektroniske systemer og medier – krever at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Instrumentets serienummer og produksjonsår står oppgitt på merkeplaten på baksiden av instrumentet.



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Strasse 17 - 19  
69226 Nussloch  
Tyskland  
Tlf.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Faks: +49 - (0) 6224 - 143 268  
Internett: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)

# Innholdsfortegnelse

---

<b>1.</b>	<b>Viktig informasjon .....</b>	<b>7</b>
1.1	Symboler og betydninger .....	7
1.2	Instrumentmodell.....	11
1.3	Brukergruppe .....	11
1.4	Tiltenkt bruk .....	11
1.5	Opphavsrett – instrumentets programvare .....	12
<b>2.</b>	<b>Sikkerhet .....</b>	<b>13</b>
2.1	Sikkerhetsmerknader .....	13
2.2	Advarsler.....	14
2.3	Sikkerhetsanordninger på instrumentet .....	17
<b>3.</b>	<b>Instrumentkomponenter og -spesifikasjoner .....</b>	<b>18</b>
3.1	Standard levering .....	18
3.2	Spesifikasjoner .....	19
3.3	Generell oversikt – sett forfra .....	21
3.4	Generell oversikt – sett bakfra .....	22
3.5	Generell oversikt – sett innenfra .....	23
<b>4.</b>	<b>Installasjon og oppstart.....</b>	<b>24</b>
4.1	Krav til installasjonsstedet .....	24
4.2	Skyllevannstilkobling.....	25
4.2.1	Knutepunktsforbindelse for alle seks skyllevannstasjoner.....	26
4.2.2	Kombinert tilkobling 4+2 skyllevannstasjoner .....	26
4.2.3	Spillvannstilkobling .....	28
4.3	Strømtilkobling .....	28
4.3.1	Bruk av avbruddsfri strømforsyning (UPS) .....	29
4.4	Avtrekkslufttilkobling .....	30
4.5	Slå instrumentet på og av .....	31
<b>5.</b>	<b>Drift .....</b>	<b>33</b>
5.1	Brukergrensesnitt – oversikt.....	33
5.2	Elementene i statusvisningen .....	34
5.3	Prosesstatusvisning.....	35
5.4	Vise skuffene .....	37
5.5	Hovedmeny – oversikt .....	38
5.5.1	Tastaturet .....	39
5.6	Brukerinnstillinger .....	40
5.7	Grunninnstillinger .....	42
5.7.1	Språkkinnstillinger .....	43
5.7.2	Regionale innstillinger .....	44
5.7.3	Dato og klokkeslett .....	45
5.7.4	Meny for alarmlyder – Feil- og signallyder .....	45
5.7.5	Ovnsinnstillinger .....	47
5.7.6	Bevegelseshastighet – opp/ned-bevegelse (omrøring) .....	48
5.7.7	Datastyring .....	49
5.7.8	Servicetilgang .....	54
5.7.9	Hendelsesvisning .....	55
5.7.10	Nettverksinnstillinger .....	56
5.8	Reagensliste .....	57

# Innholdsfortegnelse

---

5.8.1 Kopiere en reagens .....	60
5.8.2 Endre RSS-data for en reagens .....	60
5.8.3 Behandlingsklasser .....	61
5.9 Fargeprogrammer .....	63
5.9.1 Tilordner en stativhåndtaksfarge til et fargeprogram .....	65
5.9.2 Leica-fageprogrammer (forhåndsinstallert) .....	66
5.9.3 Tilpassing av Leica H&E fageprogram .....	68
5.9.4 Brukerdefinerte fageprogrammer .....	69
5.9.5 Opprette eller kopiere et nytt fageprogram .....	69
5.9.6 Legge til eller kopiere et nytt programtrinn .....	72
5.9.7 Endre rekkefølge på programtrinn .....	74
5.9.8 Prioritering av programmer for utføring av fargebadlayouten .....	75
5.9.9 Utføre fargebadlayout .....	76
5.9.10 Fylle reagenser etter utføring av fargebadlayout .....	77
5.9.11 Tilpassing av fargebadlayout .....	83
<b>6. Daglig oppsett av instrumentet .....</b>	<b>87</b>
6.1 Klargjøre instrumentet for daglig oppsett .....	87
6.2 Daglig oppsett av instrumentet .....	88
6.2.1 Klargjøring og håndtering av reagensbeholdere .....	88
6.2.2 Automatisk skanning av påfyllingsnivå .....	90
6.3 Reagensstyringssystem (RSS) .....	91
6.4 Stasjonsdetaljer .....	93
6.5 Klargjøre stativet .....	98
6.6 Fageprosessen .....	102
6.6.1 Starte fageprosessen .....	102
6.6.2 Overvåking av fageprosessen .....	105
6.6.3 Fageprosess fullført .....	105
6.6.4 Avbryte fageprogrammet .....	107
6.6.5 Drift som arbeidsstasjon .....	109
6.6.6 Fullføre den daglige driften .....	110
<b>7. Rengjøring og vedlikehold .....</b>	<b>111</b>
7.1 Viktige merknader om rengjøring av instrumentet .....	111
7.2 Eksterne flater, lakkerte flater, instrumentdeksel .....	111
7.3 TFT-berøringskjerm .....	111
7.4 Innside og dreneringspanne .....	112
7.5 Transportarmer .....	112
7.6 Lesestasjon for objektglass .....	112
7.7 Mate- og utmatningsskuffer .....	113
7.8 Tørroverføringsstasjon .....	113
7.9 Overføringsstasjon (tilleggsutstyr) .....	114
7.10 Reagensbeholdere og skyllevannbeholdere .....	114
7.11 Stativ og håndtak .....	116
7.12 Avløpssystem .....	116
7.13 Avløpsslange .....	117
7.14 Skifte filterinnsatsen til vanninnløpsfilteret .....	117
7.15 Bytte det aktive kullfilteret .....	118
7.16 Rengjøre ovnene .....	119
7.17 Ovnens luftfilter .....	121
7.18 Intervaller for rengjøring og vedlikehold .....	121
7.18.1 Daglig rengjøring og vedlikehold .....	122

# Innholdsfortegnelse

---

7.18.2 Rengjøring og vedlikehold etter behov .....	122
7.18.3 Ukentlig rengjøring og vedlikehold .....	123
7.18.4 Månedlig vedlikehold og rengjøring .....	123
7.18.5 Rengjøring og vedlikehold hver tredje måned .....	123
7.18.6 Årlig vedlikehold og rengjøring.....	123
<b>8. Feil og feilsøking.....</b>	<b>124</b>
8.1 Mulige løsninger på maskinfeil .....	124
8.2 Strømbrudd og maskinfeil .....	126
8.2.1 Prosedyre etter strømbrudd .....	129
8.2.2 Gjenoppta fargeprosessen etter et strømbrudd.....	131
8.2.3 Avbryte alle fargeprosesser etter et strømbrudd .....	133
8.2.4 Løsne et stativ fra gripmekanismen .....	134
8.2.5 Fjerne et stativ fra overføringsstasjonen .....	136
8.3 Skifte hovedsikringer .....	137
8.4 Fjernhjelp .....	138
8.5 Blokkert avløppssystem .....	138
<b>9. Instrumentkomponenter og -spesifikasjoner.....</b>	<b>141</b>
9.1 Tilleggsutstyr til instrumentet.....	141
9.2 Tilleggsutstyr.....	141
<b>10. Garanti og service .....</b>	<b>149</b>
<b>11. Driftsnedlegging og kassering .....</b>	<b>150</b>
<b>12. Dekontaminasjonserklæring.....</b>	<b>151</b>
<b>A1. Vedlegg 1 – Kompatible reagenser.....</b>	<b>152</b>

## 1. Viktig informasjon

### 1.1 Symboler og betydninger



#### Advarsel

Leica Biosystems GmbH påtar seg intet ansvar for følgeskader eller skader som skyldes at instruksjonene nedenfor ikke er fulgt, dette gjelder særlig med hensyn til transport og håndtering av emballasje, og at instruksjonene om å håndtere instrumentet forsiktig, ikke er fulgt.

**Symbol:**

**Symboltittel:**

Advarsel

**Beskrivelse:**

Advarsler vises i et hvitt felt med en oransje tittellinje. Advarsler kjennetegnes med en advarseltrekant.

**Symbol:**

**Symboltittel:**

Merk

**Beskrivelse:**

Merknader, dvs. viktig brukerinformasjon, vises i et hvitt felt med en blå tittellinje. Merknader kjennetegnes ved et merknadssymbol.

**Symbol:**

→ "Fig. 7 - 1"

**Symboltittel:**

Elementnummer

**Beskrivelse:**

Elementnumre som nummererer illustrasjonene. De røde tallene viser til elementnumrene i illustrasjonene.

**Symbol:**

Administrator

**Symboltittel:**

Funksjonsknapp

**Beskrivelse:**

Programbetegnelser som må vises i inndataskjermbildet, vises som fet, grå tekst.

**Symbol:**

Lagre

**Symboltittel:**

Funksjonsknapp

**Beskrivelse:**

Programsymboler som brukeren må trykke på i inndataskjermbildet, vises som fet, grå og understrekket tekst.

**Symbol:**

Strømbryter

**Symboltittel:**

Taster og brytere på instrumentet

**Beskrivelse:**

Taster og brytere på instrumentet som brukeren skal trykke på i ulike situasjoner, vises som fet, grå tekst.

**Symbol:**

**Symboltittel:**

Obs!

**Beskrivelse:**

Angir at brukeren må konsultere brukerhåndboken for viktig informasjon om advarsler og forholdsregler, som av ulike årsaker ikke kan presenteres på selve instrumentet.

**Symbol:**


**Symboltittel:**




Advarsel, varm overflate

**Beskrivelse:**

Instrumentoverflater som blir varme under drift, er merket med dette symbolet. Unngå direkte kontakt for å unngå faren for forbrenning.

<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b> Produsent <b>Beskrivelse:</b> Angir produsenten av det medisinske produktet.
<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b> Produksjonsdato <b>Beskrivelse:</b> Angir produksjonsdato for det medisinske utstyret.
<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b> CE-samsvar <b>Beskrivelse:</b> CE-merkingen er produsentens samsvarserklæring som viser at det medisinske produktet er i overensstemmelse med kravene i de relevante EF-direktivene.
<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b> CSA Statement (Canada/USA) <b>Beskrivelse:</b> The CSA test mark means that a product has been tested and fulfills the applicable safety standards:  CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-04 CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-2-010-04 CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-2-101-04  Produktet er oppført under hovedkontraktnummer: 217333
<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b> Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk <b>Beskrivelse:</b> Angir at det medisinske utstyret er beregnet til in vitro-diagnostikk.
<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b> China ROHS <b>Beskrivelse:</b> Miljøsymbolet til China RoHS-direktivet. Tallet i symbolet angir miljøvennlig bruksperiode for produktet i år. Symbolet brukes hvis et produkt inneholder en større mengde enn det som er tillatt, av et stoff som har restriksjoner for bruk i Kina.
<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b> WEEE-symbol <b>Beskrivelse:</b> WEEE-symbolet, som angir at elektrisk og elektronisk avfall ikke må kastes med annet avfall, er en søppeldunk med kryss over (§ 7 ElektroG).
<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b> Vekselstrøm
<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b> Artikkelnummer <b>Beskrivelse:</b> Angir produsentkatalognummeret til det medisinske utstyret slik at det er lett å identifisere.
<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b> Serienummer <b>Beskrivelse:</b> Angir serienummeret fra produsenten slik at det medisinske utstyret er lett å identifisere.

<b>Symbol:</b>	<b>Symboltittel:</b>	Se brukerhåndboken
	<b>Beskrivelse:</b>	Angir at brukeren må konsultere brukerhåndboken.
<b>Symbol:</b>	<b>Symboltittel:</b>	<b>PÅ</b> (strøm)
	<b>Beskrivelse:</b>	Strømforsyningen kobles til når <u>strømbryteren</u> trykkes inn.
<b>Symbol:</b>	<b>Symboltittel:</b>	<b>AV</b> (strøm)
	<b>Beskrivelse:</b>	Strømforsyningen kobles fra når <u>strømbryteren</u> trykkes inn.
<b>Symbol:</b>	<b>Symboltittel:</b>	Advarsel, strømfare
 	<b>Beskrivelse:</b>	Instrumentoverflater som gjøres strømførende under drift, er merket med dette symbolet. Unngå direkte kontakt med flaten.
<b>Symbol:</b>	<b>Symboltittel:</b>	Forsiktig: Klemfare
		
<b>Symbol:</b>	<b>Symboltittel:</b>	Brannfare
	<b>Beskrivelse:</b>	Brannfarlige reagenser, løsemidler og rengjøringsmidler er merket med dette symbolet.
<b>Symbol:</b>	<b>Symboltittel:</b>	Følg advarselen om laserstråling og brukerhåndboken
	<b>Beskrivelse:</b>	Produktet er utstyrt med en laserkilde i klasse 1. Følg brukerhåndboken og sikkerhetsmerknaden om bruk av laser!
<b>Symbol:</b>	<b>Symboltittel:</b>	Ikke bruk noen form for alkohol til rengjøring, og følg bruksanvisningen.
	<b>Beskrivelse:</b>	Viser til at det er forbudt å bruke alkohol eller rengjøringsmidler som inneholder alkohol til rengjøring av elementet/delen dette symbolet er festet til. Bruk av alkohol eller rengjøringsmidler som inneholder alkohol til rengjøring, vil ødelegge elementet/delen.
<b>Symbol:</b>	<b>Symboltittel:</b>	IPPC-symbol
	<b>Beskrivelse:</b>	IPPC-symbolet omfatter:
		IPPC-symbol
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landskode for ISO 3166, f.eks. DE for Tyskland</li> <li>• Regions-ID, f.eks. NW for Nordrhein-Westfalen</li> <li>• Registreringsnummer, unikt nummer som starter med 49</li> <li>• Behandlingsmetode, f.eks. HT (varmebehandling)</li> </ul>

<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b>	Skjørt, håndteres varsomt
	<b>Beskrivelse:</b>	Angir at det medisinske utstyret kan bli skadd eller ødelagt hvis det ikke håndteres varsomt.
<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b>	Oppbevares tørt
	<b>Beskrivelse:</b>	Angir at det medisinske utstyret ikke må utsettes for fukt.
<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b>	Stablingsgrense
	<b>Beskrivelse:</b>	Største antall identiske pakker som kan stables. "2" viser antall pakker tillatt.
<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b>	Denne siden opp
	<b>Beskrivelse:</b>	Angir riktig stående plassering av transportpakken.
<b>Symbol:</b> <small>Transport temperature range:</small> 	<b>Symboltittel:</b>	Temperaturgrense for transport
	<b>Beskrivelse:</b>	Angir sikker transporttemperatur for det medisinske utstyret.
<b>Symbol:</b> <small>Storage temperature range:</small> 	<b>Symboltittel:</b>	Temperaturgrense for oppbevaring
	<b>Beskrivelse:</b>	Angir sikker oppbevaringstemperatur for det medisinske utstyret.
<b>Symbol:</b> 	<b>Symboltittel:</b>	Fuktighet, begrensninger ved transport og oppbevaring
	<b>Beskrivelse:</b>	Angir sikker fuktighetsgrense for transport og oppbevaring av det medisinske utstyret.

**Utseende:****Indikasjon:****Beskrivelse:****Vippeindikator**

Indikatoren viser om forsendelsen har blitt transportert og oppbevart i stående stilling, i henhold til kravene. Hvis enheten vippes mer enn 60°, renner den blå kvartssanden inn i det pilformede indikatorinduet, og forblir der. Feil håndtering av forsendelsen kan dermed registreres og bevises ut over enhver tvil.

**Merk**

- Mottakeren må kontrollere at vippeindikatoren er intakt når instrumentet leveres. Den ansvarlige Leica-representanten må informeres hvis alle indikatorene er utløst.
- Brukerhåndboken leveres sammen med den innbundne brosjyren "RFID-registrering". Denne brosjyren inneholder landsspesifikk informasjon for brukeren om betydningen til RFID-symbolene og registreringsnumrene som finnes på emballasjen eller HistoCore SPECTRA ST-merkeplaten.

**1.2 Instrumentmodell**

Informasjonen i denne brukerhåndboken gjelder kun for instrumentmodellen som er angitt på forsiden. En merkeplate med instrumentets serienummer er festet på baksiden av instrumentet. En plate med kinesisk og japansk registreringsinformasjon er plassert på instrumentets bakpanel.

**1.3 Brukergruppe**

- HistoCore SPECTRA ST skal bare brukes av autorisert personell som har fått omfattende opplæring i bruk av laboratoriereagenser og hvordan de brukes i histologi.
- Alt laboratoriepersonell som er satt til å betjene dette instrumentet, skal lese denne brukerhåndboken nøye. De skal dessuten kjenne til alle de tekniske egenskapene til instrumentet før de betjener det. Instrumentet er kun tiltenkt profesjonell bruk.

**1.4 Tiltenkt bruk**

HistoCore SPECTRA ST er et IVD-instrument (medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk).

HistoCore SPECTRA ST er et fargeinstrument til bruk i laboratorier og er beregnet på klargjøring av histologiske og cytologiske prøver.

**Advarsel**

All bruk av instrumentet utover tiltenkt bruk, anses å være feilaktig. Dersom disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til uhell, personskader og skade på instrument og tilleggsutstyr. Riktig og tiltenkt bruk omfatter samsvar med alle kontroll- og vedlikeholdsinstruksjoner, overholdelse av alle instruksjoner i brukerhåndboken, og konstant kontroll av reagenskvalitet og -holdbarhet. HistoCore SPECTRA ST utfører de spesifiserte fargetrinnene automatisk. Produsenten påtar seg intet ansvar for fargeresultatene dersom fargetrinnene og -programmene er oppgitt feil. Sluttbrukeren er dermed selv ansvarlig for selvvalgte reagens- og programinnstillinger.

## 1.5 Opphavsrett – instrumentets programvare

Programvaren som er installert og brukes i HistoCore SPECTRA ST, er underlagt følgende lisensavtaler:

1. GNU generell offentlig lisens (GPL), versjon 2.0, 3.0
2. GNU mindre generell offentlig lisens (LGPL) 2.1
3. Tilleggsprogramvare som ikke er lisensiert under GPL/LGPL

Den fullstendige lisensavtaletten for første og andre element på listen finnes på den medfølgende språk-CD-en ([→ S. 18 – 3.1 Standard levering](#)) i katalogen "Programvarelisenser".

Leica Biosystems tilbyr en fullstendig, maskinlesbar kopi av kildekoden til alle tredjeparter som overholder avtalevilkårene i GPL/LGPL og er relevante for kildekoden, eller andre relevante lisenser. Ta kontakt med oss via [www.leicabiosystems.com](http://www.leicabiosystems.com), og velg det relevante kontaktskjemaet.

## 2. Sikkerhet

### 2.1 Sikkerhetsmerknader



#### Advarsel

- Sikkerhetsmerknadene og advarslene i dette kapittelet må overholdes til enhver tid. Les gjennom merknadene selv om du allerede er kjent med og bruker andre Leica-instrumenter.
- Sikkerhetsanordningene på instrumentet og tilbehør må ikke fjernes eller modifiseres.
- Kun kvalifisert servicepersonell som er autorisert av Leica, har tillatelse til å reparere instrumentet og ha tilgang til instrumentets interne komponenter.

#### Restrisiko:

- Instrumentet er utformet og utstyrt med moderne teknologi og i henhold til anerkjente standarder og forskrifter for sikkerhetsteknologi. Feil bruk av instrumentet kan føre til personskade, i verste fall død, for både bruker og annet personell, eller skade på instrument eller eiendom.
- Instrumentet må kun brukes til tiltenkt formål og hvis alle sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal.
- Hvis det oppstår funksjonssvikt som kan føre til at sikkerhetsfunksjoner ikke fungerer som de skal, må instrumentet straks tas ut av bruk og den ansvarlige Leica-serviceteknikeren tilkalles.
- Bruk kun originale reservedeler og godkjent, originalt Leica-tilbehør.
- Instrumentet er i samsvar med kravene til elektromagnetisk kompatibilitet, utstråling av interferens og immunitet mot interferens samt kravene i IEC 61326-2-6. Instrumentet er også i samsvar med kravene til sikkerhetsinformasjon i IEC 61010-1, IEC 61010-2-101, IEC 62366 og ISO 14971.

Denne brukerhåndboken omfatter viktige instruksjoner og informasjon knyttet til sikker bruk og vedlikehold av instrumentet.

Brukerhåndboken er en viktig del av instrumentet, og den må leses nøye før instrumentet tas i bruk. Oppbevar alltid brukerhåndboken sammen med instrumentet.



#### Merk

Brukerhåndboken må leses i sammenheng med gjeldende forskrifter om skadeforebygging og miljøsikkerhet i landet der brukeren befinner seg.

Instrumentets EF-samsvarserklæring står oppgitt på Internett, på:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

Dette instrumentet er bygget og testet i samsvar med sikkerhetskravene til elektrisk utstyr som brukes til måling, kontroll og bruk på laboratorier. For å opprettholde denne standarden og sørge for sikker bruk av instrumentet må brukeren følge alle merknader og advarsler som står oppgitt i denne brukerhåndboken.

## 2 Sikkerhet



### Advarsel

- Hvis systemet utsettes for skadelig programvare, vil det føre til ukontrollerbar systemoppførelse. I slike tilfeller vil det ikke lenger være mulig å sikre at instrumentet fungerer i samsvar med spesifikasjonene. Hvis brukeren mistenker at det finnes skadelig programvare i systemet, må IT-avdelingen informeres om dette umiddelbart.
- Påse at eventuelle data som er lastet inn i instrumentet, er uten virus. Instrumentet leveres ikke med antivirusprogramvare.
- Instrumentet eigner seg kun til bruk i et nettverk som er beskyttet av brannmur. Leica påtar seg intet ansvar for feil som skyldes at instrumentet er brukt i et ubeskyttet nettverk.
- KUN teknikere som er opplært og godkjent av Leica får koble til USB-innndataenheter (f.eks. mus/tastatur o.l.). Dette gjelder også nettverkstilkoblingen, som bare skal brukes sammen med Fjernhjelp (servicediagnostikk).

Av hensyn til prøveintegriteten bruker HistoCore SPECTRA ST skjermmeldinger og lydsignaler for å angi når brukeren må gripe inn. Brukeren må derfor oppholde seg innenfor hørerekkevidde av HistoCore SPECTRA ST-fargeinstrumentet når det er i bruk.



### Advarsel

Produktet er utstyrt med en laserkilde i klasse 1.

Obs! Laserstråle! Se ikke direkte på laserstrålen! Det kan gi skader på netthinnen.



### Advarsel

LASERSTRÅLING – SE IKKE  
DIREKTE PÅ LASERSTRÅLEN  
ISO 60825-1: 2014  
P<1 mW, λ = 630 til 670 nm  
Pulsvarighet = 500 µs  
Laserprodukt i klasse 1

## 2.2 Advarsler

Sikkerhetsanordningene som er installert på dette instrumentet av produsenten, utgjør kun grunnleggende skadeforebygging. Det er i all hovedsak eiers ansvar å ivareta instrumentsikkerheten i samarbeid med brukere, service- og vedlikeholdspersonell.

For å oppnå problemfri drift er det viktig at følgende instruksjoner og advarsler følges nøyne.

Vær oppmerksom på at det er fare for elektrisk støt ved direkte og indirekte kontakt med HistoCore SPECTRA ST.



### Advarsel

Merking på instrumentet som viser varselrekanten, angir at brukerinstruksjonene (som angitt i brukerhåndboken) må følges ved bruk og bytting av den aktuelle enheten. Dersom disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til uhell, personskader og skade på instrument og tilleggsutstyr eller gjøre prøvene ubrukelige.



### Advarsel

Enkelte instrumentflater blir varme under bruk. Dette er helt normalt. Disse overflatene er merket med dette varselmerket. Hvis du tar på disse overflatene uten egnert beskyttelse, kan det føre til brannskader.

### Advarsler – Transport og installasjon



### Advarsel

- Instrumentet må utelukkende transporteres stående.
- Instrumentet veier 165 kg, det kreves derfor fire kvalifiserte personer til å bære det.
- Bruk sklisikre hansker ved løfting av instrumentet.
- Leica anbefaler at det benyttes et transportfirma til transport, installasjon (hvis aktuelt) og flytting av instrumentet.
- Ta vare på emballasjen.
- Sett instrumentet på en robust laboratoriebenk med tilstrekkelig bæreevne og juster det til horisontal stilling.
- Instrumentet må ikke utsettes for direkte sollys.
- Koble instrumentet til et jordet strømnett. Ved bruk av skjøteleddning er det viktig å bruke en skjøteleddning med jording.
- Store temperaturendringer ved flytting fra lager til installasjonssted samt høy luftfuktighet kan føre til at det dannes kondens inni instrumentet. I slike tilfeller må du vente i minst to timer før instrumentet slås på.
- Instrumentet må kun installeres av og under oppsyn av Leica-opplært personell. Dette gjelder også for eventuell transport til et nytt sted. Vi anbefaler at instrumentet også settes i drift igjen av Leica-opplært personell.
- I henhold til nasjonale lover og forskrifter kan det være et krav at bruker må sørge for langsiktig sikring av offentlige vannkilder mot kontaminering som skyldes tilbakestrømming av vann fra bygningsinstallasjonen. I Europa må sikringsutstyret for drikkevannsinstallasjonen det skal kobles til, velges i samsvar med spesifikasjonene i DIN EN 1717:2011-08 (informasjonsstatus august 2013).

### Advarsler – Håndtere reagenser



### Advarsel

- Vær forsiktig ved håndtering av løsemidler.
- Bruk alltid beskyttelseskjær egnet til bruk på laboratorier, samt gummihansker og vernebriller ved håndtering av kjemikaliene som brukes i instrumentet.
- Installasjonsstedet må ha god ventilasjon. I tillegg anbefaler vi på det sterkeste å koble instrumentet til et eksternt ventilasjonssystem. Kjemikaliene som brukes i HistoCore SPECTRA ST, er brann- og helsefarlige.
- Bruk ikke instrumentet i rom hvor det er eksplosjonsfare.
- Følg gjeldende lokale lover og forskrifter og selskapets/institusjonens retningslinjer for deponering av avfall ved deponering av brukte reagenser.
- Reagensbeholdere må alltid fylles utenfor instrumentet, i tråd med sikkerhetsinformasjonen.

## 2 Sikkerhet

### Advarsler – Bruke instrumentet



#### Advarsel

- Instrumentet skal kun brukes av laboratoriepersonell som har fått relevant opplæring. Det må kun brukes til tiltenkt bruk og i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken. Antistatiske bekyttelsesklær laget av naturfiber (f.eks. bomull) må brukes når instrumentet benyttes.
- Bruk egnede beskyttelsesklær (laboratoriefrakk, vernebriller og hanske) som beskytter mot reagenser og potensielt smittefarlige mikrobiologiske stoffer.
- Hvis en nødssituasjon skulle oppstå, slår du av **strømbryteren** og trekker instrumentkontakten ut av støpselet (kretsbyrter i samsvar med EN ISO 61010-1).
- I forbindelse med alvorlige instrumentfeil, må alle advarsler og feilmeldinger som vises på skjermen, følges. Prøver som er plassert i instrumentet, må fjernes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for trygg viderebehandling av prøvene.
- Det kan være fare for brann dersom arbeid med en utildekket flamme (f.eks. en brenner) utføres i nærheten av maskinen (gasser fra løsemidler). Pass derfor på at det er en sikkerhetsavstand på 2 meter.
- Vær absolutt sikker på at instrumentet brukes med det aktive kulfILTERET. I tillegg anbefaler vi på det sterkeste å koble apparatet til et eksternt avtrekkssystem fordi bruk av instrumentet kan danne damp fra løsemidler som er både brann- og helsefarlige, selv når instrumentet brukes slik det er tiltenkt.



#### Merk

For å begrense damputslippet anbefaler Leica et leveringsvolum på 50 m<sup>3</sup>/t og en 8 x luftomsetning på (25 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/t) i laboratoriet.



#### Advarsel

- Verneutstyr i form av en pustemaske, må brukes når du jobber direkte med reagensbeholdere som inneholder løsemidler.
- Hvis dekselet åpnes mens ett eller flere fargeprogrammer pågår, oppstår forsinkelser i behandlingstrinnene ettersom prosessen stopper opp så lenge dekselet er åpent. Denne forsinkelsen kan forringe fargekvaliteten.
- Sørg for at dekselet er lukket så lenge fargeprogrammene pågår. Leica påtar seg intet ansvar for tap av kvalitet i fargeprogrammer som skyldes at dekselet ble åpnet under fargeprosessen.
- Obs! Ved lukking av dekselet: Klemfare! Stikk ikke hånden inn i svingområdet til dekselet.
- Pass på at væske ikke trenger seg inn bak dekslene eller i åpningene mens du bruker eller rengjør instrumentet. Dette gjelder også transportarmene.
- FORSIKTIG med programmer som starter med et ovnstrinn. I slike tilfeller må matestasjonen som objektglassene fjernes fra med transportarmen, IKKE være fylt med en brannfarlig reagens (f.eks. xylen, xylenerstatning eller alkohol). Ovnstemperaturen kan være opptil 70 °C. Dette kan føre til at reagensen antennes og skader instrumentet og prøvene.
- Vanntilførselen må kobles fra ved midlertidig stopp av instrumentet og når instrumentet slås av.

## Advarsler – Vedlikehold og rengjøring



### Advarsel

- Slå av instrumentet, og koble det fra strømforsyningen før det utføres vedlikehold.
- Bruk egnede beskyttelsesklær (laboratoriefrakk og hanske) som beskytter mot reagenser og potensielt smittefarlige mikrobiologiske stoffer ved rengjøring av instrumentet.
- Ved bruk av rengjøringsmidler må produsentens og laboratoriets sikkerhetsinstruksjoner følges.
- Ikke bruk noen av følgende midler til rengjøring av utsiden på instrumentet: alkohol, vaskemidler som inneholder alkohol (glasspussemidler), slipende vaskemidler, løsemidler som inneholder aceton, ammoniakk, klor eller xylen.
- Ikke bruk alkohol eller rengjøringsmidler som inneholder alkohol til rengjøring av vannfilterhuset (→ "Fig. 5-5"). Konsekvensen kan være at det lekker vann på en ukontrollert måte, noe som kan skade laboratoriet eller laboratoriemiljøet.
- Rengjør lokk og kabinett med et vanlig, mildt pH-nøytralt rengjøringsmiddel. De behandlede flatene tåler ikke løsemidler og xylenesteratninger.
- Reagensbeholderne i plast i skyllevann- og reagensstasjonene kan vaskes i oppvaskmaskin på maks. +65 °C. Alle typer rengjøringsmiddel for laboratorieoppvaskmaskiner kan brukes. Rengjør aldri plastbeholderne ved høyere temperaturer, da høyere temperaturer kan føre til at beholderne deformerer.

## 2.3 Sikkerhetsanordninger på instrumentet

Så snart instrumentdekselet åpnes, stoppes bevegelsen til transportarmene i horisontalplan (x-akse og y-akse). Dette gjøres av sikkerhetsårsaker for å unngå personskader og at prøvene skades av bevegelige deler.



### Advarsel

- Sørg for at dekselet er lukket så lenge fargeprogrammene pågår. Leica påtar seg intet ansvar for tap av kvalitet i fargeprogrammer som skyldes at dekselet ble åpnet under fargeprosessen.
- Hvis dekselet åpnes mens ett eller flere fargeprogrammer pågår, oppstår det forsinkelser i behandlingen ettersom prosessen stopper opp så lenge dekselet er åpent. Denne forsinkelsen kan forringe fargekvaliteten.

### 3 Instrumentkomponenter og -spesifikasjoner

#### 3. Instrumentkomponenter og -spesifikasjoner

##### 3.1 Standard levering

Ant.	Betegnelse	Bestillingsnr.
1	HistoCore SPECTRA ST Hovedinstrument (inkl. lokal strømledning)	14 0512 54354
1	Reagensbeholdersett med: 46 reagensbeholdere med deksler 6 blå skyllevannsbeholdere 6 o-ringer 7x2	14 0512 47507
1	Etikettsett til inn- og utmatningsskuffer med: <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 stk. blanke</li><li>• 5 stk. "H<sub>2</sub>O" = vann</li><li>• 5 stk. "A" = alkohol</li><li>• 5 stk. "S" = løsemiddel, f.eks. xylen</li></ul>	14 0512 55161
1	Aktivt kullfiltersett (2 stk.)	14 0512 53772
1	Avløpsslange, 2 m	14 0512 55279
1	Slangeklemme 30 45/12 DIN 3017 RF	14 0422 31972
1	Vanntilkoblingsutstyr, bestående av: 2 Vanninnløpsslange, 10 mm, 2,5 m 1 Forlengelsesslange, 1,5 m 1 Y-kobling G3/4 2 Dobeltnippel G3/4 G1/2 1 Filterhus 1 Filterinnsats 1 Rørkobling G3/4 1 Blindhette G3/4 1 Tetningsskive 1 Skrunøkkel med ett hode SW30 DIN894	14 0512 49324
1	Avløpsslange, 2 m	14 0474 32325
1	Slangeklemme 30 45/12 DIN 3017 RF	14 0512 49334
1	5,5 x 150 skrutrekker	14 0170 10702
2	T16 A sikring	14 6000 04696
1	Molykote 111 smørefett, 100 g	14 0336 35460
3	Stativ for 30 objektglass, 3 stk. per pakke	14 0512 52473
1	Håndtak til stativ for 30 objektglass, gult, 3 stk. per pakke	14 0512 52476
1	Håndtak til stativ for 30 objektglass, mørkeblå, 3 stk. per pakke	14 0512 52478
1	Håndtak til stativ for 30 objektglass, rødt, 3 stk. per pakke	14 0512 52480

Ant.	Betegnelse	Bestillingsnr.
1	Håndtak til stativ for 30 objektglass, hvitt, 3 stk. per pakke	14 0512 52484
1	Trykt brukerhåndbok (engelsk, med språk-CD 14 0512 80200)	14 0512 80001

Kontakt nærmeste Leica-forhandler hvis den medfølgende lokale strømledningen er defekt eller tapt.



#### Merk

Komponentene som mottas må sammenlignes nøyne med pakklisten, følgeseddelen og bestillingen.  
Finner du avvik, ta straks kontakt med ditt lokale Leica-salgskontor.

### 3.2 Spesifikasjoner

Nominell spenning: 100–240 V AC  $\pm 10\%$

Nominell frekvens: 50/60 Hz

Effektuttak: 1580 VA

Sikringer: 2 x T16 A H 250 V AC

IEC 1010-klassifisering: Vernekasse 1

Forurensningsgrad 2

Overspenningskategori: II

Ferskvannstilkobling:

Slangemateriale: PVC

Slangelengde: 2500 mm

Overgangsstykke: G3/4

Indre diameter: 10 mm

Ytre diameter: 16 mm

Indre trykk: Minimum/maksimum: 2 bar / 6 bar

Nødvendig strømningshastighet: Min. 1,7 l / minutt

Krav til vannkvalitet: Type 1, ISO 3696

Spillvannstilkobling:

Slangelengde: 2000 mm / 4000 mm

Indre diameter: 32 mm

Ytre diameter: 36,8 mm

Avtrekksluft:

Slangelengde: 2000 mm

Indre diameter: 50 mm

Ytre diameter: 60 mm

Avtrekksluftmengde: 27,3 m<sup>3</sup>/t

### 3 Instrumentkomponenter og -spesifikasjoner

Avtrekkssystem:	Aktivt kullfilter og avtrekksslange som kobles til et eksternt avtrekkssystem	
Varmeavgivelse:	1580 J/s	
A-vektet støynivå:	< 70 dB (A)	
Internasjonal vernekasse:	IP20	
Tilkoblinger:	1 x RJ45 Ethernet (bak):	RJ45 – LAN (ekstern datastyring)
	1 x RJ45 Ethernet (foran):	Kun til servicebruk
	2 x USB 2.0:	5 V/500 mA (service og datalagring)



#### Merk

Når du benytter en strømforsyning uten avbrytelser (UPS), må den ha en kapasitet på minst 1580 VA og sikker drift i minst 10 minutter.

Romforhold:

Drift:

Temperatur: +18 °C til +30 °C

Relativ luftfuktighet: 20 % til 80 %, ikke-kondenserende

Driftshøyde over havet: maks. 2000 moh.

Oppbevaring:

Temperatur: +5 °C til +50 °C

Relativ luftfuktighet: 10 % til 85 %, ikke-kondenserende

Transport:

Temperatur: -29 °C til +50 °C

Relativ luftfuktighet: 10 % til 85 %, ikke-kondenserende

Mål og vekt:

Mål (bredde x dybde x høyde): Lukket deksel: 1354 x 785,5 x 615 mm

Åpnet deksel: 1354 x 785,5 x 1060 mm

Tomvekt (uten overføringsstasjon, reagenser og tilbehør) 165 kg

Lastet vekt (med overføringsstasjon, reagenser og tilbehør) 215 kg

## 3.3 Generell oversikt – sett forfra

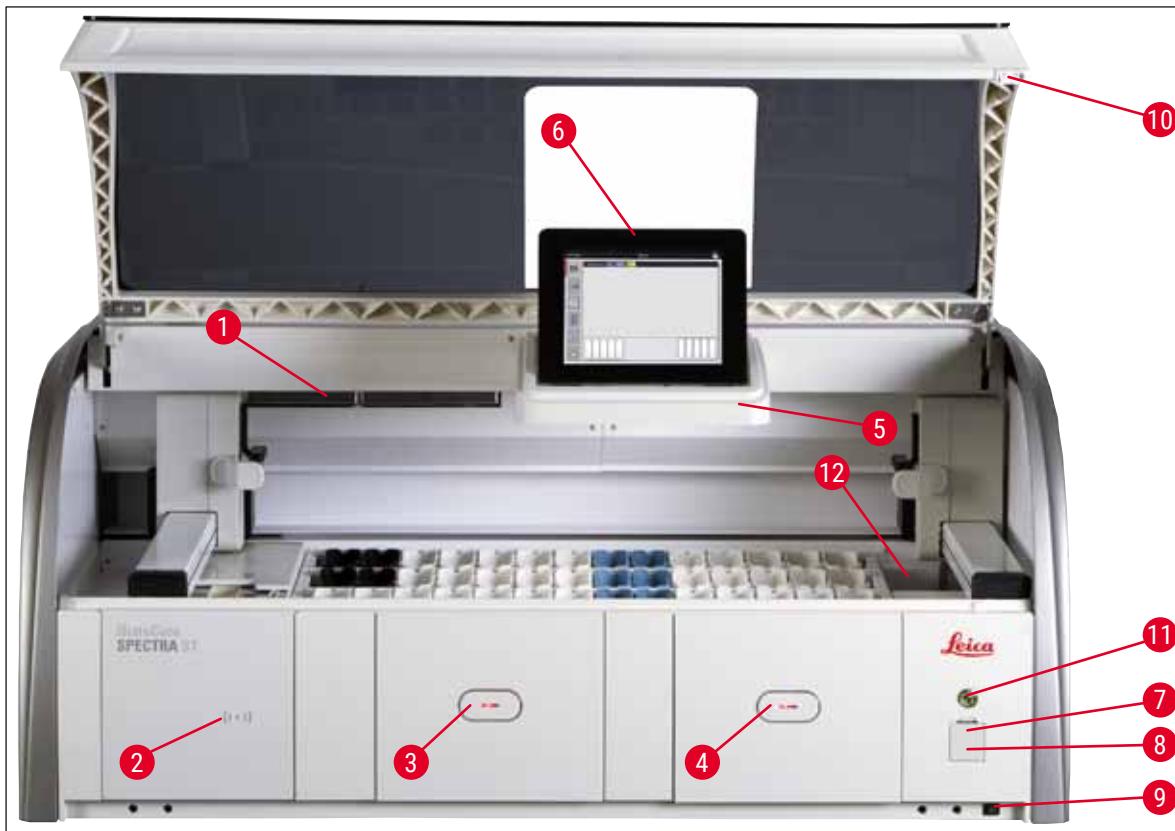


Fig. 1

1	Innsats for aktivt kullfilter	7	USB-porter (2 stk.)
2	Innlesningsområde for Leica-reagenser	8	Servicetilgang
3	Mateskuff (innmating)	9	<b>PÅ/AV-bryter (strømbryter)</b>
4	Utmatingsskuff (utmating)	10	Deksel
5	Skjermholder med innvendig belysning	11	<b>Driftsbryter</b>
6	Skjerm med brukergrensesnitt	12	Overføringsstasjon (tilleggsutstyr)

**Advarsel**

- Servicetilgangen (→ "Fig. 1-8") skal bare brukes av Leica-sertifiserte servicerørteknikere!
- Dekselet til innlesningsområdet (→ "Fig. 1-2") skal bare fjernes av Leica-sertifiserte servicerørteknikere.

### 3 Instrumentkomponenter og -spesifikasjoner

#### 3.4 Generell oversikt – sett bakfra

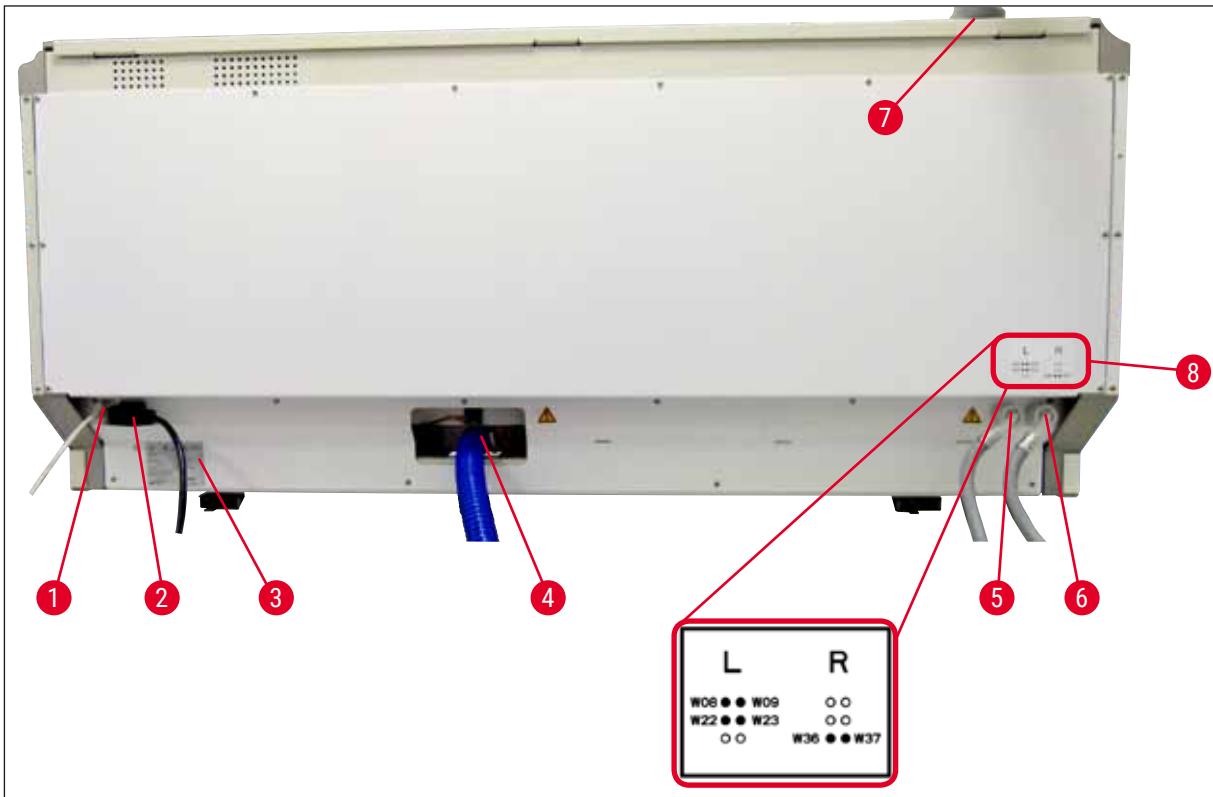


Fig. 2

- 1 Nettverkstilkobling (Fjernhjelp)
- 2 Strømforsyningen
- 3 Typeskilt
- 4 Spillvannstilkobling
- 5 Skyllevannstilkobling (gruppe med 4)
- 6 Tilkobling for destillert vann eller skyllevann (gruppe med 2)
- 7 Avtrekkslufttilkobling
- 8 Vanntilkoblingsdiagram

## 3.5 Generell oversikt – sett innenfra

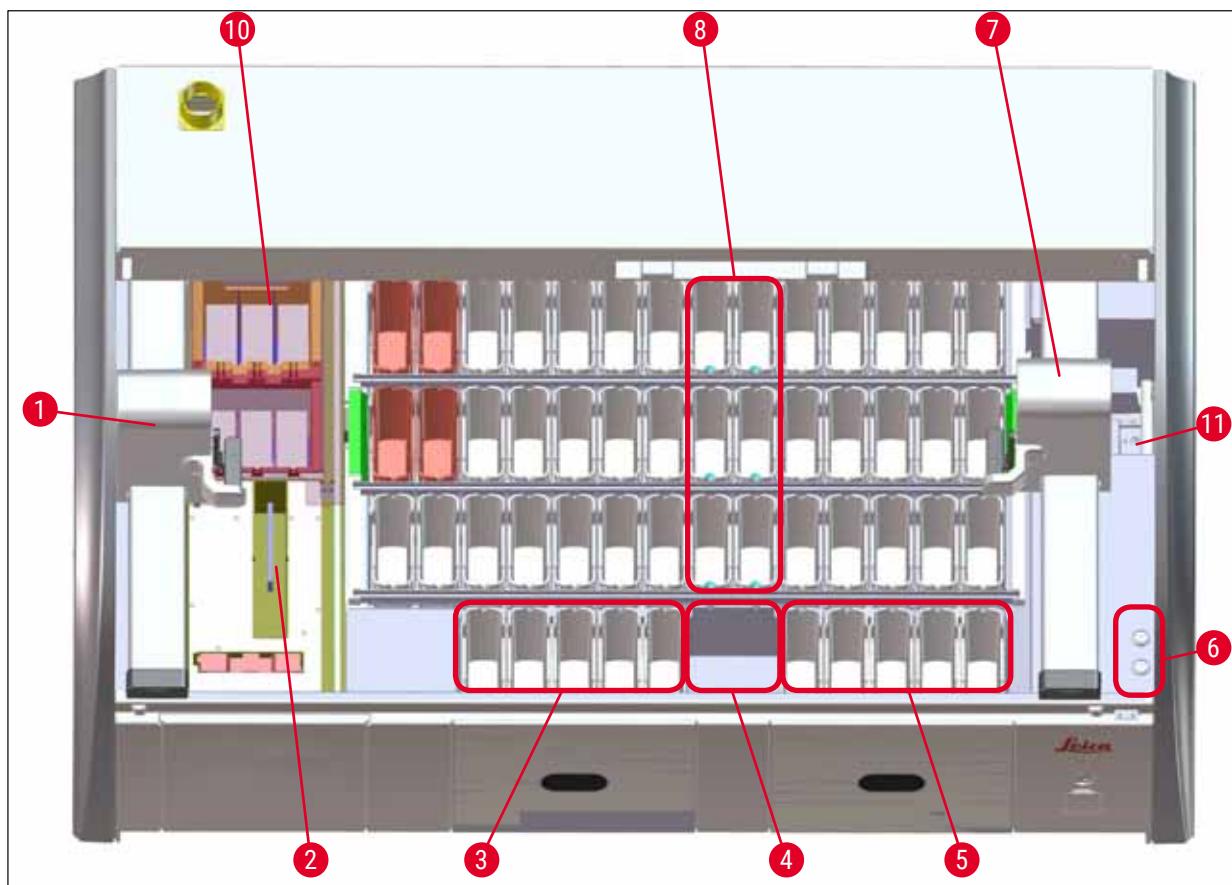


Fig. 3

- 1 Venstre transportarm
- 2 Lesestasjon for objektglass
- 3 Innmatingsstasjoner, 5 stk.
- 4 Tørroverføringsstasjon, 2 stk.
- 5 Utmatingsstasjoner, 5 stk.
- 6 Sikringsholder, 2 stk.
- 7 Høyre transportarm
- 8 Skyllevannstasjoner, 6 stk.
- 10 Tørkeovnsstasjoner, 6 stk.
- 11 Overføringsstasjon til HistoCore SPECTRA CV (tilleggsutstyr)

## 4 Installasjon og oppstart

### 4. Installasjon og oppstart

#### 4.1 Krav til installasjonsstedet



##### Merk

- Installering og nivellering utføres som et ledd i instrumentinstallasjonen, som kun må foretas av Leica-godkjent personell.
- Det trengs 4 kvalifiserte personer til å løfte instrumentet. Grip tak under rammen i alle hjørner, og løft så jevnt som mulig.

- Pass på at det er et relativt vibrasjonsfritt gulv og nok klaring (ca. 1,10 m) over laboratoriebenken til at dekselet kan åpnes helt opp.
- Brukeren har ansvar for å sørge for at et kompatibelt elektromagnetisk miljø opprettholdes, slik at instrumentet kan fungere på tilsiktet måte.
- Det kan oppstå kondens i instrumentet hvis det er betydelig temperaturforskjell mellom instrumentets oppbevarings- og lagringssted når luftfuktigheten også er høy. Vent minst to timer med å slå på instrumentet hvis dette skjer. Slås instrumentet på tidligere, kan det bli skadet.
- Stabil, horisontal laboratoriebenk i fullstendig vater, minst 1,40 m bred og 0,80 m dyp.
- Benkeområdet må være vibrasjonsfritt og i vater.
- Ventilatorhette på en avstand av maks. 2,0 m fra instrumentet.
- Instrumentet egner seg kun til bruk innendørs.
- Bruksområdet må være godt ventilert. I tillegg anbefaler vi på det sterkeste et eksternt ventilasjonssystem.
- Det må finnes en skylevannstasjon maks. 2,5 m fra instrumentet. Denne koblingen må være lett tilgjengelig også etter at instrumentet er installert.
- Det må finnes en spillvannstilkobling maks. 2 m fra instrumentet. Denne koblingen må være koblet til instrumentet med en fast avløpsslange som går nedover og bort fra instrumentet.



##### Advarsel

- Tilkobling til et eksternt avtrekkssystem (anbefales på det sterkeste), ventilasjonssystem for tekniske rom og et integrert avtrekkssystem med aktivt kullfilter som reduserer konsentrasjonen av løsemiddeldamp i rommet. Det aktive kullfilteret må også brukes for å koble til et eksternt avtrekkssystem. Dette er obligatorisk.
- Brukeren har ansvar for å overholde grenseverdiene for arbeidsstedet og følge de tiltakene som kreves for å overholde dem, inkludert dokumentasjon.

- Det må finnes en **JORDET STIKKONTAKT** maks. 3 m fra instrumentet.

## 4.2 Skyllevannstilkobling



### Merk

- Du kan velge mellom to tilkoblingstyper (→ S. 26 – 4.2.1 Knutepunktsforbindelse for alle seks skyllevannstasjoner). Instrumentet må programmeres til tilkoblingstypen som brukes (→ S. 95 – Fig. 73).

De følgende installasjonsinstruksjonene gjelder begge tilkoblingstyper:

- Ta skyllevannslangen (→ "Fig. 4-1") ut av pakken.
- Koblingen til vannforsyningen er rett (→ "Fig. 4-3"), og koblingen til instrumentsiden er vinklet (→ "Fig. 4-4").
- Kontroller at tetningsringene (→ "Fig. 4-2") er festet til koblingen for vannforsyningen (→ "Fig. 4-3") og til koblingen på instrumentsiden (→ "Fig. 4-4").



### Advarsel

Slangen kan ikke kobles til hvis tetningsringene mangler! Ta i så fall kontakt med det ansvarlige Leica-servicesenteret.

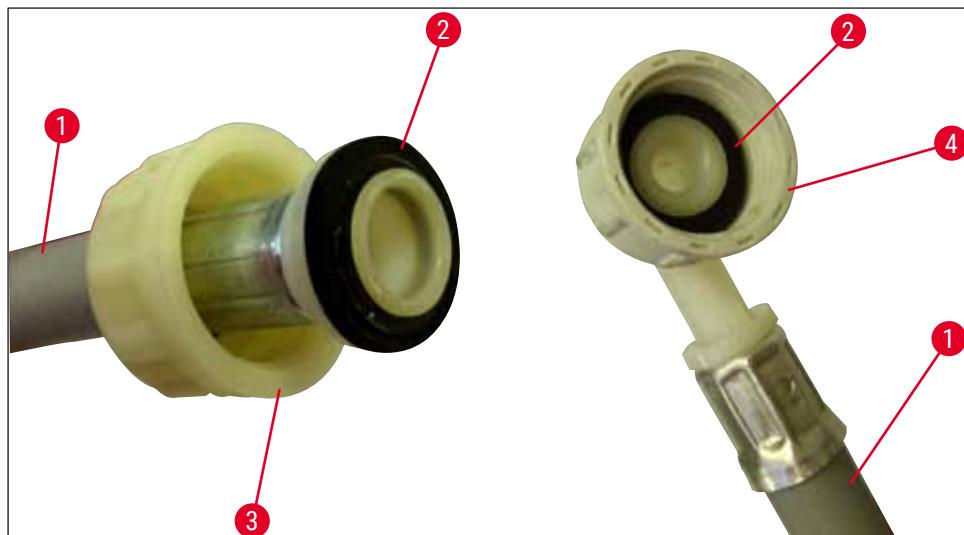


Fig. 4



### Advarsel

Uansett hvilken tilkoblingstype som er valgt (6 skyllevannstasjoner eller 4 skyllevannstasjoner og 2 demineralisert vannstasjoner), er begge tilførselsslangene alltid tilkoblet instrumentet.

Vanntilførselen må kobles fra ved midlertidig stopp av instrumentet og når instrumentet slås av.

## 4 Installasjon og oppstart

### 4.2.1 Knutepunktsforbindelse for alle seks skyllevannstasjoner

Hvis samtlige vannbeholdere (6 skyllevannstasjoner) skal kobles til en delt skyllevannstilkobling, må begge tilførselsslangene (→ "Fig. 5") brukes som vist. Begge skyllevannstilkoblingene (→ "Fig. 5-4") kobles til en enkelt vannkran (→ "Fig. 5-8") med Y-stykket:

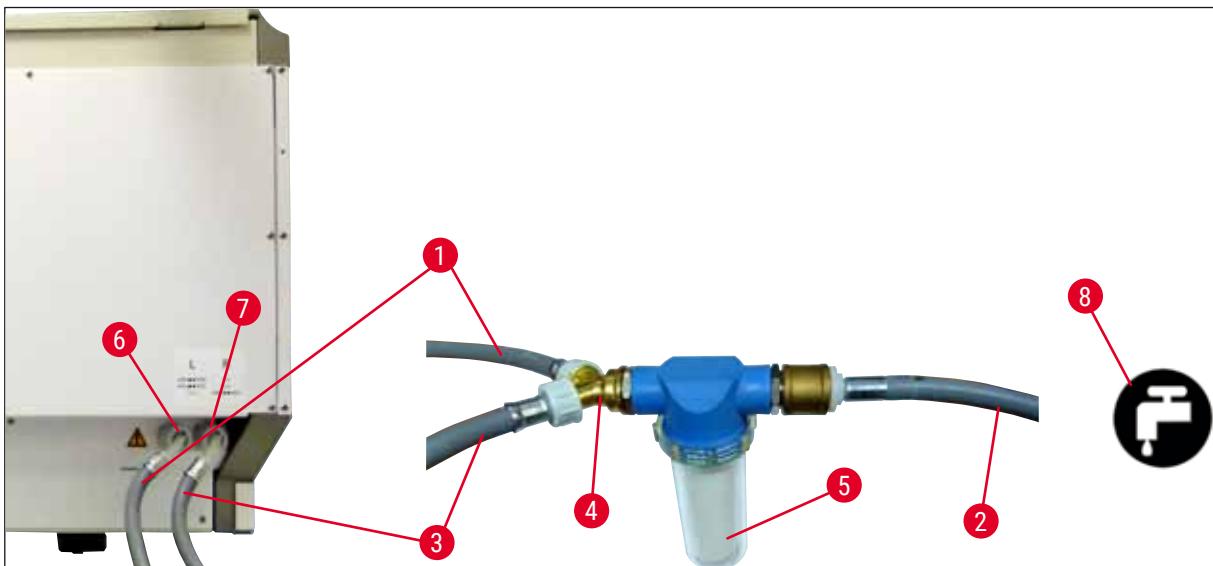


Fig. 5

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1 Vanninnløpsslange 1 (2,5 m)                                    | Bestillingsnr.: 14 0474 32325 |
| 2 Forlengelsesslange, 1,5 m                                      | Bestillingsnr.: 14 0512 49334 |
| 3 Vanninnløpsslange 2 (2,5 m)                                    | Bestillingsnr.: 14 0474 32325 |
| 4 Y-kobling  | Bestillingsnr.: 14 3000 00351 |
| 5 Filterhus  | Bestillingsnr.: 14 0512 49331 |
| 6 Skyllevannstilkobling (gruppe med 4)                           |                               |
| 7 Tilkobling for destillert vann eller skyllevann (gruppe med 2) |                               |
| 8 Skyllevannstilkobling på laboratoriet                          |                               |

### 4.2.2 Kombinert tilkobling 4+2 skyllevannstasjoner

Hvis hovedtilkoblingen (4 skyllevannstasjoner) skal kobles til ferskvann og den sekundære tilkoblingen (2 skyllevannstasjoner) skal kobles til en forsyning med destillert vann eller avsaltet (demineralisert vann) på laboratoriet, følger du tilkoblingsdiagrammet nedenfor:

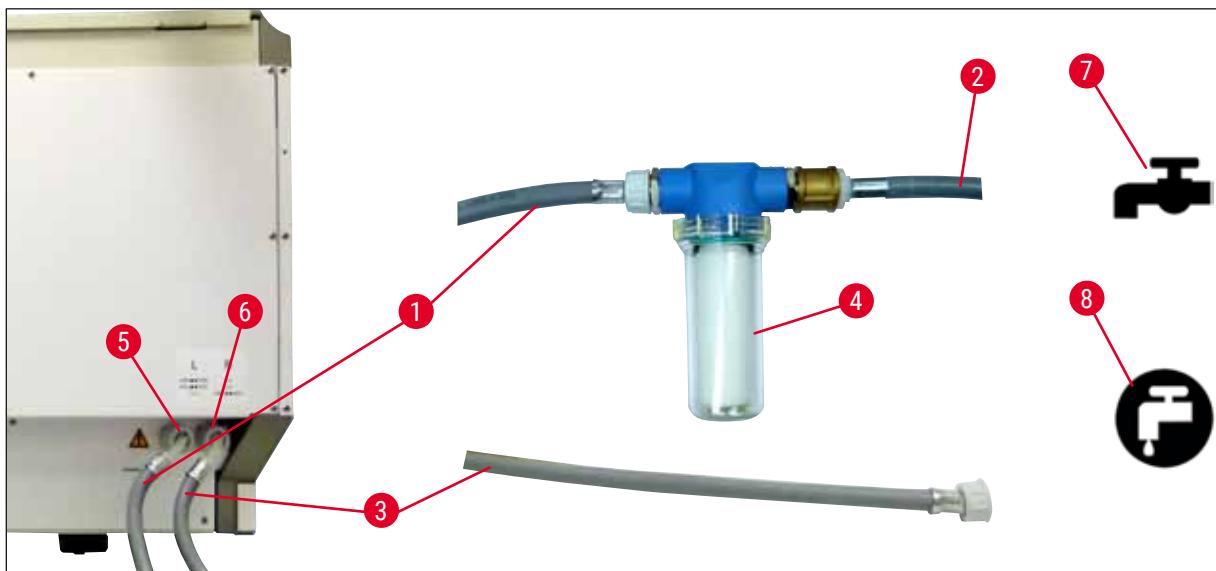


Fig. 6

- |   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | Vanninnløpsslange 1 (2,5 m)                                       | Bestillingsnr.: 14 0474 32325 |
| 2 | Forlengelsesslange, 1,5 m   | Bestillingsnr.: 14 0512 49334 |
| 3 | Vanninnløpsslange 2 (2,5 m)                                       | Bestillingsnr.: 14 0474 32325 |
| 4 | Filterhus   | Bestillingsnr.: 14 0512 49331 |
| 5 | Skyllevannstilkobling (gruppe med 4)                              |                               |
| 6 | Tilkobling for destillert vann eller skyllevann<br>(gruppe med 2) |                               |
| 7 | Skyllevannstilkobling på laboratoriet                             |                               |
| 8 | Tilkobling med destillert/demineralisert vann på<br>laboratoriet  |                               |

**Advarsel**

Det er svært viktig at du kobler forsyningsslangene riktig (→ "Fig. 2-8")!

## 4 Installasjon og oppstart

### 4.2.3 Spillvannstilkobling



#### Merk

Instrumentet har et passivt spillvannsavløp. Sifongen til laboratorieavløpet må derfor være plassert minst 50 cm under instrumentets spillvannsavløp.



#### Advarsel

Avløpsslangen (→ "Fig. 7-1") må ledes jevnt nedover, aldri oppover.

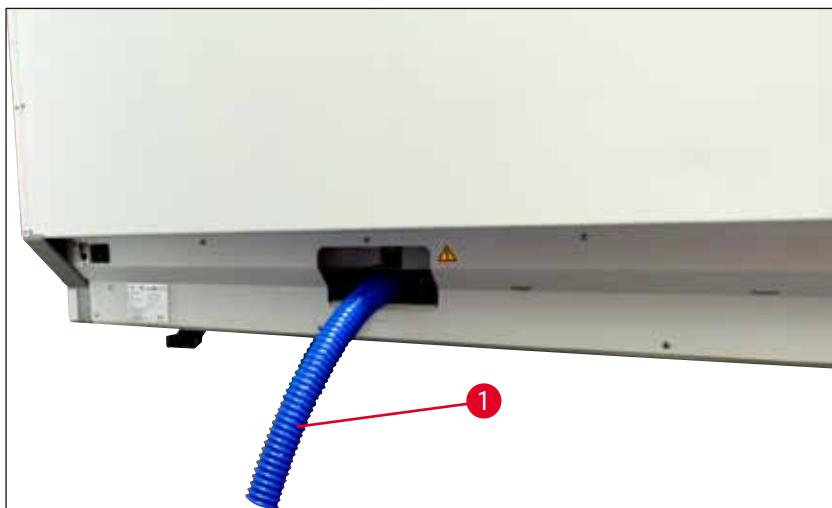


Fig. 7

### 4.3 Strømtilkobling



#### Advarsel

- Bruk kun strømledningen som følger med. Den er beregnet på den lokale strømforsyningen.
- Før strømledningen kobles til strømforsyningen, må du påse at strømbryteren foran til høyre på instrumentet står i **AV**-posisjon ("0").

- Koble strømledningen til strøminntaket på instrumentets bakpanel (→ "Fig. 8-1").
- Plugg strømledningen inn i en jordet stikkontakt.

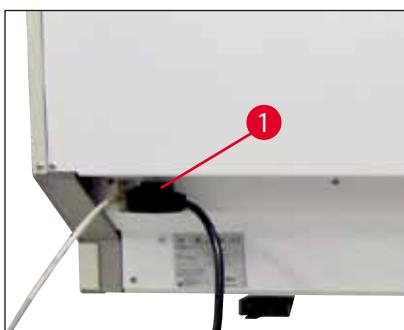


Fig. 8

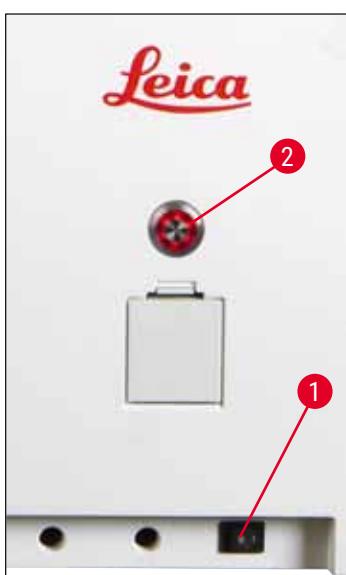


Fig. 9

- Slå på **strømbryteren** (→ "Fig. 9-1").
- Etter kort tid begynner **driftsbryteren** å lyse oransje. Når programvaren er ferdig med å starte opp, lyser bryteren rødt (→ "Fig. 9-2") og instrumentet er i **ventemodus**.
- **Driftsbryteren** kan deretter brukes (→ S. 31 – 4.5 Slå instrumentet på og av).

#### 4.3.1 Bruk av avbruddsfri strømforsyning (UPS)

Avbrudd i fargeprosessen under et midlertidig strømbrudd kan unngås ved å koble til en batteribufret, avbruddsfri strømforsyning (→ "Fig. 10-1") (UPS). Den avbruddsfrie strømforsyningen leverer en effekt på minst 1580 VA i 10 minutter. UPS-en må være beregnet på spenningen som brukes ved installasjonsstedet. Tilkoblingen skjer ved å koble HistoCore SPECTRA ST strømledningen til UPS-uttaket. UPS-en kobles til stikkontakten på laboratoriet.

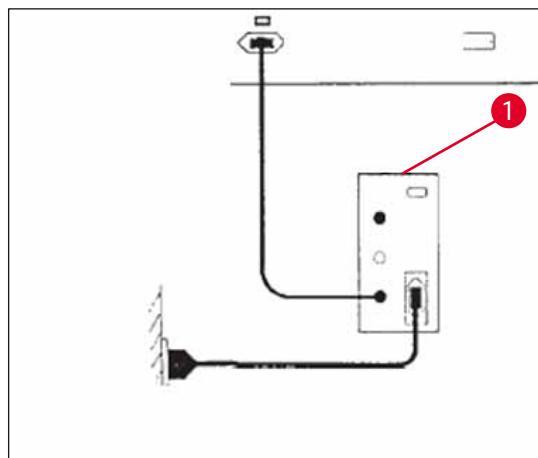


Fig. 10



#### Advarsel

UPS-strømledningen må være plugget inn i stikkontakten på laboratoriet til enhver tid, til og med hvis strømmen går. Ellers risikerer du at instrumentet mister jordingen!

## 4 Installasjon og oppstart

### 4.4 Avtrekkslufttilkobling

- » Koble den ene enden av luftavtrekksslangen (→ "Fig. 11-1") til avløpet (→ "Fig. 11-2") på toppen av instrumentet. Koble den andre enden til luftavtrekksenhet på laboratoriet.

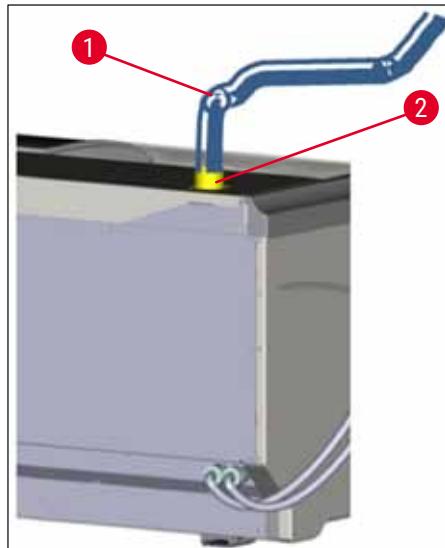


Fig. 11



#### Advarsel

- Tilkobling til et eksternt avtrekkssystem (anbefales på det sterkeste) og et integrert avtrekkssystem med aktivt kullfilter er påbudt og reduserer konsentrasjonen av løsemiddel i rommet. Beholderne må dekkes til når instrumentet ikke er i bruk for å unngå unødvendig fordamping av reagensene.
- Eier/bruker må sørge for at grenseverdiene for arbeidsplassen overholdes ved alt arbeid med farlige materialer.

#### 4.5 Slå instrumentet på og av



##### Advarsel

Instrumentet må være koblet til et jordet strømmuttak. For ekstra beskyttelse av sikringene anbefales det å koble HistoCore SPECTRA ST til et uttak med reststrøm-kretsbryter.

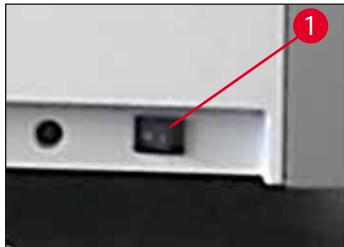


Fig. 12

- Sett **strømbryteren** foran nede til høyre på instrumentet i **PÅ**-posisjon ("I") (→ "Fig. 12-1").



Fig. 13

- Noen få sekunder etter at **strømbryteren** er slått på, begynner **driftsbryteren** å lyse oransje (→ "Fig. 13"). Når **driftsbryteren** lyser rødt, avsluttes startprosessen for programvaren.



##### Merk

Instrumentet starter ikke hvis du trykker på **driftsbryteren** mens den lyser oransje.



Fig. 14

- Trykk på **driftsbryteren** (→ "Fig. 13") når den lyser rødt for å starte instrumentet. Et lydsignal avgis.
- I forbindelse med initialiseringen foretas en automatisk kontroll av alle stasjoner ("Skanning av påfyllingsnivå").
- **Driftsbryteren** lyser grønt når instrumentet er klart til å startes.
- Når initialiseringsfasen er fullført, vises "hovedmenyen" (→ "Fig. 14") på skjermen.

## 4 Installasjon og oppstart

### Slå av instrumentet

- Instrumentet settes i ventemodus (f.eks. til neste dag) ved å trykke to ganger på **driftsbryteren** (→ "Fig. 13"). Bryteren lyser da rødt.
- I forbindelse med rengjøring og vedlikehold må instrumentet også slås av med **strømbryteren** (→ "Fig. 12-1").



#### Merk

Under konfigurering av instrumentet, og hvis det ikke er fylt på reagenser, blir tomme stasjoner identifisert og vist på skjermen (→ S. 90 – 6.2.2 Automatisk skanning av påfyllingsnivå).



#### Advarsel

Hvis et ovnstrinn er angitt som første trinn i fargeprogrammet, kan programmet bli merket "kan ikke startes" når instrumentet slås på, siden ovnen enda ikke har nådd driftstemperatur. Så snart driftstemperaturen er nådd, vil programmet være klart til å startes.

## 5. Drift

### 5.1 Brukergrensesnitt – oversikt

HistoCore SPECTRA ST programmeres og betjenes via en fargeberøringsskjerm. Følgende skjermbilde vises når instrumentet slås på, hvis ingen fargeprosesser (programmer) pågår.

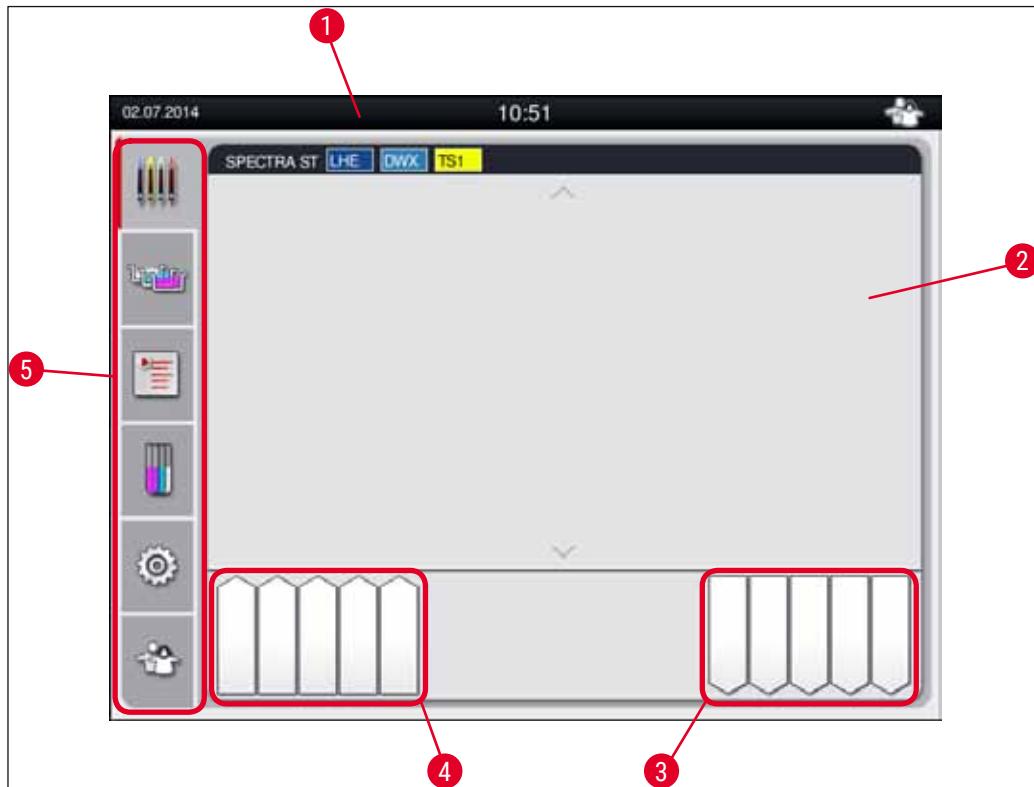


Fig. 15

- 1 Statuslinje
- 2 Prosesstatusvisning
- 3 Status utmatingsskuff
- 4 Status mateskuff
- 5 Hovedmeny (→ S. 38 – 5.5 Hovedmeny – oversikt)

## 5 Drift

### 5.2 Elementene i statusvisningen

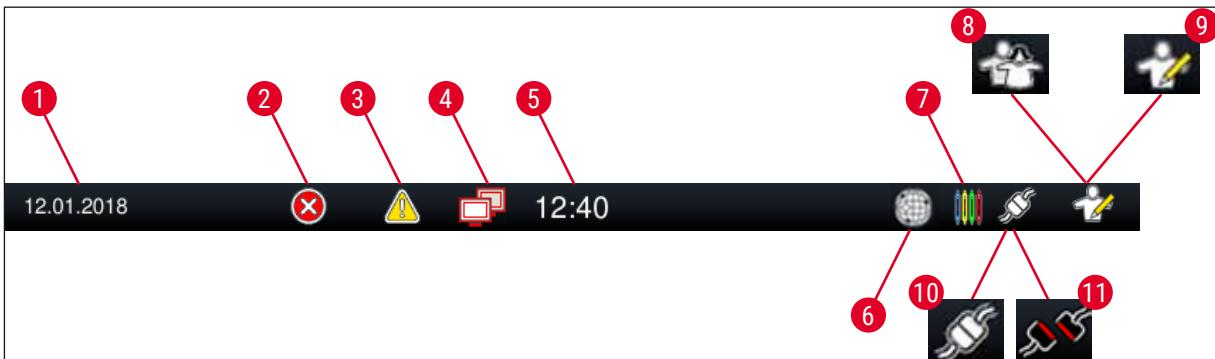


Fig. 16

- 1 Dagens dato
- 2 Dette alarmsymbolet dukker opp hvis det utløses alarmer og feilmeldinger mens instrumentet er i drift. Trykk på symbolet for å vise de siste 20 aktive informasjonsmeldingene.
- 3 Dette meldingssymbolet dukker opp hvis det vises advarsler og merknader mens instrumentet er i drift. Trykk på symbolet for å vise de siste 20 aktive informasjonsmeldingene.
- 4 Dette symbolet angir at det er opprettet en forbindelse til Fjernhjelp-serveren, og at en Leicaservicetekniker har tilgang til skjermen. Brukeren kan avbryte forbindelsen ved å trykke på dette symbolet.
- 5 Lokal tid
- 6 Symbolet for "Fjernhjelp-tilgang" viser at instrumentet er koblet til tjenesten Leica Fjernhjelp via en nettverkstilkobling.
- 7 Symbolet for "prosess" angir at en fargeprosess pågår, og at det fremdeles kan være stativer i utmatningsskuffen.
- 8 Dette "bruikersymbolet" angir at instrumentet er i brukermodus, det vil si enkel drift av instrumentet som ikke krever passordpålogging.
- 9 Dette symbolet viser at instrumentet kjøres i "administratormodus". Denne modusen gir tilgang til flere drifts- og justeringsalternativer for personell som har fått nødvendig opplæring. Modusen er passordbeskyttet.
- 10 Forbindelsen mellom HistoCore SPECTRA ST og HistoCore SPECTRA CV er opprettet.
- 11 Forbindelsen mellom HistoCore SPECTRA ST og HistoCore SPECTRA CV er brutt.

### 5.3 Prosesstatusvisning

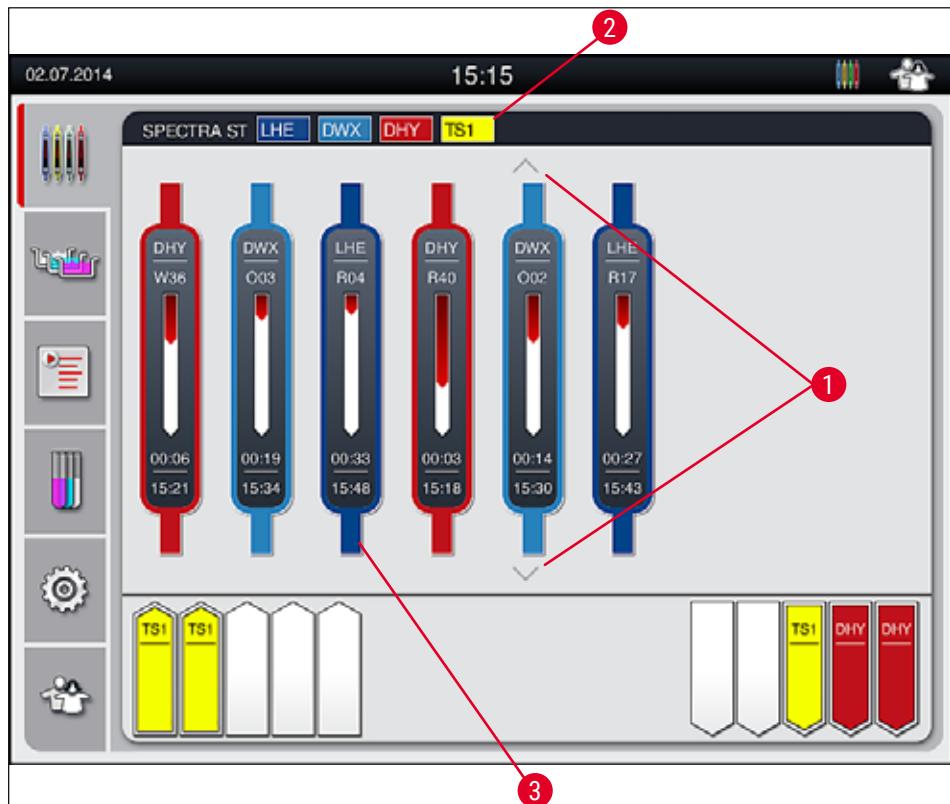


Fig. 17

Hovedskjerm bildet (→ "Fig. 17") viser alle stativene (→ "Fig. 17-3") som er plassert i instrumentet.



#### Merk

En aktiv fargeprosess angis ved at den øverste delen av håndtakssymbolet har den aktuelle fargen (→ "Fig. 17-3"). Hvis antallet objektglassholdere i prosessen overskriver antallet som maksimalt kan vises på hovedskjerm bildet (maks. 9), kan du bla opp og ned i visningsområdet ved hjelp av tastene (→ "Fig. 17-1"). Hvis en av knappene er nedtonet, betyr det at knappen er deaktivert, og at det ikke er andre elementer å vise i dette området.

Tittellinjen i hovedskjerm bildet (→ "Fig. 17-2") angir instrumenttypen **[SPECTRA ST]** og viser hvilke fargeprogrammer som er klare til å startes. Det brukes definerte forkortelser og fargen som er tilordnet stativene.

## 5 Drift



### Merk

Alle pågående fargeprosesser er illustrert med et symbol for stativhåndtaket. Det vises i samme farge som det faktiske stativhåndtaket. Håndtakssymbolet inneholder forskjellig informasjon (→ "Fig. 18").

Hvis **fargemaskinen** HistoCore SPECTRA ST er koblet permanent til den automatiske dekkglassmaskinen HistoCore SPECTRA CV, kan begge enhetene betjenes som en arbeidsstasjon. På denne måten er arbeidsflyten kontinuerlig helt fra fargeprosessen frem til de fullførte objektglassene med dekkglass fjernes. Overføringstiden til HistoCore SPECTRA CV vises også i prosessens statuslinje (→ "Fig. 18-6").

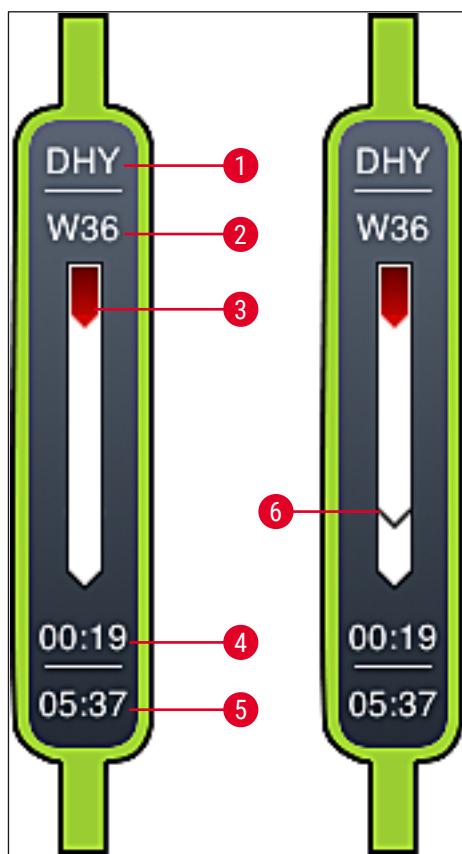


Fig. 18

- 1 Forkortelse for programnavnet
- 2 Stativets nåværende posisjon i instrumentet
- 3 Fremdriftsvisning av hele fargeprosessen
- 4 Anslått gjenstående tid av programmet (tt:mm)
- 5 Faktisk tid ved slutten av programmet
- 6 Overføringstiden til den automatiske dekkglassmaskinen HistoCore SPECTRA CV under drift som arbeidsstasjon (→ S. 109 – 6.6.5 Drift som arbeidsstasjon)

## 5.4 Vise skuffene

Området nederst i hovedskjermbildet viser statusene til inn- og utmatingsskuffene.

- Stasjonene som peker inn mot instrumentet (→ "Fig. 19-1"), symboliserer mateskuffen. Stasjonene som peker ut fra instrumentet (→ "Fig. 19-2"), symboliserer utmatingsskuffen. Begge har fem posisjoner.
- Skuffene åpnes eller lukkes automatisk ved å trykke på skuffknappen (→ "Fig. 19-3") eller (→ "Fig. 19-4").
- Instrumentet registrerer automatisk om stativene er satt inn eller tatt ut når skuffen lukkes.
- Stativene i inn- eller utmatingsskuffen vises på skjermen med tilsvarende håndtaksfarge og forkortelse for tilordnet program.
- Ledige posisjoner vises i hvitt.



### Merk

Inn- og utmatingsskuffene kan åpnes hvis skuffknappen lyser grønt (→ "Fig. 19-4"). Når stativene transporteres ut av mateskuffen eller inn i utmatingsskuffen, lyser knappen på den tilsvarende skuffen rødt (→ "Fig. 19-3"). Skuffen kan ikke åpnes.

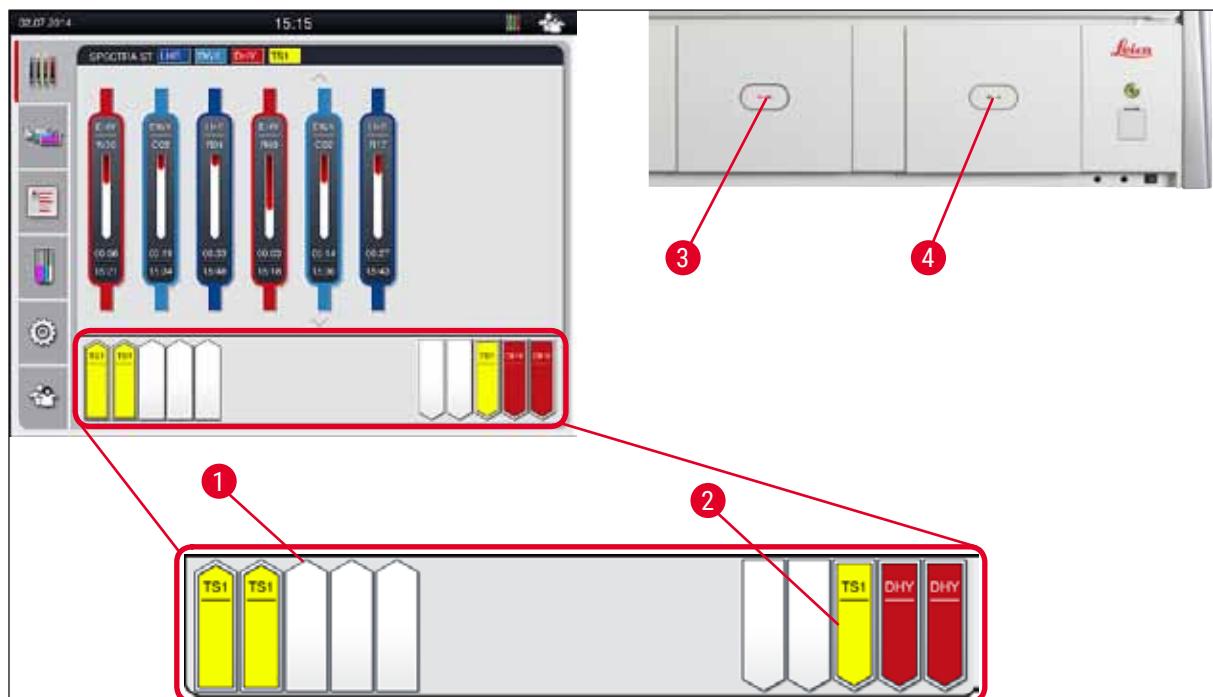


Fig. 19



### Advarsel

Vær forsiktig når du åpner og lukker skuffene. Klemfare! Skuffene er motoriserte og åpnes automatisk når du trykker på knappen. Pass på at ingenting blokkerer for skuffene.

## 5.5 Hovedmeny – oversikt

Hovedmenyen er på venstre side av skjermen (→ "Fig. 15-5"), som er delt inn som beskrevet nedenfor. Denne menyen er synlig hele tiden, slik at du når som helst kan velge en annen undermeny.



"**Prosesstatusvisningen**" viser gjeldende status for alle stativene som behandles. Her vises håndtaket til stativet som et symbol i den tilsvarende fargen.


Illustrasjonen viser standardvisningen.



"**Fargebadlayouten**" viser en oversikt over alle stasjonene i instrumentet. De individuelle reagensstasjonene vises med forkortede reagensnavn, stasjonsnumre og stativer som behandles.



Når "**programlisten**" er aktivert, vises alle de tilgjengelige fargeprogrammene i instrumentet i en liste. Denne menyen gjør det mulig å gå tilbake til og endre fargeprogrammene, prioritetsrekkefølgen og utførelsen av fargebadlayouten.



Når "**reagenslisten**" er aktivert, vises alle reagenser som tidligere har vært oppgitt, i listeformat. Via menyen kan du endre og oppgi fargereagenser på nytt, f.eks. i nye fargeprogrammer. Reagensene må oppgis før programmet opprettes.



Grunninnstillingene konfigureres i menyen "**Innstillinger**". Her kan språkversjon, dato og klokkeslett, samt ovnstemperatur og andre parametere justeres i henhold til lokale behov.



I menyen "**Brukerinnstillinger**" kan det opprettes et individuelt passord som hindrer at uautoriserte personer foretar endringer i programmer og reagenslister ("Administratormodus"). Instrumentet kan imidlertid brukes uten passord i "**Brukermodus**".

### 5.5.1 Tastaturet



#### Merk

Når det er nødvendig å skrive inn informasjon (f.eks. for å opprette programmer, redigere programmer eller legge inn passord), vises et tastatur på skjermen (→ "Fig. 20"). Det kan brukes ved å trykke på berøringsskjermen.

Legg merke til at tastaturet som vises, avhenger av språket som er valgt.

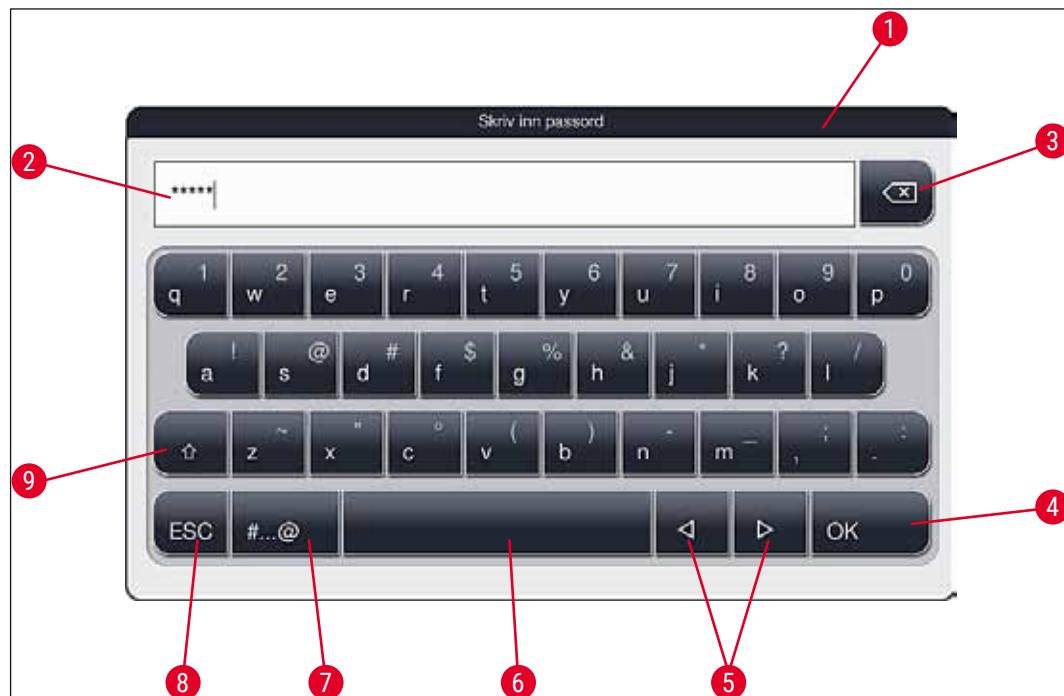


Fig. 20

- 1 Tittellinje
- 2 Tekstfelt
- 3 Sletter det sist inntastede tegnet
- 4 Bekreftelse
- 5 Flytt markøren til venstre eller høyre
- 6 Mellomromstast
- 7 Skift-knapp for spesialtegn (→ "Fig. 21")
- 8 Avbryt (informasjonen vil ikke bli lagret!)
- 9 Stor og liten bokstav (trykk to ganger for å aktivere tastelås, tasten blir rød. Trykk én gang til for å oppheve tastelås og skrive små bokstaver)

## 5 Drift

### Spesialtegn



Fig. 21

### Andre spesialtegn



Fig. 22

- Du skriver spesialtegn, omlyd e.l. som ikke står oppført på spesialtegntastaturet (→ "Fig. 21"), ved å holde nede den tilsvarende normale tasten på tastaturet.
- Eksempel: Holder du nede den vanlige "a"-knappen, kommer det opp andre alternativer (→ "Fig. 22").
- Velg ønsket tegn fra det nye enkeltlinje-tastaturet ved å trykke på det.



#### Merk

Disse lengdebegrensningene gjelder passord og navn:

- Reagensnavn: maks. 30 tegn / reagensforkortelser: maks. 10 tegn
- Programnavn: maks. 32 tegn / programforkortelser: maks. 3 tegn
- Passord: min. 4 tegn, maks. 16 tegn

### 5.6 Brukerinnstillinger



Denne menyen brukes for å konfigurerer riktig tilgangsnivå. Det skiller mellom:

- Standardbruker
- Administrator (passordbeskyttet)
- Servicetekniker (passordbeskyttet)

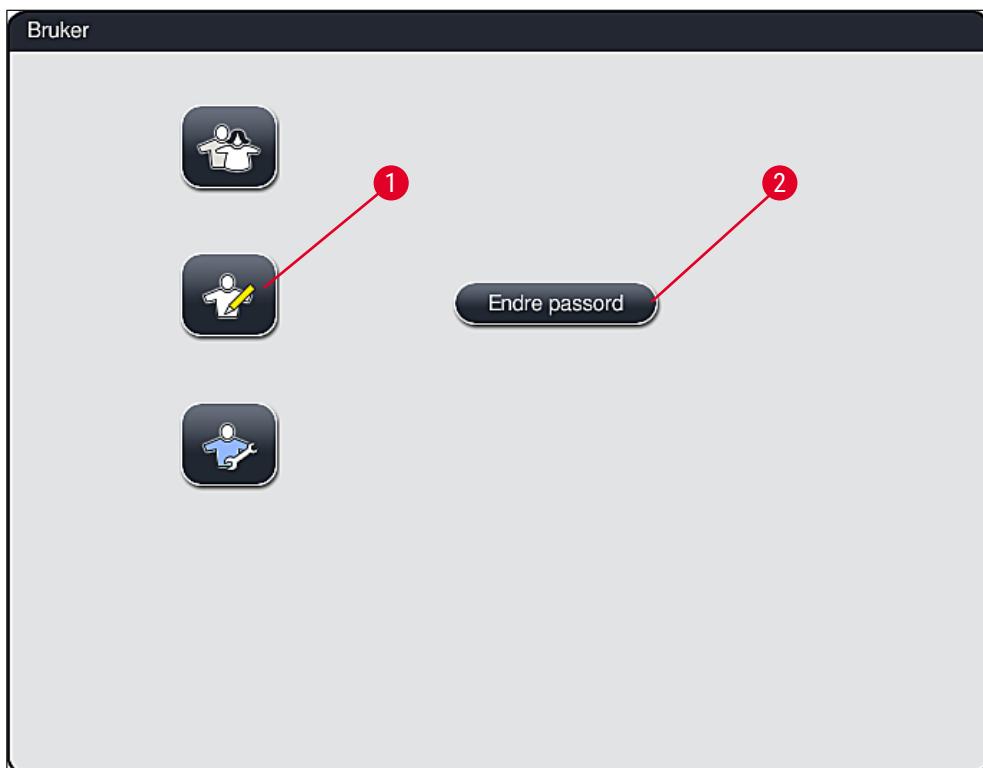


Fig. 23

**Standardbruker:**

Standardbrukere trenger ikke å logge på med passord, og kan bruke det ferdigkonfigurerte instrumentet til rutinehandlinger. Det er ikke mulig for denne brukergruppen å endre programmer eller innstillinger.

**Administrator:**

Administratorer har tilgang til de samme alternativene som standardbrukere, men kan i tillegg opprette programmer og konfigurere instrumentet. Administratortilgangen er derfor beskyttet med passord.

Slik aktiverer du administratormodus:

1. Trykk på "Administrator"-knappen (→ "Fig. 23-1").
2. Et tastatur (→ "Fig. 24") til å skrive inn passordet med vises på skjermen.
3. Fullfør ved å trykke på "OK". Passordet du la inn, kontrolleres.
4. Gjeldende brukerstatus vises i form av et symbol på statuslinjen (→ "Fig. 16") øverst til høyre.



Fig. 24

### Merk

Passordet som er konfigurerert på fabrikken, må benyttes første gang instrumentet konfigureres.

#### Slik endrer du administratorpassordet:

1. Endre passordet ved å trykke på knappen "Endre passord" (→ "Fig. 23-2") og angi det gamle passordet.
2. Skriv deretter inn det nye passordet to ganger ved hjelp av tastaturet, og trykk på "OK".

### Merk

Passordet må bestå av minst 4 tegn og kan ha opptil 16 tegn.



#### **Servicetekniker:**

Serviceteknikeren har tilgang til systemfiler og kan foreta grunninnstillinger og utføre tester.

## 5.7 Grunninnstillinger

### Merk

Alle innstillingssendringer, for eksempel den første konfigureringen av instrumentet, må foretas i administratormodus (→ S. 41 – Slik aktiverer du administratormodus:).

Trykk på tannhjulsymbolet (→ "Fig. 25-1") for å åpne menyen "Innstillinger" (→ "Fig. 25"). I denne menyen kan du konfigurere grunninnstillinger for instrumentet og programvareinnstillinger.

- Når du trykker på et symbol (→ "Fig. 25-2"), blir det valgt og merket med rødt.
- Det tilhørende innstillingsskjerm bildet vises til høyre på skjermen.
- De individuelle undermenyene er beskrevet nedenfor.

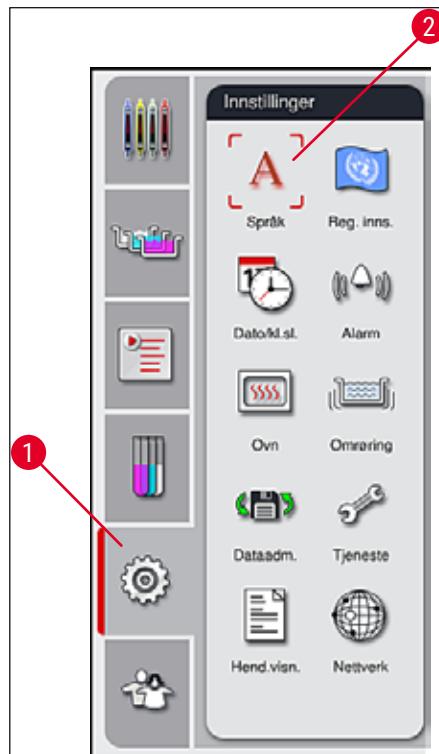


Fig. 25

### 5.7.1 Språkinnstiller



- Språkmenyen åpnes når du trykker på symbolet for Språk (→ "Fig. 25-2"). Denne menyen inneholder en oversikt over alle språkene som er installert og kan velges på instrumentet.

- Velg ønsket språk, og bekrefte med å trykke på "Lagre".
- Skjermvisningen, informasjonsmeldinger og etiketter vises deretter på språket du har valgt.



#### Merk

Administratoren eller en Leica-servicetekniker kan legge til nye språk ved å velge Import (→ S. 49 – 5.7.7 Datastryring).

## 5 Drift

### 5.7.2 Regionale innstillinger



I denne menyen kan du konfigurere grunninnstillinger for skjermvisningen (→ "Fig. 26").

#### Temperaturenhet

- Konfigurer temperaturenheten (→ "Fig. 26-1") som Celsius eller Fahrenheit. Dette gjør du ved å skyve glidebryteren til ønsket enhet.

#### Klokkeslettformat

- Klokkevisningen (→ "Fig. 26-2") kan angis i 24-timers format eller 12-timers format (a.m. = formiddag / p.m. = ettermiddag) ved hjelp av glidebryteren.

#### Datoformat:

- Konfigurer datovisningen (→ "Fig. 26-3") til internasjonalt format, ISO-format eller US-format ved å trykke på alternativknappen ved siden av ønsket format.
- Den aktiverede innstillingen angis med en rød ramme (→ "Fig. 26-4").
- Trykk på Lagre-knappen for å lagre innstillingene.

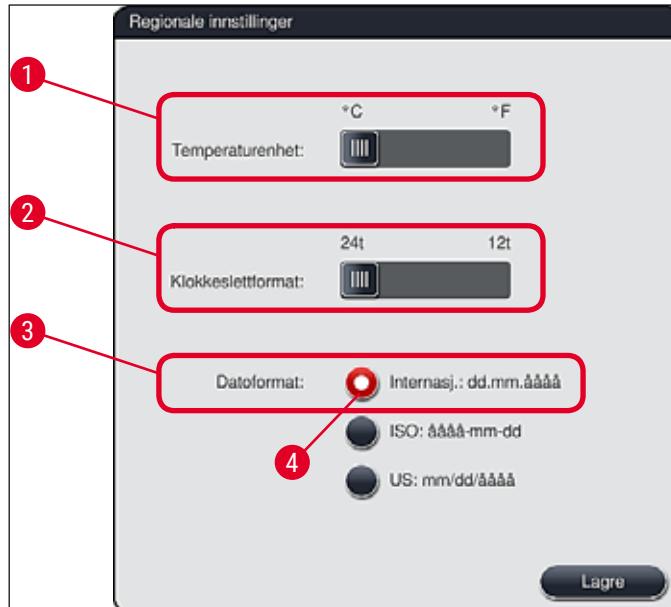


Fig. 26

### 5.7.3 Dato og klokkeslett



Gjeldende dato og lokal tid kan konfigureres i denne menyen (→ "Fig. 27") ved å rotere de individuelle hjulene.



#### Merk

I 12-timers format vises a.m. (formiddag) og p.m. (ettermiddag) under klokkeslettet.

Dato og klokkeslett kan ikke avvike mer enn 24 timer fra systemtiden som er konfigurert på fabrikken.

- Trykk på Lagre-knappen for å lagre innstillingene.



Fig. 27

### 5.7.4 Meny for alarmlyder – Feil- og signallyder



I denne menyen kan du velge alarm- og signallyd, justere volumet og teste funksjonaliteten (→ "Fig. 28-6").

Den gjeldende innstillingen for alarm- og signallyder, vises når du henter frem menyen.

## 5 Drift



### Advarsel

- En alarmlyd avgis når instrumentet startes. Hvis det ikke avgis noen lyd, kan ikke instrumentet brukes. Det er for å beskytte prøvene og brukeren. Ta i så fall kontakt med det ansvarlige Leica-servicesenteret.
- Den akustiske alarmlyden kan ikke deaktiveres. Minste konfigurerbare verdi for volumet, er 2. Maksimal volumverdi er 9.

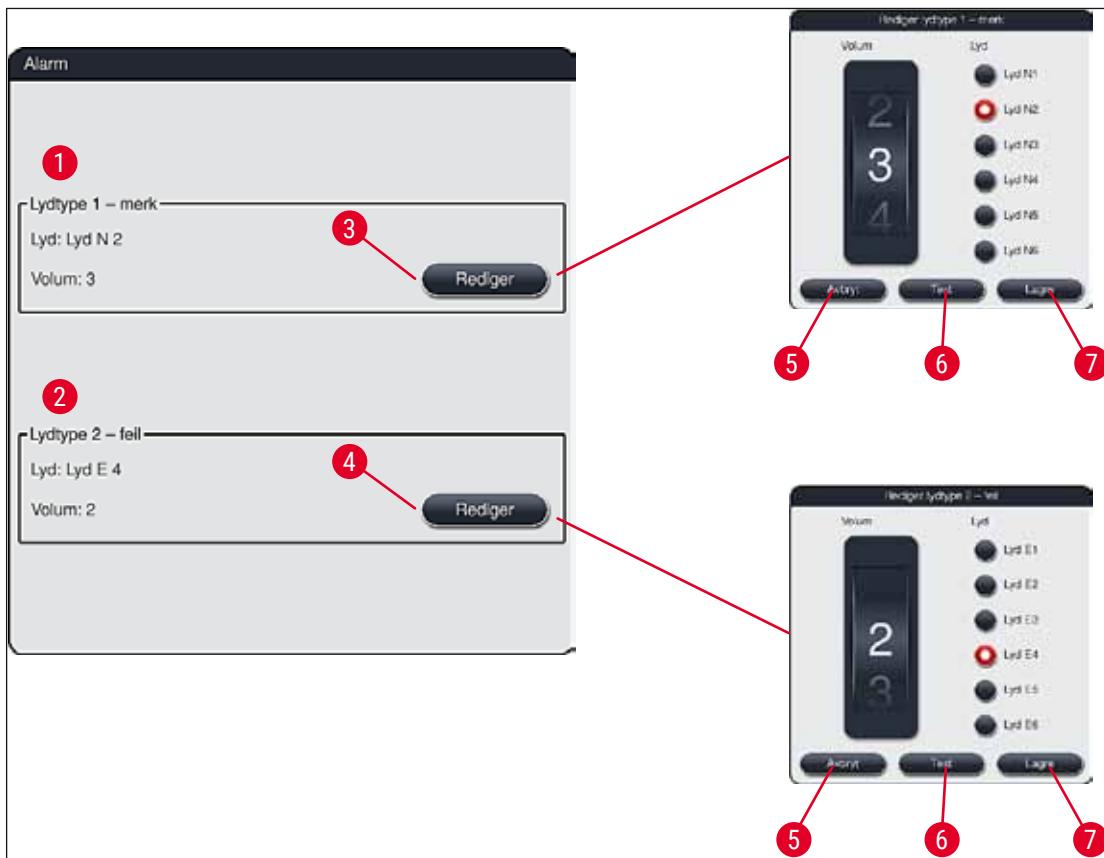


Fig. 28



### Lydtype 1 – merk ([→ "Fig. 28-1"](#))

Signallydene avgis hvis det vises advarselmeldinger eller merknader på skjermen. Velg fra en liste med seks lyder. Hvis du vil endre innstillingene, trykker du på Rediger-knappen ([→ "Fig. 28-3"](#)). Volumet kan justeres trinnvis ved å vri på hjulet (0 til 9).



### Lydtype 2 – feil: (→ "Fig. 28-2")

Alarmslydene avgis hvis det vises en feilmelding på skjermen. Dette krever umiddelbar handling fra brukeren. Velg fra en liste med seks lyder. Hvis du vil endre innstillingene, trykker du på Rediger-knappen (→ "Fig. 28-4").

- Juster voluminnstillingen for alarmslyder med Volum-hjulet. Det finnes seks ulike lyder for alarmtypene. Du kan bruke Test-knappen (→ "Fig. 28-6") for å høre de ulike lydene.
- Trykk på Lagre (→ "Fig. 28-7")-knappen for å lagre innstillingene. Avbryt-knappen (→ "Fig. 28-5") brukes for å lukke vinduet uten å ta i bruk innstillingene.

#### 5.7.5 Ovnsinnstillinger



I menyen for ovnsinnstillinger konfigurerer du ovnstemperaturen og driftsmodusen til ovnen (→ "Fig. 29"). De gjeldende ovnsinnstillingene vises når du henter frem menyen.



#### Advarsel

Hvis ovnstemperaturen endres, kan det få følger for fargeresultatet.

Hvis den angitte ovnstemperaturen er for høy, kan prøven påvirkes negativt.

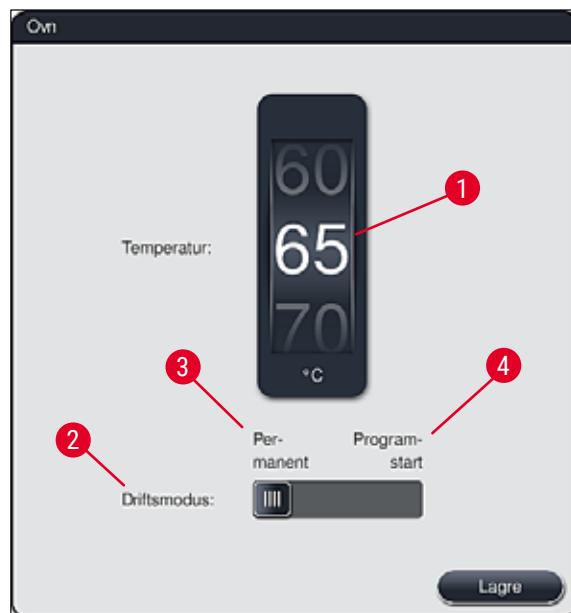


Fig. 29

## 5 Drift

### Temperatur:

Vri på hjulet (→ "Fig. 29-1") for å endre ovnens måltemperatur fra 40 °C til 70 °C i trinn på 5 °C.

### Driftsmodus:

Velg mellom følgende driftsmoduser (→ "Fig. 29-2"):

- Varme opp ovnen når et program startes (→ "Fig. 29-4") (**Programstart**), eller:
- Starte ovnen når instrumentet slås på (→ "Fig. 29-3") (**Permanent**).
- Skyv på glidebryteren for å endre innstillingene.
- Trykk på **Lagre**-knappen for å lagre innstillingene.



#### Merk

- Du må være logget på som "Administrator" med passord for å lagre endringene. I enkel brukermodus er **Lagre**-knappen nedtonet og deaktivert.
- Temperaturinnstillingen kan ikke endres hvis Leicas fargeprogrammer er integrert i fargebadlayouten (→ S. 76 – 5.9.9 Utføre fargebadlayout). Se informasjonen som fulgte med Leica-reagenssettet for å finne standardtemperaturen.



#### Advarsel

- Vi anbefaler at du velger **Permanent** for å unngå unødvendig ventetid for oppvarming av ovnen.
- Omgivelsesforholdene kan noen ganger føre til at ovnstemperaturen som er angitt, avviker fra innstillingsverdien med -8 °C til +5 °C. Omgivelsesforholdene må derfor tas hensyn til når ovnstemperaturen angis for spesielt sensitive prøver (f.eks. ved å redusere temperaturen med 5 °C og forlenge ovnstrinnet tilsvarende).

### 5.7.6 Bevegelseshastighet – opp/ned-bevegelse (omrøring)



Bevegelseshastigheten for opp/ned-bevegelsen av stativets holderamme justeres i menyen **Omrøring** (→ "Fig. 30"). Håndtakene til stativet ligger i holderammen, som beveges opp og ned i fargeprosessen (omrøring).

Den gjeldende innstillingen vises når du henter frem menyen.



#### Merk

Omrøringen bidrar til å røre sammen de tilsatte reagensene under de pågående fargeprosessene. Du må være logget på som **Administrator** med passord for å justere bevegelseshastigheten (omrøring).

**Hastighet:**

Vri på **Hastighet**-hjulet (→ "Fig. 30-1") for å konfigurere omrøringsfrekvensen i fem trinn (0 = omrøring deaktivert, 5 = høyeste hastighet). Jo høyere verdi, desto raskere omrøring.

Trykk på **Lagre**-knappen for å lagre innstillingene.

**Merk**

- Omrøringshastigheten i brukerdefinerte programmer kan bare endres så lenge ingen godkjente Leica-programmer er aktive. I slike tilfeller er hjulet svart og aktivert.
- Omrøringen er forhåndsinnstilt (fast) for godkjente Leica-programmer (se brukerhåndboken til Leica-reagenssettet). Hjulet er nedtonet og deaktivert.

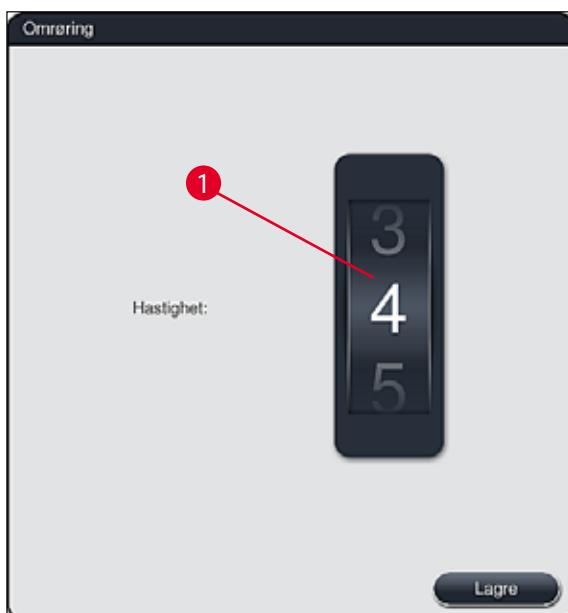


Fig. 30

**5.7.7 Datastyring**

I menyen **Datastyring** (→ "Fig. 31") kan du eksportere og importere data, innstillinger og hendelseslogger (loggfil). All eksport og import krever at det kobles en USB-minnepinne til USB-porten foran på instrumentet (→ "Fig. 1-7") (unntaket er eksterne programvareoppdateringer).

**Merk**

USB-minnepinnen må være FAT32-formatert.

## 5 Drift

### Brukerekspert ([→ "Fig. 31-1"](#))

Funksjonen **Brukerekspert** brukes for å lagre informasjon på en tilkoblet USB-minnepinne ([→ "Fig. 1-7"](#)):

- en **zip**-fil med hendelsesloggene for de siste 30 arbeidsdagene og **RSS**-informasjon i CSV-format
- en kryptert **lpkg**-fil med reagenslisten og alle brukerdefinerte programmer



#### Merk

Lpkg-filen kan ikke åpnes og vises av brukeren.



Fig. 31

Brukerdefinerte programmer og reagenslisten kan overføres til en annen HistoCore SPECTRA ST-maskin med identisk konfigurasjon via **Import**-funksjonen ([→ "Fig. 31-3"](#)).

- Meldingen **Eksporterer brukerdata...** vises mens dataene eksporteres.
- Informasjonsmeldingen **Eksport vellykket** angir at dataoverføringen er fullført og at USB-minnepinnen kan fjernes.
- Hvis informasjonsmeldingen **Eksport mislyktes** vises, har det oppstått en feil (f.eks. USB-minnepinnen ble fjernet for raskt). Hvis dette skjer, må eksportprosessen gjentas.



#### Merk

Når instrumentet er ferdig konfigurert, anbefaler vi at dataene eksporteres, slik at de er tilgjengelige hvis instrumentet må konfigureres på nytt.

### Tjenesteeksport (→ "Fig. 31-2")

Funksjonen **Tjenesteeksport** brukes for å lagre **lpkg**-filer på en tilkoblet USB-minnepinne (→ "Fig. 1-7"):

Den krypterte **lpkg**-filen inneholder et forhåndsdefinert antall hendelseslogger samt:

- **RSS**-informasjon
- Brukerdefinerte programnavn
- Reagensdata
- Andre service-relevante data



#### Merk

**Lpkg**-filen kan ikke åpnes og vises av brukeren.

- Når du trykker på **Tjenesteeksport**-knappen, vises en meny hvor du kan velge ønsket antall dataoppføringer som skal eksporteres (5, 10, 15 eller 30 dager).
- Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
- Informasjonsmeldingen **Eksporterer tjenestedata...** vises mens dataene eksporteres.
- Informasjonsmeldingen **Eksport vellykket** angir at dataoverføringen er fullført og at USB-minnepinnen kan fjernes.
- Hvis informasjonsmeldingen **Eksport mislyktes** vises, har det oppstått en feil (f.eks. USB-minnepinnen ble fjernet for raskt). Hvis dette skjer, må eksportprosessen gjentas.

**Import** (→ "Fig. 31-3")**Merk**

- Du må være logget på som **Administrator** med passord for å importere.
- Hvis det er én eller flere filer i valgdialogboksen, kan du bruke filnavnet for å tilordne lagringsdataen og instrumentets serienummer. Velg filen du vil importere, og trykk på **OK** i informasjonsmeldingen som vises.
- Instrumentets programvare sørger for at ingen eksisterende Leica-programmer og reagenser overskrives under dataimporten (programmer og reagenser). Overflødige forkortelser for programmer og reagenser, samt overflødige reagensnavn, erstattes automatisk av en plassholder, eller en plassholder legges til. Hvis fargene til objektglasshåndtakene er overflødige, er fargen til det importerte programmet hvit.

**Objektglasshåndtakets farge**

- Hvis du importerer et program hvor objektglasshåndtakets farge allerede har et tilordnet program, erstattes denne fargen med hvit når programmet importeres.

**Forkortelse for programnavn**

- Hvis du importerer et program som har en forkortelse som allerede brukes for et eksisterende program, erstatter programvaren forkortelsen automatisk med en plassholder. Det fullstendige programnavnet forandres ikke.
- Forkortelse for eksisterende program: PAS
- Endret forkortelse for det importerte programmet: +01

**Reagensnavn og forkortelse for reagensnavn:**

- Hvis du importerer en reagens som har et navn og/eller forkortelse som allerede er i bruk, legger programvaren automatisk til en plassholder ("\_?").
- Eksisterende reagensnavn: 100 % alkoholdehyd 1 S
- Det endrede navnet til den importerte reagensen: 100 % alkoholdehyd 1 S\_?
- Eksisterende forkortelse: 100Dhy 1S
- Endret forkortelse for den importerte reagensen: 100Dhy 1+01

Importerte programmer og reagenser kan også integreres i fargebadlayouten uten plassholdere.

Du kan gi dem nytt navn senere.

**Advarsel**

Hvis du importerer data fra en USB-minnepinne, overskrives alle de lagrede brukerdefinerte programmene og reagensene på instrumentet med de importerte dataene. Det er ikke mulig å importere enkeltfiler. Leica anbefaler at denne funksjonen kun brukes til importering av sikkerhetskopier eller ved installasjon av en ny HistoCore SPECTRA ST-maskin som skal ha de samme parameterne.

**Import**-funksjonen gjør det mulig å importere det krypterte programmet og reagenslisten, andre godkjente Leica-programmer og andre språkpakker fra en tilkoblet USB-minnepinne.

Disse dataene kan også brukes til å konfigurere en annen HistoCore SPECTRA ST-maskin med de samme dataene ved hjelp av funksjonen **Eksporter/importer**.

- Sett USB-minnepinnen med de eksporterte dataene i en av USB-portene foran på instrumentet (→ "Fig. 1-7").
- Velg deretter **Import**. Dataene importeres.
- En informasjonsmelding på skjermen bekrefter at dataene har blitt importert.

**Advarsel**

Vanligvis må du utføre en ny fargebadlayout når du bruker **Import**-funksjonen (og når du importerer et nytt Leica-fargeprogram). Alle Leica-reagenser som befinner seg i instrumentet, utløper og må erstattes av et nytt, tilsvarende Leica-reagenssett.

**Programvareoppdatering (→ "Fig. 31-4")**

Hvis programvareoppdateringer og ekstra språkpakker er tilgjengelige, skal de bare kjøres eller installeres i **administratormodus**, som beskrevet nedenfor, eller av en servicetekniker som er godkjent av Leica.

**Utføre programvareoppdatering**

1. Kopier filen med programvareoppdateringen til en USB-minnepinne som er formatert med FAT32.
2. Sett USB-minnepinnen inn i en av de to USB-portene (→ "Fig. 1-7") foran på instrumentet.
3. Gå deretter til menyen **Datastyring**, og klikk på **Programvareoppdatering** (→ "Fig. 31-4").
4. Programvareoppdateringen starter.

- ✓ En informasjonsmelding varsler brukeren om at oppdateringen var vellykket.

**Advarsel**

Brukeren varsles hvis oppdateringen ikke kan gjennomføres. Hvis årsaken ikke er innlysende, kan du kontakte Leicas brukerstøtte.

**Merk**

Laboratoriespesifikke innstillinger slettes ikke selv om programvaren til HistoCore SPECTRA ST oppdateres. Etter programvareoppdateringen må du kontrollere at instrumentet fungerer som det skal.

**Ekstern programvareoppdatering (→ "Fig. 31-5")**

Denne funksjonen lar deg utføre programvareoppdateringer via et tilkoblet nettverk. Instrumentet må i så fall være integrert i Leicas Fjernhjelpp-system for vedlikehold og diagnostisering.

- Den nye programvareversjonen lastes ned automatisk så snart den er tilgjengelig for instrumentet. Når nedlastingsprosessen er fullført, blir knappen (→ "Fig. 31-5") svart og aktivert.
- Når du trykker på knappen **Ekstern programvareoppdatering**, startes den automatiske oppdateringsprosessen når instrumentet ikke er i bruk.

**Merk**

- Brukeren vil bli informert om mulige programvareoppdateringer via en informasjonsmelding.
- Programvaren til HistoCore SPECTRA ST oppdateres, men laboratoriespesifikke innstillinger blir ikke slettet.

## 5 Drift

### 5.7.8 Servicetilgang



Denne menyen (→ "Fig. 32") gir autoriserte serviceteknikere fra Leica tilgang til tekniske funksjoner, slik at de kan utføre diagnostisering og reparasjoner på HistoCore SPECTRA ST.

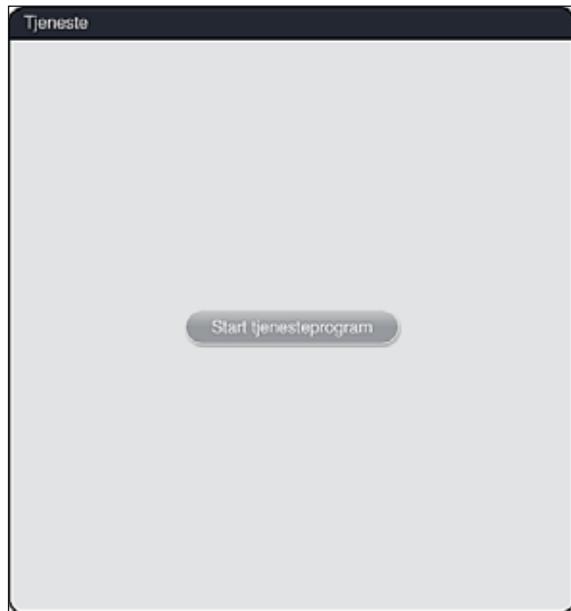


Fig. 32



#### Merk

Tilgangen til tjenesteprogramvaren er låst for alle andre brukergrupper.

### 5.7.9 Hendlesesvisning



Hver dag instrumentet slås på, opprettes en separat loggfil. Denne filen kan hentes frem ved å velge filen **DailyRunLog** i hendlesesvisningen (→ "Fig. 33").

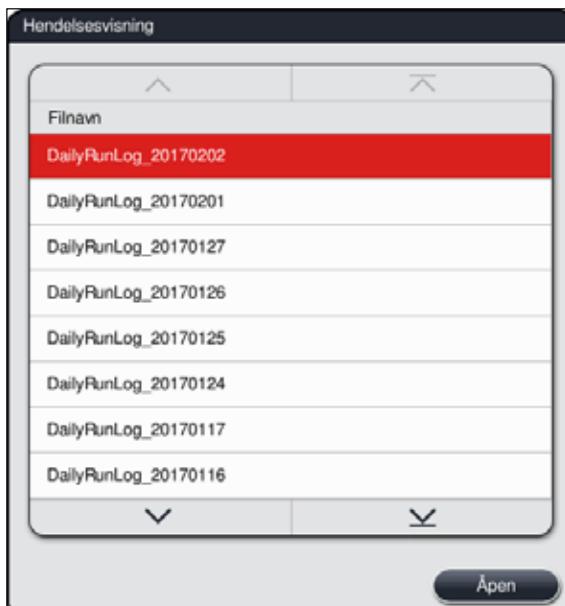


Fig. 33

- I hendlesesvisningen kan du velge en hendelseslogg fra en liste over tilgjengelige logger, og du kan hente den ved å trykke på Åpen-knappen.



#### Merk

Filnavnet suppleres ved å legge til opprettelsesdatoen i ISO-format, slik at det blir lettere å organisere filene. Filen opprettes på det språket som er valgt på instrumentet.

- Alle hendelsesoppføringer starter med en tidsangivelse (→ "Fig. 34-1"), som viser opprettelsesdatoen og -klokkeslettet til oppføringen.
- Tittellinjene i hendlesesvisningen viser også serienummeret (→ "Fig. 34-2") og den gjeldende programvareversjonen (→ "Fig. 34-3") som er installert på HistoCore SPECTRA ST.
- Du kan bla opp og ned i listen og loggfilen med piltastene (→ "Fig. 34-4"). Trykk på venstreknappen for å bla gjennom hendlesesvisningen side for side. Trykk på høyreknappen for å gå til begynnelsen eller slutten av hendlesesvisningen.

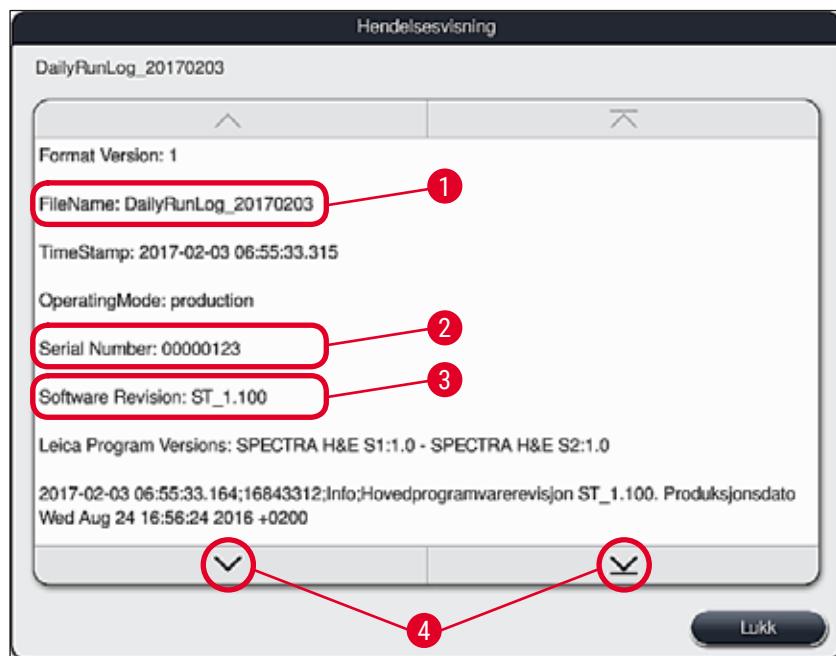


Fig. 34

### 5.7.10 Nettverksinnstillinger



I denne menyen kan du konfigurere nettverksparametere for tilkobling av instrumentet til et nettverk.



#### Merk


Leica-servicesenteret har tilgang til instrumentets tekniske data via et servicennettverk (Fjernhjelp), slik at det er mulig å foreta en diagnostisering av instrumentet og installere programvareoppdateringer. Brukeren kan avslutte en eksisterende Fjernhjelp-tilkobling ved å trykke på det tilsvarende symbolet (→ "Fig. 16-4").



#### Advarsel

- Instrumentet må kobles til et tilgjengelig nettverk av en servicetekniker som er autorisert av Leica, i samarbeid med den lokale IT-avdelingen, for eksempel i forbindelse med den første installasjonen.
- Fjernhjelp bruker nettverksprotokollen TCP/IP og https (128-bit kryptert) på brukernivå.
- Hvis nettverkstilkoblingen brytes (f.eks. hvis nettverkskabelen trekkes ut), må instrumentet slås av på en kontrollert måte (→ S. 31 – 4.5 Slå instrumentet på og av). Plugg inn nettverkskabelen igjen, og start instrumentet på nytt.

## 5.8 Reagensliste



Åpne reagenslisten ved å trykke på knappen ved siden av. Nå vises alle definerte reagenser i alfabetisk rekkefølge.

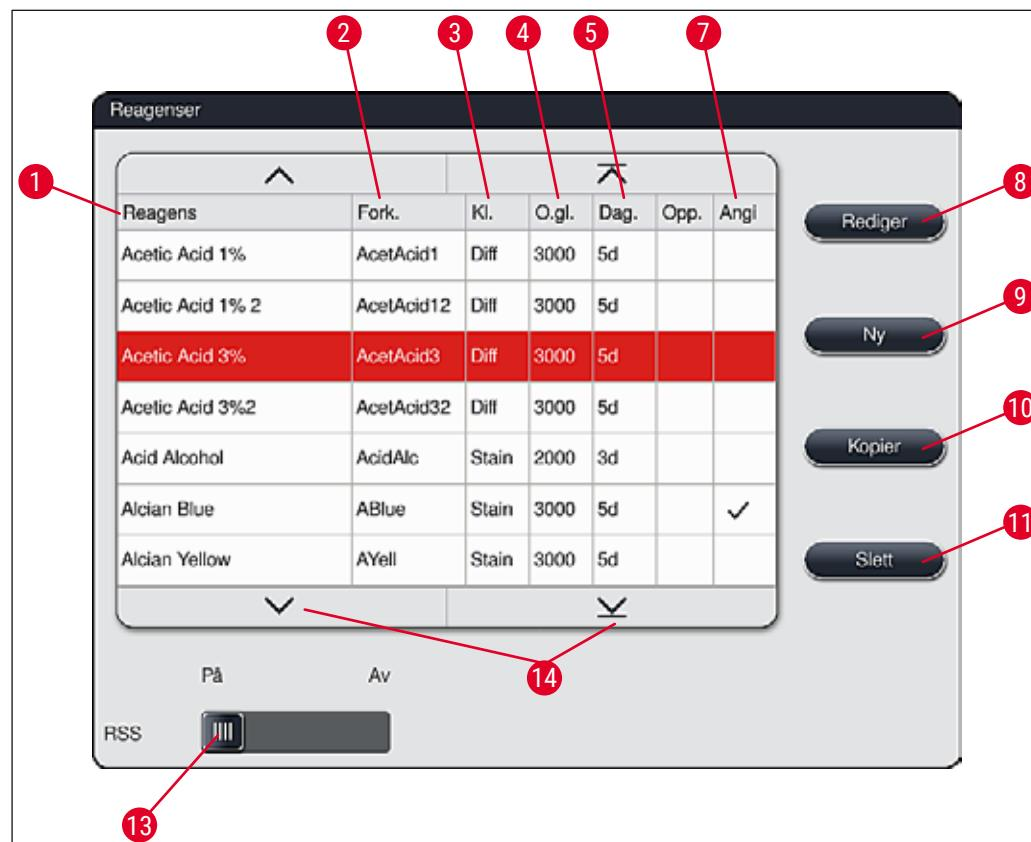


Fig. 35

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 Reagensnavn                     | 8 Rediger den valgte reagensen                  |
| 2 Forkortelse for reagensnavnet   | 9 Opprett en ny reagens                         |
| 3 Behandlingsklasse               | 10 Kopier den valgte reagensen                  |
| 4 Maks. antall objektglass        | 11 Slett den valgte reagensen                   |
| 5 Maks. bruksperiode              |   |
| 7 Innsats for spesialfarge ja/nei | 13 Aktiver/deaktiver RSS                        |
|                                   | 14 Bruk pilene for å bla gjennom reagenslisten. |

## 5 Drift



### Merk

- Når du konfigurerer instrumentet, inneholder reagenslisten bare reagenser fra de forhåndsinstallerte Leica-programmene.
- Flere reagenser kan legges til, og reagensegenskaper kan endres etter behov i reagenslisten.
- Du må være pålogget som "Administrator" for å opprette eller redigere reagenser. I brukermodus vises reagensdataene, men de kan ikke endres.
- Reagenser som er integrert i fargebadlayouten i aktive programmer, kan ikke slettes fra reagenslisten.



### Advarsel

- Glidebryteren **RSS : På – Av** (→ "Fig. 35-13") kan du slå av og på reagensstyringssystemet **RSS** (→ S. 91 – 6.3 Reagensstyringssystem (RSS)). Dette systemet styrer overvåking av reagensforbruk. Vi anbefaler alltid at **RSS** er slått på og at du følger instruksjonene for bytting av reagenser. Det er ikke mulig å slå av reagensovervåking for reagensene i Leicas fagesett.
- Hvis intervallene som er angitt, ikke følges, kan det påvirke fargekvaliteten. **RSS** er pålitelig kun hvis dataene på forhånd har blitt riktig lagret av brukeren.
- Produsenten påtar seg intet ansvar for fargeresultatene hvis reagensdataene er oppgitt feil.
- Brukeren kan ikke redigere betegnelsene og **RSS**-dataene til reagensene som er godkjent av Leica.

### Opprette en ny reagens, eller kopiere en reagens



### Merk

- Du kan opprette en ny reagens med knappene **Ny** (→ "Fig. 35-9") eller **Kopier** (→ "Fig. 35-10").
- Du må være pålogget som "Administrator" for å opprette, kopiere eller redigere reagenser. I brukermodus vises reagensdataene, men de kan ikke endres.

- Trykk på **Ny**-knappen (→ "Fig. 35-9") for å legge til en ny reagens i reagenslisten.
- Dette åpner et vindu (→ "Fig. 38"), hvor du kan opprette den nye reagensen.



Fig. 38

#### Følgende parametere kan oppgis:

- Reagensnavn:**
  - Trykk på **Reagensnavn**-knappen (→ "Fig. 38-1") og bruk skjermtastaturet til å skrive inn et unikt reagensnavn som ikke er i bruk allerede. Du kan skrive inn opptil 30 tegn (inkludert mellomrom).
- Forkortelse:**
  - Trykk på knappen **Forkortelse**, (→ "Fig. 38-2"), og bruk skjermtastaturet til å skrive inn en unik forkortelse for reagensen som ikke er i bruk allerede (maks. 10 tegn, inkludert mellomrom).
- Maks. obj.glass:**
  - Bruk hjulet (→ "Fig. 38-3") for å konfigurere det maksimale antallet objektglass som kan behandles med denne reagensen før reagensen må byttes. Vri på hjulene, og velg en verdi mellom 1 og 3999.
- Maks. dager:**
  - Vri på hjulet for å angi det maksimale antallet dager (→ "Fig. 38-4") for oppbevaring av reagensen i instrumentet. Velg mellom 1 og 99 dager.
- Angi:**
  - Hvis en reagensbeholder er utstyrt med en innsats for spesialfargning (→ S. 88 – 6.2.1 Klargjøring og håndtering av reagensbeholdere) for å tillate mindre reagensvolum, kan stativet bare brukes for 5 objektglass i denne beholderen. I så fall må du sette glidebryteren i **Ja**-posisjon (→ "Fig. 38-5").
  - Dette deaktiverte bruken av stativ for 30 objektglass i denne beholderen.

**Advarsel**

Bruk av innsats for spesialfarging i en eller flere reagensbeholdere krever at bryteren settes i **Ja**-posisjon. Hvis innstillingen av bryteren ikke er riktig for de aktuelle beholderne, brukes kanskje et stativ for 30 objektglass. Dette fører til en alvorlig feil som kan ødelegge prøvene.

**Behandlingsklasse:**

- Reagenser må tilordnes behandlingsklasser (→ "Fig. 38-6") (→ S. 61 – 5.8.3 Behandlingsklasser) fordi det, i tillegg til å oppgi en programprioritering, er nødvendig for automatisk beregning av de individuelle posisjonene til fargebadlayouten (→ S. 75 – 5.9.8 Prioritering av programmer for utføring av fargebadlayouten).
- Lagre oppføringene med **Lagre**-knappen (→ "Fig. 38-7"), eller lukk vinduet med **Avbryt**-knappen (→ "Fig. 38-8") uten å ta oppføringen i bruk.

**Merk**

Når oppføringen er lagret, er det ikke lenger mulig å endre behandlingsklasse. Reagensen må eventuelt slettes og opprettes på nytt, eller kopieres og så endres.

**5.8.1 Kopiere en reagens****Merk**

Hvis en reagens med andre parametere brukes i HistoCore SPECTRA ST, kan du kopiere en eksisterende reagens.


- Trykk på reagensen du vil kopiere i reagenslisten (→ "Fig. 35"). Trykk deretter på **Kopier**-knappen (→ "Fig. 35-10").
- Dette åpner et vindu (→ "Fig. 38"), hvor du kan opprette den nye reagensen.
- Godta reagensnavnet, eller overskriv det med et annet navn.
- Den foreslalte forkortelsen kan godtas eller overskrives med en ny forkortelse.
- Endre om nødvendig parameterne for reagensen, eller bruk de eksisterende parameterne.
- Lagre oppføringene med **Lagre**-knappen (→ "Fig. 38-7"), eller lukk vinduet med **Avbryt**-knappen (→ "Fig. 38-8") uten å ta oppføringen i bruk.

**5.8.2 Endre RSS-data for en reagens****Merk**

Hvis du vil endre **RSS**-dataene (**Maks. obj.glass** og/eller **Maks. dager**), må du følge instruksjonene nedenfor slik at innstillingene som endres, vises korrekt i stasjonsdetaljene (→ S. 97 – Fig. 75).

- Trykk på reagensen du vil endre i reagenslisten (→ "Fig. 35"). Trykk deretter på Rediger-knappen (→ "Fig. 35-8").
  - Vri på hjulene for å angi de nye verdiene for **Maks. obj.glass** (→ "Fig. 38-3") og/eller **Maks. dager** (→ "Fig. 38-4") og trykk på Lagre-knappen for å ta i bruk endringene.
  - Se informasjonsmeldingen som følger, og bekreft med OK.
  - Hent deretter fargebadlayouten og trykk på den tilknyttede reagensstasjonen i layouten for å velge stasjonen.
  - I stasjonsdetaljene som vises, trykker du på knappen Oppdater reagens (→ "Fig. 75-10").
  - Visningen med stasjonsdetaljene lukkes, og **RSS**-data tas i bruk.

### 5.8.3 Behandlingsklasser

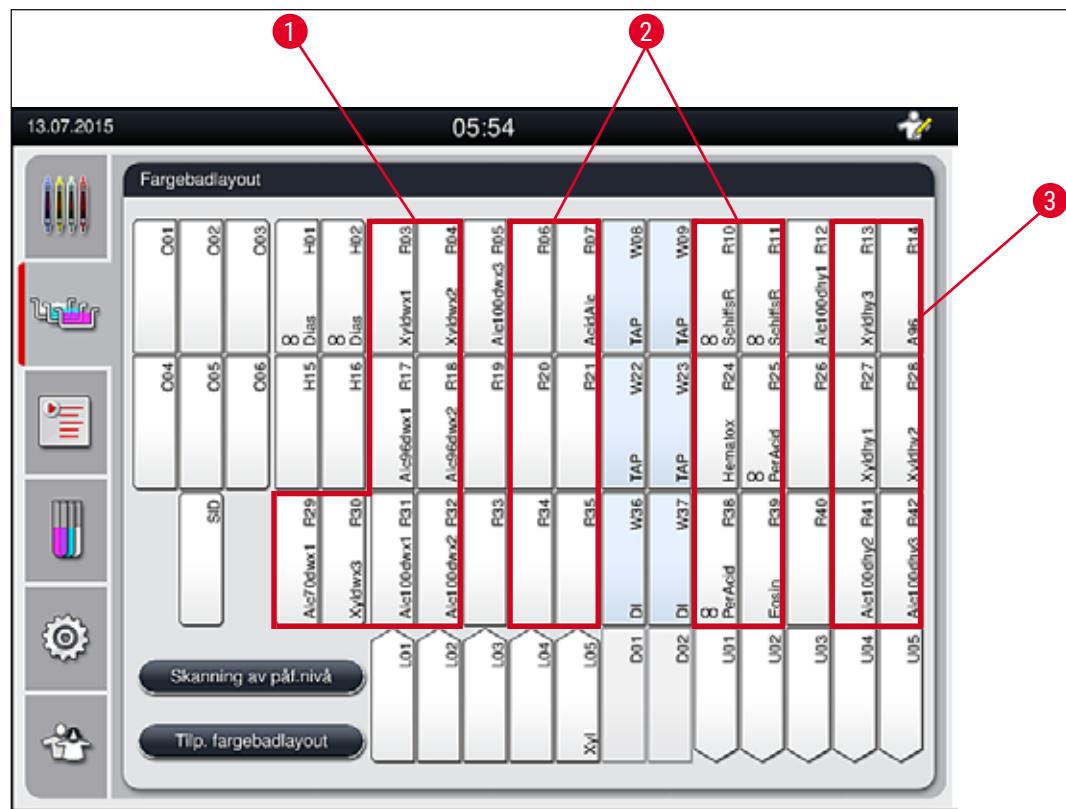

**Fig. 39**

- 1 Foretrukket sone for fjerning av voks på reagenser er venstre side av fargebadlayouten.
  - 2 Foretrukket sone for fargeløsninger eller differensieringsmidler er de to radene til venstre og høyre for skyllevannstasjonene.
  - 3 Foretrukket sone for dehydrering av reagenser er høyre side av fargebadlayouten.

## 5 Drift



### Merk

Det er ikke mulig å programmere to etterfølgende skyllevannstrinn (skyllevannstrinn for destillert vann eller omvendt). Hvis programrekkefølgen skal være sånn, må ett av trinnene defineres som en reagens tilordnet en behandlingsklasse (f.eks. nøytraliserings).

Behandlingsklasse	Beskrivelse	Reagenseksempler
Fjerning av voks (Dewaxing)	<ul style="list-style-type: none"><li>Løsningsmidler som fjerner parafinen og deretter etterfølgende, graderte alkoholserier, i begynnelsen av et fargeprogram.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Xylen</li><li>Xylenerstatning</li><li>Synkende alkoholserier: 100 %, 95 %, 70 % alkohol</li></ul>
Nøytraliserings (Neutralizing)	<ul style="list-style-type: none"><li>Reagenser som har liten eller ingen effekt på fargingen eller fargeutviklingen, og som har en tilnærmet nøytral pH-verdi.</li><li>Eksempel: Trinn med destillert vann før et fargetrinn.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Destillert vann (demineralisert) / ferskvann (ikke i skyllevannstasjoner!)</li><li>Tynnere med destillert vann</li><li>Vandige alkoholløsninger (f.eks. 70 % etanol)</li></ul>
Farging (Staining)	<ul style="list-style-type: none"><li>Fargeløsninger</li><li>Beis</li><li>Oksideringsmiddel (f.eks. periodesyren i PAS-fargen)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Alle fargeløsninger</li><li>Beis og oksideringsmidler</li></ul>
Differensiering (Differentiating)	<ul style="list-style-type: none"><li>Reagenser som fjerner overskuddsfarge fra produktet.</li><li>Reagenser som er nødvendige for fargeutvikling eller fargeendring.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>HCl-løsning (alkoholholdig eller andig)</li><li>Eddiksyre</li><li>Ammoniakkvann</li><li>Scott's Tap Water</li><li>Bluing-løsning</li><li>Blå buffer</li><li>Litiumkarbonat</li><li>Alkohol (ulike konsentrasjoner)</li></ul>
Dehydrering (Dehydrating)	<ul style="list-style-type: none"><li>Reagenser i den oppadstigende alkoholserien, i slutten av fageprogrammet.</li><li>Etterfølgende løsningstrinn (xylen eller xylenerstatning) på slutten av et fageprogram for forberedelse av dekkglasspåføring.</li></ul>	<p>Dehydrering:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Oppadstigende alkoholserier: 70 %, 95 %, 100 % alkohol</li></ul> <p>Forberedelse av dekkglasspåføring:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Xylen</li><li>Xylenerstatning</li></ul>
Ingen klasse (no class)	Reagenser som ikke krever spesiell tilordning i fargebadlayouten	



### Advarsel

Ta hensyn til følgende ved forberedning av dekkglasspåføring:

- Løsemiddelet som brukes i slutten av programmet og i den etterfølgende prosessen, må være kompatibelt med festemiddelet.



## Merk

Det er viktig at reagensene tilordnes riktige behandlingsklasser, slik at optimal fargebadlayout kan beregnes og lange transportbaner og -tider kan unngås.

Grunnleggende regler for automatisk utføring av fargebadlayouten kan inkludere:

- Overføring fra venstre beholderfelt til høyre beholderfelt skal så langt det lar seg gjøre, skje via en skyllevannstasjon.
- Programmer som ikke inneholder et trinn for skyllevannstasjon, bruker tørroverføringsstasjonen for denne overføringen.
- Fargereagenser som krever etterfølgende skyllevannstrinn, plasseres ved siden av skyllevannsbeholderne (→ "Fig. 39").
- Reagenser som er tilordnet behandlingsklassen **Ingen klasse**, kan plasseres i hvilken som helst posisjon under den automatiske utføringen av fargebadlayouten.
- I stedet for å tilordne **Ingen klasse**, anbefaler vi at disse reagensene tilordnes behandlingsklasse **Differensiering** eller **Nøytralisering**, slik at det kan tas hensyn til de tilstøtende stasjonene i fargebadlayouten for serien med programtrinn.

## 5.9 Fargeprogrammer



Listen over fargeprogrammene som er installert på HistoCore SPECTRA ST, åpnes når du trykker på **Programmer**-knappen.

Det skiller mellom to typer fargeprogrammer:

- Forhåndsinstallerte Leica-fargeprogrammer (→ S. 66 – 5.9.2 Leica-fargeprogrammer (forhåndsinstallert))
- Brukerdefinerte fargeprogrammer (→ S. 69 – 5.9.4 Brukerdefinerte fargeprogrammer)

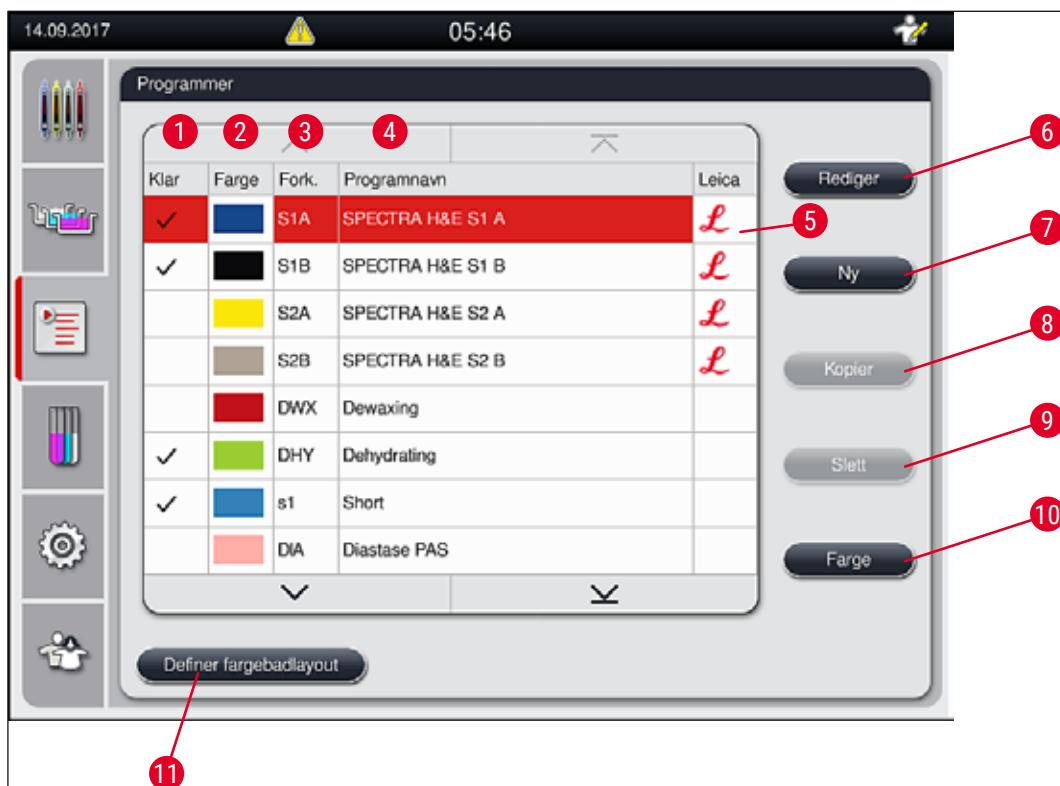


Fig. 40

- 1 Når denne kolonnen er merket, er programmet tatt med i den gjeldende fargebadlayouten.
- 2 Tilordnet programfarge
- 3 Programforkortelse
- 4 Programnavn
- 5 Forhåndsinstallert Leica-program
- 6 Rediger program
- 7 Opprett et nytt program
- 8 Kopier det valgte programmet
- 9 Slett det valgte programmet
- 10 Tilordne det valgte programmet en farge
- 11 Definer fargebadlayout

### 5.9.1 Tilordner en stativhåndtaksfarge til et fargeprogram



#### Merk

Du må tilordne en stativhåndtaksfarge til hvert program.

Tilordningen av stativhåndtaksfargen til programmene krever **administratormodus**.

- Du tilordner en stativhåndtaksfarge til et program ved å trykke på det aktuelle programmet i programlisten (→ "Fig. 40") for å velge det.
- Når du trykker på "Farge"-knappen (→ "Fig. 40-10"), vises et valgfelt (→ "Fig. 41") hvor du kan tilordne det valgte programmet en stativhåndtaksfarge.



Fig. 41



#### Merk

Alle tilgjengelige farger vises i (→ "Fig. 41"). Hvis det står en forkortelse i fargefeltet, betyr det at programmet allerede er tilordnet denne fargen.

Hvis du tilordner en farge som allerede er valgt, vises en dialogboks med informasjon om at den eksisterende tilordningen vil bli opphevet. Velg enten **OK** for å godta, eller trykk på **Avbryt** for å avbryte handlingen.

- Velg en farge som ikke tidligere har blitt tilordnet.
- Velg **Lagre** for å tilordne fargen og lukke dialogboksen.
- Trykk på **Avbryt** for å lukke dialogboksen uten å ta i bruk endringene.



#### Merk

Hvis det ikke er nok tilgjengelige stativhåndtak i én farge, kan et hvitt stativhåndtak (såkalt **JOKERFARGE**) benyttes.

Når du setter inn et stativ med hvitt håndtak, åpnes et programvalgvindu. Her må et fargeprogram som er aktivert i fargebadlayouten, tilordnes det hvite håndtaket for kun dette programmet.

Når det valgte programmet er fullført, oppheves tilordningen.

## 5 Drift

### 5.9.2 Leica-fargeprogrammer (forhåndsinstallert)

#### Betegnelse på reagenssett



##### Merk

I dette avsnittet er HistoCore SPECTRA ST-fargesystemer og -programmer produsert av Leica forenklet i samsvar med brukergrensesnittet. Navnene til systemene og programmene samsvarer med betegnelsene på Leicas reagenssett og fargeprogrammer.

Du kan få Leicas nye fargeprogrammer fra den ansvarlige Leica-forhandleren.



##### Advarsel

Brukerhåndbøkene som følger med Leica-reagenssettene, inneholder viktig informasjon om forhåndsinnstilte verdier, logger og nødvendige endringer av fargebadlayout. Brukerhåndboken må derfor følges nøyne.

Følg prosedyren i kapitlet (→ S. 49 – 5.7.7 Datastyring) når du importerer nye fargeprogrammer fra Leica. De nye fargeprogrammene fra Leica legges til i den eksisterende programlisten (→ S. 63 – 5.9 Fargeprogrammer). Ingen data slettes.

- Fargeprogrammene fra Leica forhåndsinstalleres ved fabrikken, og både funksjonene og fargeegenskapene testes. Programmene garanterer konsekvent fargekvalitet for et visst antall objektglass.
- Leica-fargeprogrammer er merket med Leica- (→ "Fig. 40-5") i kursiv i den siste kolonnen.



Fig. 42

**Merk**

- Leica-fargeprogrammene krever at du benytter Leica-reagenssett.
- Leica-fageprogrammene kan ikke kopieres. Dette betyr at Leica-fageprogrammene bare kan legges i programlisten én gang.
- De enkelte programtrinnene i Leica-fageprogrammet kan ikke vises, redigeres, kopieres eller slettes.
- Du kan tilordne en stativhåndtaksfarge (→ "Fig. 42-3") til Leica-fageprogrammet.
- Hvis Leica-fageprogrammet tillater det, kan ovnstrinnet aktiveres eller deaktiveres i administratormodus (→ "Fig. 42-1"), og Utmatingsstasjonen eller Overføringsstasjonen (→ "Fig. 42-2") kan defineres som siste trinn. **Overføringsstasjon** vises bare hvis HistoCore SPECTRA ST betjenes med HistoCore SPECTRA CV som arbeidsstasjon.
- Reagenser, f.eks. xylen og alkohol, som brukes i et Leica-fageprogram, kan ikke slettes.

**Advarsel**

- Hvis et parafinfjerningstrinn ikke er det første trinnet i Leica-fageprogrammet, skal ovnstrinnet (→ "Fig. 42-1") (→ "Fig. 43-1") ikke aktiveres. I motsatt fall kan prøvene bli ødelagt.
- Den faste ovnstemperaturen i Leica-fageprogrammene brukes også for brukerdefinerte fageprogrammer, og kan ikke tilpasses individuelt.

**Multi-installasjon og -bruk av Leica fargingsprogram****Merk**

Noen Leica fargingsprogrammer kan brukes parallelt med forskjellige innstillinger (fargeintensitet, ovnstrinn) (→ S. 68 – 5.9.3 Tilpassing av Leica H&E fageprogram). Disse programmene er dobbelt forhåndsinstallert i programlisten (→ "Fig. 40"). For å skille mellom disse dobbelt forhåndsinstallerte Leica H&E fargingsprogrammene vises forkortelsene S1A og S1B eller S2A og S2B i programlisten. Disse programmene inneholder nøyaktig de samme programtrinnene. Dersom to identiske programmer integreres i fargebadlayouten, må man også skanne og fylle to identiske Leica fargingssett.

## 5.9.3 Tilpassing av Leica H&amp;E fargeprogram



## Merk

- I Leica H&E fargeprogrammer kan fargeintensiteten justeres for hematoxylin og eosin i administratormodus. Andre fargeprogrammer fra Leica tillater ikke justeringer av fargeintensiteten.
- Hvis Leica-fargeprogrammet tillater det, kan ovnstrinnet aktiveres eller deaktiveres (→ "Fig. 43-1").
- Når det gjelder fargerprogrammer fra Leica kan overføringen til en tilkoblet automatisk dekkglassmaskin HistoCore SPECTRA CV velges som siste trinn ved å velge **Overføringsstasjon** (→ "Fig. 43-4"), eller ved å velge **Uutmating** for å sette det allerede fargede stativet inn i utmatingskuffen (→ "Fig. 43-3").
- Du kan bare justere og endre Leica-fargeprogrammer og brukerdefinerte fargeprogrammer hvis ingen fargeprosesser er aktive og alle stativene er fjernet fra instrumentet.



Fig. 43



## Advarsel

Etter at brukeren har justert fargeintensiteten, må fargeresultatene kontrolleres med et kontroll-objektglass som inneholder representativ vevssnitt før innstillingene brukes på pasientprøver og klinisk diagnostisering.

Velg Leica-programmet i programlisten, og trykk på **Rediger** (→ "Fig. 40-6"). Et dialogboksvindu åpnes. Her kan du konfigurere innstillingene.

- Vri på hjulene for å angi fargeintensitetsverdiene (→ "Fig. 43-2"). Lave tallverdier gir lysere fargeintensitet. Høye tallverdier gir mørkere fargeintensitet.

- Programmet må tilordnes en håndtaksfarge (→ S. 65 – 5.9.1 Tilordner en stativhåndtaksfarge til et fargeprogram).
- Bruk **Lagre** for å lagre innstillingene, og lukk dialogboksen.
- Bruk **Avgryt** for å lukke dialogboksen uten å lagre endringene.

#### 5.9.4 Brukerdefinerte fargeprogrammer



##### Advarsel

- Leica tilbyr verken testing av eller garantier for brukerdefinerte programmer.
- Testingen av disse fargeprogrammene med respektive reagenser og justerte temperaturer må utføres i laboratoriet av brukeren selv. Da må fargeresultatene kontrolleres med en prøvesyklus (prøvesnitt) før programmet brukes på pasientprøver og klinisk diagnostisering.



##### Merk

Du kan opprette et nytt program med knappene **Ny** (→ "Fig. 44-1") eller **Kopier** (→ "Fig. 44-2"). Du må være pålogget som "administrator" for å opprette, kopiere eller redigere programmer. I brukermodus vises programtrinnene, men de kan ikke endres.

#### 5.9.5 Opprette eller kopiere et nytt fargeprogram

- Trykk på **Ny**-knappen (→ "Fig. 44-1") i listen over programmer.



Fig. 44

## 5 Drift

- Et nytt programvindu åpnes (→ "Fig. 45").

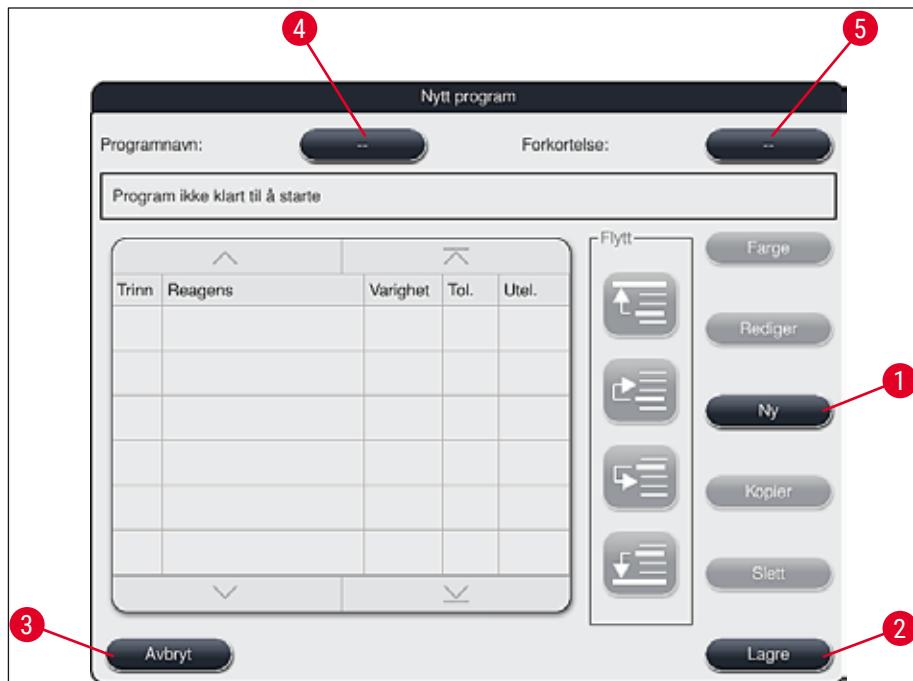


Fig. 45

Øverst i vinduet vises to tomme knapper. De er beregnet på programnavnet og forkortelsen.

- Trykk på knappen "--" bak **Programnavn**-betegnelsen (→ "Fig. 45-4"). En inndatamaske med tastatur åpnes.
- Legg inn programnavnet, og ta i bruk det angitte navnet ved å trykke på **OK**-knappen.

Følg prosedyren ovenfor for å legge inn **Forkortelse** (→ "Fig. 45-5").



### Merk

Hvis du vil opprette et nytt fargeprogram, legges flere programtrinn til programmet i rekkefølge.  
Merk: Brukerdefinerte programmer kan ikke lagres med betegnelsen **SPECTRA** som programnavn.  
Brukeren blir varslet om dette med en informasjonsmelding hvis han/hun forsøker å lagre. Lagrefunksjonen aktiveres når et annet programnavn legges inn.

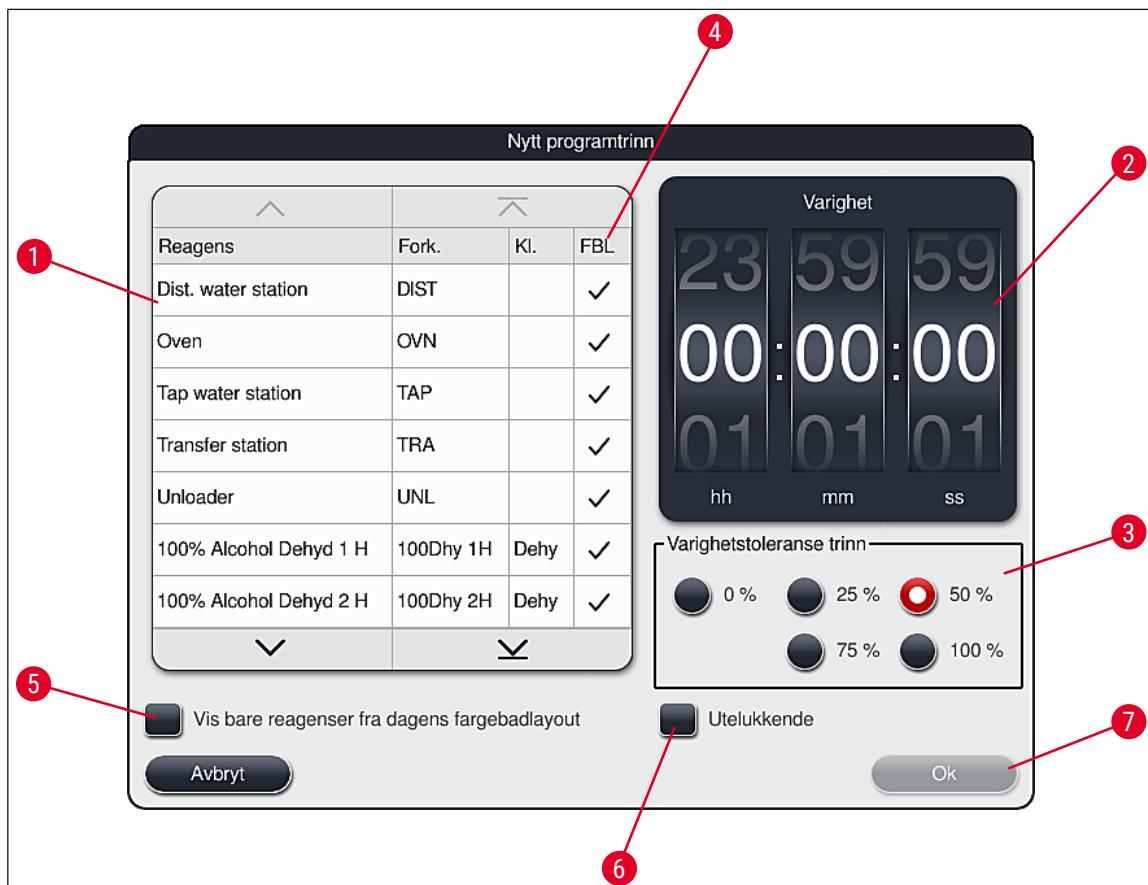


Fig. 46

- Trykk på **Ny**-knappen når et nytt program er opprettet (→ "Fig. 45-1").
- Et vindu hvor du kan definere programtrinnene, åpnes (→ "Fig. 46").
- Reagenser som allerede er forhåndsdefinert av brukeren, står oppgitt i området til venstre (→ "Fig. 46-1"). Trykk på reagensen for å velge den.
- Definer reaksjonstiden (tt/mm/ss) for prøvene i reagensen ved å vri på hjulene (→ "Fig. 46-2") i området til høyre.
- Gyldig innstilling er fra 1 sekund til 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder.
- Her konfigureres trinnets tillatte "Varighetstoleranse" (→ "Fig. 46-3"). Hvis det er nødvendig med et nøyaktig programtrinn som ikke tillater tidsbestemt utvidelse av den spesifiserte tiden, må du velge 0 %. Tillatt avvik kan velges i trinn på 25 % opptil en maksimal utvidelse på 100 %, dvs. at instrumentet ved behov kan utvide trinnet til dobbel lengde av konfigurert tid.

**Merk**

Varigheten for de individuelle programtrinnene er satt sammen av programtrinntidene og de konfigurerde toleranseverdiene. Hvis toleransekonfigurasjonene for et programtrinn er > 0 %, kan de gjenværende stasjonstidene og forventet gjenværende tid for programmet, bli overskredet.

## Kopiere et program



### Merk

Hvis du vil bruke et eksisterende program med andre parametere, kan du kopiere programmet.

- Trykk på programmet du vil kopiere i listen (→ "Fig. 44"). Trykk deretter på Kopier-knappen (→ "Fig. 44-2").
- Dette åpner et vindu (→ "Fig. 45"), hvor du kan opprette det nye programmet.
- Godta programnavnet som foreslås, eller overskriv det med et annet navn.
- Skriv deretter inn en forkortelse.
- Om nødvendig endrer/redigerer du de individuelle programtrinnene, eller legger til nye programtrinn (→ "Fig. 45-1") (→ S. 72 – 5.9.6 Legge til eller kopiere et nytt programtrinn).
- Lagre oppføringene med Lagre-knappen (→ "Fig. 45-2"), eller lukk vinduet med Avbryt-knappen (→ "Fig. 45-3") uten å ta oppføringen i bruk.

### 5.9.6 Legge til eller kopiere et nytt programtrinn

#### Legge til et nytt programtrinn



### Merk

Det anbefales å velge et høyt tillatt tidsavvik hvis det ikke får noen negativ effekt på fargeresultatet. Dette gir instrumentet større spillerom til å synkronisere trinnene i forskjellige programmer som kjøres samtidig.

- Hvis kolonnen "**FBL**" (→ "Fig. 46-4") er merket, betyr dette at denne reagensen allerede er integrert i fargebadlayouten.
- Du kan begrense visningen av reagenser som allerede brukes i fargebadlayouten, ved å aktivere alternativknappen Vis bare reagenser fra dagens fargebadlayout (→ "Fig. 46-5").
- Hvis boksen "Utelukkende" (→ "Fig. 46-6") er aktivert, kan den valgte reagensen kun brukes med det opprettede programmet. Ingen andre programmer kan velges.
- Innleggingen av programtrinnet fullføres med **OK** (→ "Fig. 46-7").
- Andre programtrinn kan legges til på samme måte etter behov, helt til alle trinnene i fargeprosessen er illustrert i programmet.

**Merk**

Et program må alltid avsluttes med et målstasjonstrinn. Som siste trinn må du velge utmatingskuffen. Hvis HistoCore SPECTRA ST er permanent tilkoblet som arbeidsstasjon med HistoCore SPECTRA CV, må du velge overføringsstasjon.

En varselmelding (→ "Fig. 47") angir at det ikke er mulig å lagre programmet før en målstasjon er definert som siste trinn.

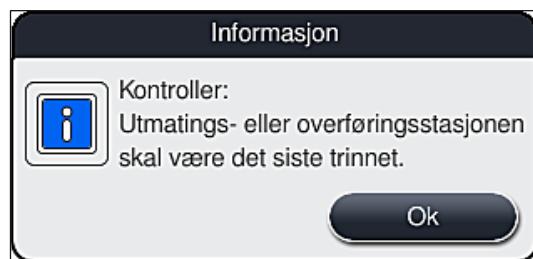


Fig. 47

**Kopiere et programtrinn****Merk**

Når et program opprettes eller endres, kan programtrinn med allerede angitte parametere som er tilpasset en reagens som allerede står i reagenslisten, kopieres over.

- Merk det aktuelle programtrinnet ved å berøre det, og trykk på **Kopier**-knappen (→ "Fig. 48-5").
- Dette åpner vinduet **Rediger program** (→ "Fig. 48").
- Hvis en reagens med kun én forekomst velges, vises en informasjonsmelding om dette. I så fall må det velges en annen reagens for programtrinnet.
- De opprinnelige parameterne (varighetstoleranse, varighet og eksklusivitet) i det valgte programtrinnet beholdes.
- Endre om nødvendig parameterne for programtrinnet, eller bruk de eksisterende parameterne og trykk på **OK**.
- Programtrinnet settes inn i slutten av programmet.
- Bytt rekkefølgen på programtrinnene som beskrevet i (→ S. 74 – 5.9.7 Endre rekkefølge på programtrinn).

## 5 Drift

### 5.9.7 Endre rekkefølge på programtrinn

- Programtrinnet uteheves med rødt når du velger det. Nå er **Flytt**-knappene (→ "Fig. 48-1") (→ "Fig. 48-2") (→ "Fig. 48-3") (→ "Fig. 48-4") aktive.

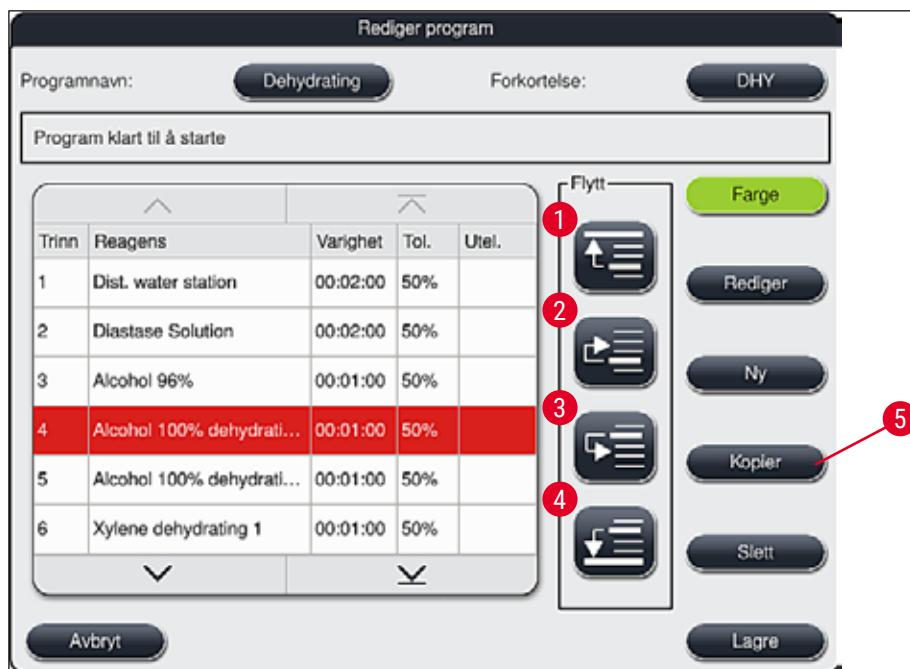


Fig. 48

- Trykk på denne for å flytte det valgte programtrinnet opp til første rad.
- Trykk på denne for å flytte det valgte programtrinnet én rad opp.
- Trykk på denne for å flytte det valgte programtrinnet én rad ned.
- Trykk på denne for å flytte det valgte programtrinnet ned til siste rad.



#### Advarsel

Hvis et ovnstrinn brukes som første programtrinn, må det ikke under noen omstendigheter være brannfarlige løsemidler i matestasjonen til mateskuffen.

Det kan føre til antenning i ovnen, fare for brannskader for brukeren, tap av prøver og skader på instrument og utstyr.

- Trykk på **Lagre**-knappen (→ "Fig. 48") for å lagre endringene. Trykk på **Avbryt**-knappen for å forkaste endringene.

### 5.9.8 Prioritering av programmer for utføring av fargebadlayouten



Fig. 49

Når alle ønskede fargetrinn er oppgitt, må fargebadlayouten genereres. Det gjør du slik:

- I første trinn må **administratoren** definere hvilke programmer som skal inkluderes i fargebadlayouten. Programmene aktiveres med alternativknappene (→ "Fig. 49-1").
- Programpllasseringen avgjør hvilken prioritet programmet har i fargebadlayouten.



#### Merk

Prioritet:

- Bare posisjonene til de brukerdefinerte programmene kan endres. Leica-fargeprogrammene står alltid øverst på reagenslisten.
- Brukerdefinerte programmer med lave posisjonsnumre er letttere å ta hensyn til ved utføring av fargebadlayout enn programmer med høye posisjonsnumre.
- Vi anbefaler at brukerdefinerte programmer med høy prøvegjennomstrømning plasseres i begynnelsen av programlisten, etter Leica-fargeprogrammene.

## 5 Drift

Hvis en høyere eller lavere prioritet skal tilordnes et fargeprogram, må det velges fra listen og flyttes høyere eller lavere i listen ved hjelp av **Flytt**-knappene:

- Programmet flyttes øverst i listen (→ "Fig. 49-2")
  - Programmet flyttes én rad opp (→ "Fig. 49-3")
  - Programmet flyttes én rad ned (→ "Fig. 49-4")
  - Programmet flyttes nederst i listen (→ "Fig. 49-5")
- Den nye prioriteringen gjør at fargebadlayouten må utføres på nytt (→ S. 76 – 5.9.9 Utføre fargebadlayout).

### 5.9.9 Utføre fargebadlayout



#### Merk

Organiseringen av reagensstasjonene i instrumentet beregnes på grunnlag av de prioriterte fargeprogrammene (→ S. 75 – 5.9.8 Prioritering av programmer for utføring av fargebadlayouten).

Dette er noe av det som skjer i den forbindelse:

- Det tas først hensyn til Leica-fargeprogrammene.
- Fargeløsninger og differensieringsmidler plasseres så nært skyllevannsbeholderne som mulig.
- Det tas hensyn til programprioriteringen og behandlingsklassetilordningen.
- Sekvensielle prosessreagenser må være plassert i nærheten av hverandre.

- Trykk på **Definer fargebadlayout** (→ "Fig. 44-3")-knappen for å velge programmene som skal integreres i fargebadlayouten.
- Velg og prioriter de aktuelle programmene. Trykk deretter på **Utfør fargebadlayout** (→ "Fig. 49-6"), eller **Avbryt** for å gå tilbake til programvalg.



#### Advarsel

Les informasjonsmeldingen (→ "Fig. 50") som vises når du trykker på knappen **Definer fargebadlayout**. Trykk på "**Fortsett**"-knappen for å vise resultatet av beregningen av fargebadlayouten.



Fig. 50

**Merk**

- Hvis det er valgt flere programmer enn det er mulig å integrere i fargebadlayouten, informeres brukeren om dette gjennom visningen **Resultat for opprettning av fargebadlayout** (→ "Fig. 51"). Programmer som er integrert, merkes av i kolonnen **Klar** (→ "Fig. 51-1").
- Hvis programmene ikke ble integrert, vises årsaken (→ "Fig. 51-2") i kolonnen **Ikke klar, årsaker** (→ "Fig. 51-3").
- Husk at hele listen må kontrolleres.

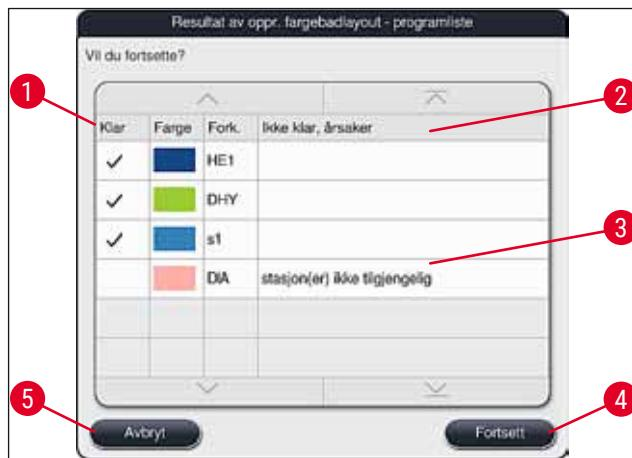


Fig. 51

- Trykk på **Fortsett**-knappen (→ "Fig. 51-4") for å fortsette, eller trykk på **Avbryt**-knappen (→ "Fig. 51-5") for å gå tilbake til programvalg (→ "Fig. 49").

**Advarsel**

Brukerhåndboken som følger med Leica-reagenssettet, skal følges før skanning av Leica-reagenser.

**5.9.10 Fylle reagenser etter utføring av fargebadlayout****Merk**

- Utfør fargebadlayouten, og gå videre som beskrevet (→ S. 76 – 5.9.9 Utføre fargebadlayout).
- Hvis fargebadlayouten som vises, bare skal lagres uten konfigurering av reagensfyllingen, trykker du på **Lagre**-knappen (→ "Fig. 52-3"). Den lagrede fargebadlayouten kan hentes frem i fargebadlayout-menyen senere. Du kan også utføre justeringer i denne menyen ved behov (→ S. 83 – 5.9.11 Tilpassing av fargebadlayout). Fyllingen av reagensbeholderen kan også konfigureres til et bestemt tidspunkt i fargebadlayout-meny (→ S. 93 – 6.4 Stasjonsdetaljer).

- Etter at programvaren har beregnet fargebadlayouten ved hjelp av de prioriterte programmene, får brukeren en oversikt over resultatene på skjermen (→ "Fig. 52").

## 5 Drift



### Merk

- Hvis ingen Leica-programmer er integrert i fargebadlayouten, avviker visningen (→ "Fig. 52") fra den som vises (ikke avbildet). I så fall kan reagensene fylles som beskrevet i (→ S. 80 – **Fylling av reagens**).
- Hvis Leica-programmene ble integrert i fargebadlayouten, må reagensen "95 % alkoholdehyd 1" dupliseres først. Den aktuelle stasjonen i fargebadlayouten har blå kontur (→ "Fig. 52-1").
- Reagensen **95 % alkoholdehyd 1**, som skal dupliseres, vises med forkortelsen "95Dhy1" i fargebadlayouten.

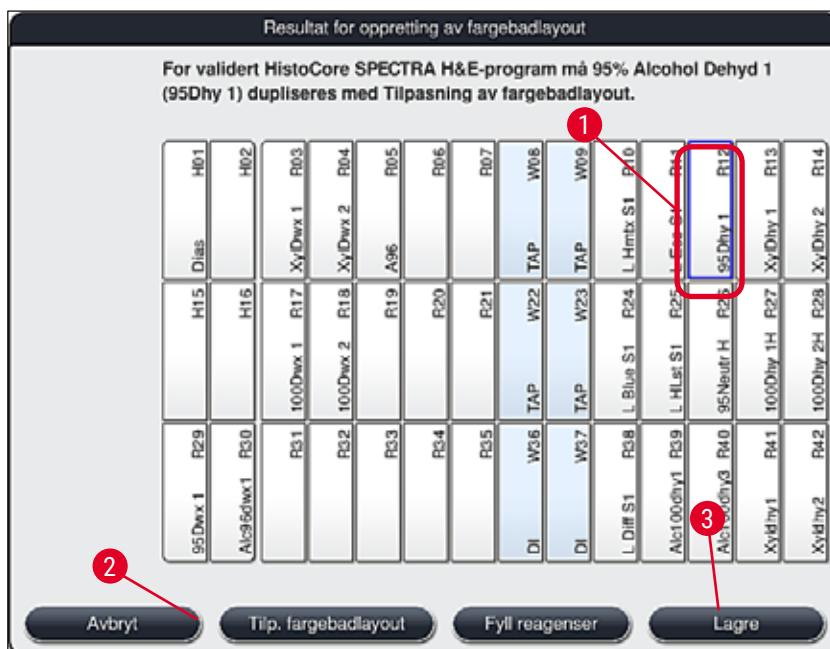


Fig. 52

### Duplicere reagensen 95Dhy1



### Merk

Hvis ingen reagensstasjoner er tilgjengelige på grunn av de valgte programmene, kan du forsøke å optimere brukerdefinerte programmer med hjelp fra Leicas brukerstøtte.

Dette er prosedyren for å duplisere reagensen 95Dhy1:

1. Trykk på knappen **Tilp. fargebadlayout** (→ "Fig. 52-2").
2. Les informasjonsmeldingen som vises på skjermen, og bekrefte med **OK!** En ny **Utklippstavle** (→ "Fig. 53") åpnes.

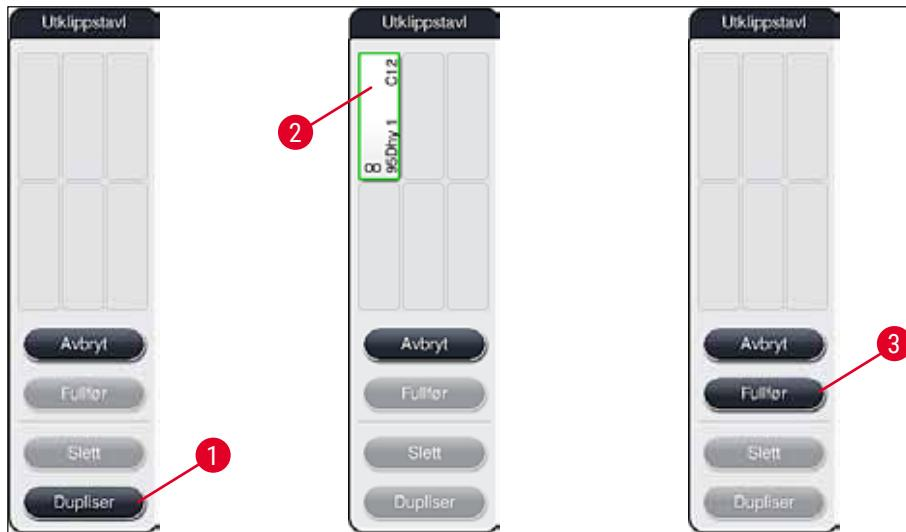


Fig. 53

3. Velg stasjonen **95Dhy1** (→ "Fig. 52-1") i fargebadlayouten ved å trykke på den (stasjonen er grønn). Klikk deretter på knappen **Dupliser** (→ "Fig. 53-1") i **utklippstavlen**. En identisk kopi av den valgte stasjonen vises på **utklippstavlen** (→ "Fig. 53-2").
4. Velg stasjonen på **utklippstavlen**, og klikk på en ledig posisjon i "**Fargebadlayout**". Den dupliserte stasjonen flyttes fra utklippstavlen til fargebadlayouten (→ "Fig. 54-1").

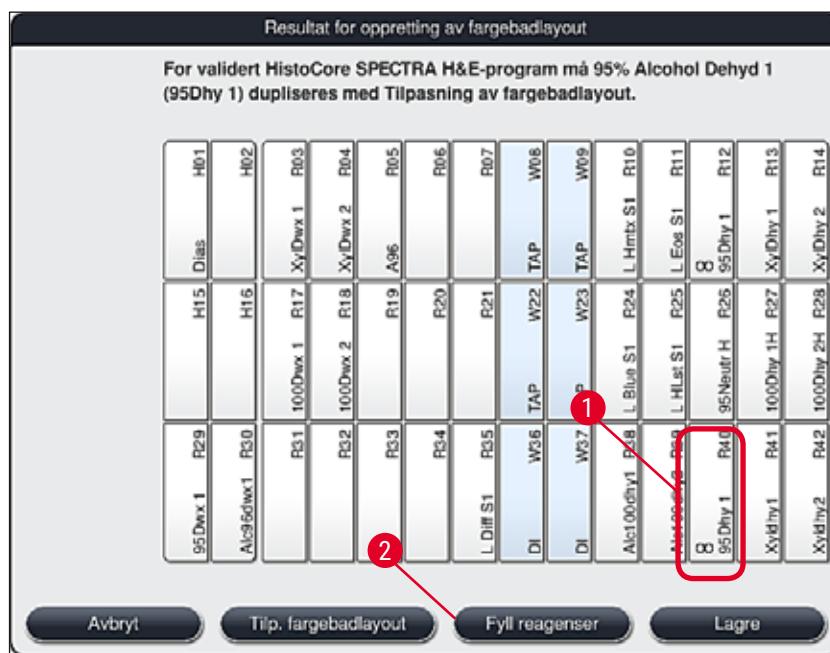


Fig. 54

5. Trykk på **Fullfør**-knappen (→ "Fig. 53-3") på **Utklippstavlen**, og bekrefte den etterfølgende meldingen med "Ja" for å ta i bruk endringene og lukke utklippstavlen.

- ✓ Den dupliserte stasjonen **95Dhy1** og den originale stasjonen vises med et ekvivalenssymbol ( $\infty$ ) i fargebadlayouten (→ "Fig. 54-1").

## 5 Drift

### Fylling av reagens

1. Trykk på knappen **Fyll reagenser** (→ "Fig. 54-2").
2. I det nye vinduet **Fyll reagenser** (→ "Fig. 55") er stasjonene som skal fylles, merket med oransje (→ "Fig. 55-1").



#### Merk

Bare brukerdefinerte reagenser og reagenser som er lagt til Leica-fargeprogrammene vises med oransje markering (→ "Fig. 55"). Deretter skannes reagensene fra Leica-reagenssettet (→ S. 81 - **Fylle reagenser i Leica-reagenssettet**).

3. Fyll de merkede reagensbeholderne utenfor instrumentet med tilsvarende reagenser i korrekt rekkefølge, og sett dem tilbake i riktig posisjon i instrumentet.
4. Kontroller påfyllingen og tilbakestill reagensbeholderne ved å trykke på den aktuelle stasjonen (→ "Fig. 55-1") på skjermen.
5. Gjenta disse trinnene for alle stasjonene som er merket oransje.

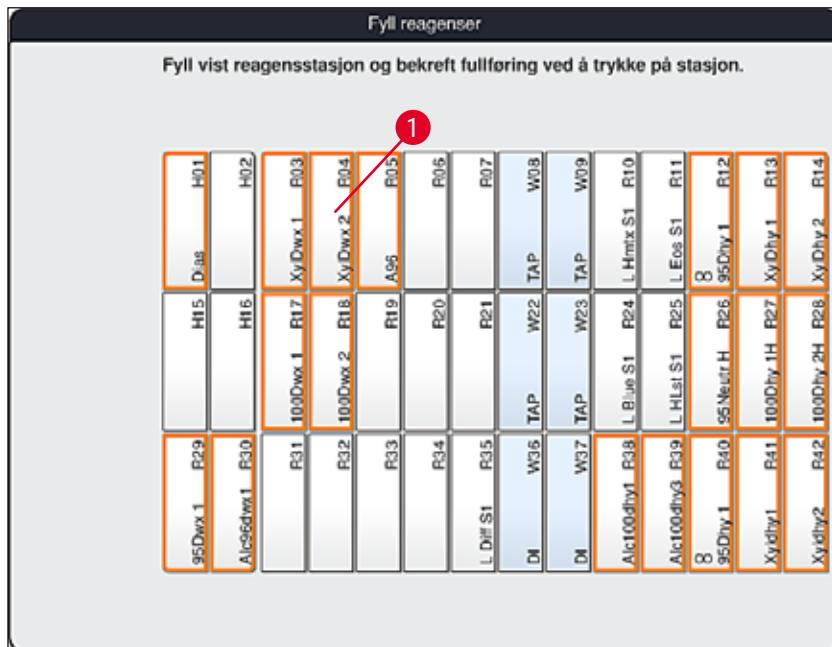


Fig. 55



#### Advarsel

Organiseringen av tilordningsplanen må følges nøyaktig. Et eventuelt avvik kan gi uønskede fargeresultater.

## Fylle reagenser i Leica-reagenssettet



### Merk

Når du har duplisert reagensstasjonen 95 % alkoholdehyd1 (→ S. 78 – Duplisere reagensen 95Dhy1) og fylt reagensene (→ S. 80 – Fylling av reagens), mates reagensene til Leica-settet.

1. Når du ser informasjonsmeldingen (→ "Fig. 56") på skjermen, holder du pakkeetiketten foran RFID-sensoren på fremsiden av instrumentet (→ "Fig. 57-1") for å skanne etiketten.
2. Skann deretter den første Leica-reagensflasken etter at informasjonsmeldingen (→ "Fig. 57-2") vises. Hold etiketten til reagensflasken foran RFID-sensoren på fremsiden av instrumentet (→ "Fig. 57-1") for å skanne den.
3. I det nye vinduet "Endre reagens fra Leica-sett" (→ "Fig. 58"), er stasjonen som skal fylles, merket med oransje (→ "Fig. 58-1").
4. Fyll den merkede reagensbeholderen utenfor instrumentet med tilhørende Leica-reagens, og sett den tilbake i riktig posisjon i instrumentet.
5. Kontroller påfyllingen og tilbakestill reagensbeholderen ved å trykke på den aktuelle stasjonen (→ "Fig. 58-1") på skjermen.
6. Skann deretter etikettene på hver enkelt reagensflaske når du blir bedt om det (→ "Fig. 57-2"), og gjenta trinn 2–5.

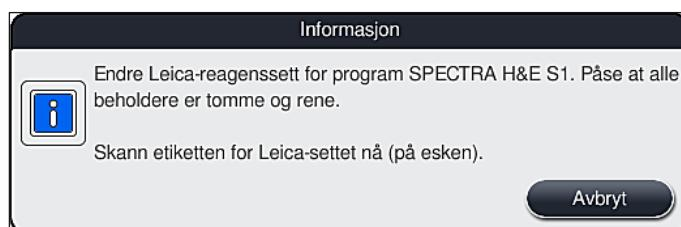


Fig. 56

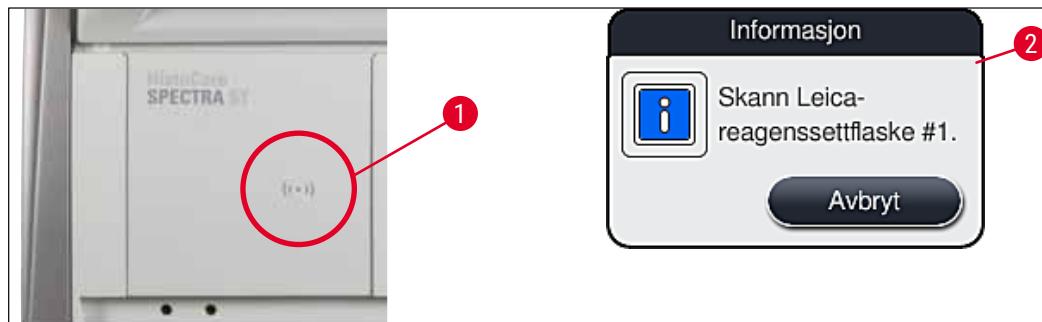


Fig. 57

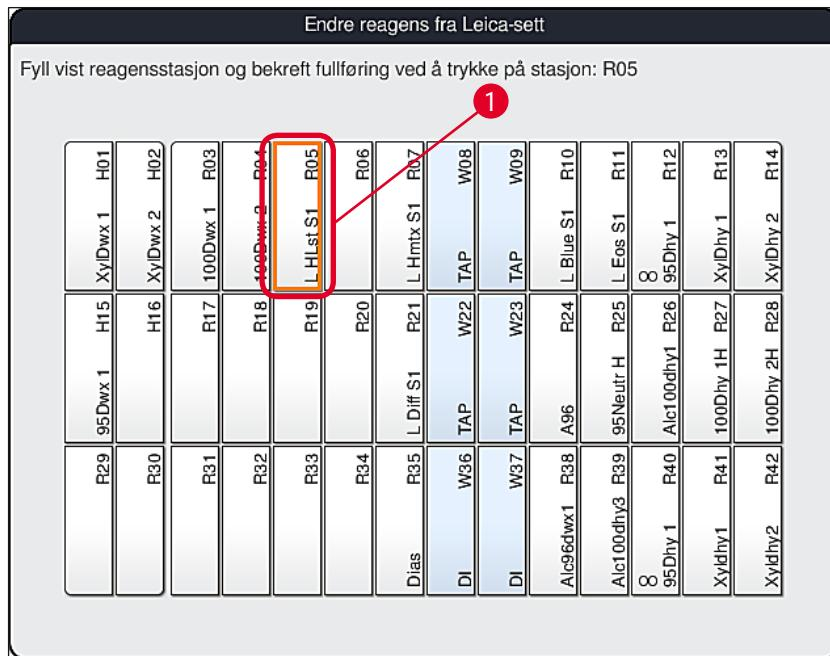


Fig. 58

**Merk**

Brukeren har 5 minutter på seg til å skanne reagensene fra pakkeetiketten, og 5 minutter per reagensflaske.

Hvis skanningen av en reagensflaske eller pakkeetikett mislykkes, har brukeren 2 nye forsøk før reagensemplet blir ugyldig.

**Advarsel**

Hvert Leica-reagenssett kan bare skannes én gang.

- Skanningen av Leica-reagenssettet kan bare avbrytes med **Avbryt**-knappen i informasjonsmeldingen som vises i (→ "Fig. 56"), før skanningen av pakkeetiketten begynner, uten at Leica-reagenssettet utløper.
- Skanningen kan skje senere. Mer informasjon om denne prosedyren finnes i (→ S. 97 – **Reagensutskifting**) (→ "Fig. 75") og (→ "Fig. 76").
- Hvis operasjonen ikke avbrytes før den første etiketten (pakkeetiketten på esken) skannes, utløper Leica-reagenssettet.

**Merk**

Reagensstyringssystemet (**RSS**) bruker automatisk følgende data for Leica-reagensene:

- Best-før-dato (etter at den er åpnet)
- Antall gjenværende objektglass
- Maks. antall objektglass
- Utløpsdato
- Partinummer

**Advarsel**

- Organiseringen av fargebadlayouten må følges nøyaktig. Et eventuelt avvik kan gi uønskede fargeresultater.
- Alle flaskene i Leica-reagenssettet skal skannes.
- Sørg for at ingen Leica-reagenser fra andre Leica-reagenssett brukes.
- Reagensbeholdere må alltid fylles utenfor instrumentet, i tråd med sikkerhetsinformasjonen.

**Merk**

Til slutt vises en informasjonsmelding på skjermen. Brukeren blir bedt om å starte den automatiske skanningen av påfyllingsnivået. Trykk på **OK** i informasjonsmeldingen (→ "Fig. 59") for å starte skanningen.

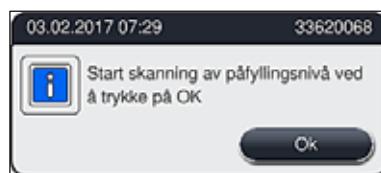


Fig. 59

**5.9.11 Tilpassing av fargebadlayout****Advarsel**

Den automatiske og optimale fargebadlayouten som er opprettet, må kun endres hvis det ikke er tatt hensyn til bestemte brukerkrav, eller hvis Leica-programmet krever det. Brukerhåndboken som følger med Leica-reagenssettet, skal følges! Du må være pålogget som administrator for å endre fargebadlayouten.

Alle endringer av fargebadlayouten kan få negative følger for prøvegjennomstrømningen og fargeresultatet.

Følgende regler må overholdes ved endring av fargebadlayouten:

- Reagensstasjoner må ikke flyttes fra den ene siden av beholderfeltet til den andre, fordi dette vil føre til unødvendig lang overføringstid.
- Dupliserte stasjoner må være på samme side av beholderfeltet (→ "Fig. 39") (→ "Fig. 64"). Ellers kan ikke justeringen av fargebadlayouten lagres.

Hvis du trenger å tilpasse fargebadlayouten som er utført av HistoCore SPECTRA ST, og som tar hensyn til alle optimaliseringsregler, kan du velge funksjonen **Tilp. fargebadlayout** (→ "Fig. 60-1").

Ved hjelp av denne funksjonen kan stasjoner flyttes fra posisjonene i fargebadlayouten og/eller dupliseres.

Det gjør du slik:

## 5 Drift

- I fargebadlayout-visningen (→ "Fig. 60") trykker du på **Tilp. fargebadlayout-knappen** (→ "Fig. 60-1").
- Les informasjonsmeldingene som vises (→ "Fig. 61") (→ "Fig. 62"). Bekreft, eller trykk på **Avbryt** (→ "Fig. 62") for å gå tilbake til fargebadlayout-visningen.
- Etter bekreftelsen åpnes **Utklippstavlen** (→ "Fig. 63"), hvor du kan flytte opptil 6 reagensstasjoner (→ "Fig. 63-1").



Fig. 60

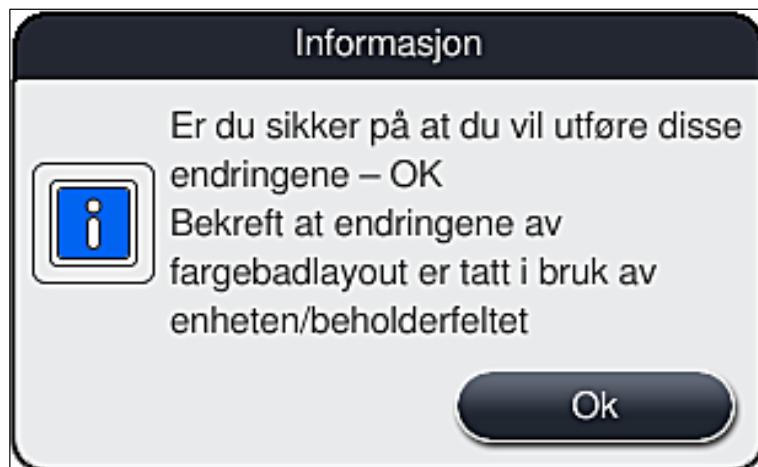


Fig. 61

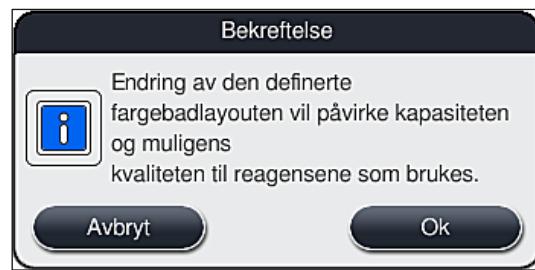


Fig. 62

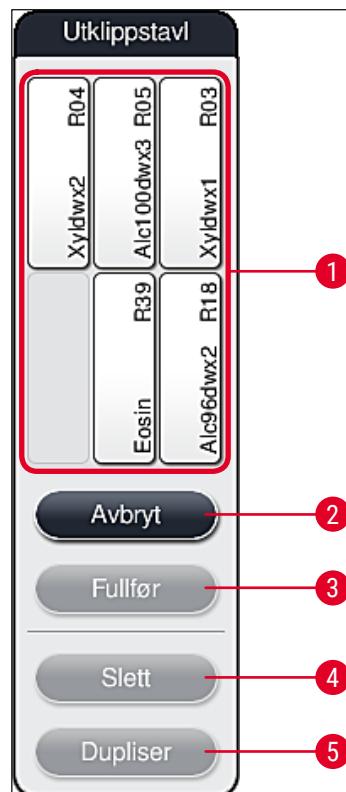


Fig. 63

**Merk**

- Leica-reagensstasjonene som er merket med L før reagensnavnet (→ "Fig. 60-3"), kan flyttes, men de kan ikke dupliseres.
- 

**Merk**

- Utklippstavlen kan lukkes hvis det ikke finnes flere reagensstasjoner på den.
- En informasjonsmelding på skjermen ber brukeren starte automatisk skanning av påfyllingsnivået etter hver endring som er foretatt med Tilp. fargebadlayout-funksjonen. Trykk på **OK** i informasjonsmeldingen for å starte skanningen.

## 5 Drift

**Det finnes to alternativer for endring av fargebadlayouten:**

Flytte reagensstasjoner:

1. For å flytte reagensstasjoner velger du dem individuelt i fargebadlayouten (→ "Fig. 60") ved å trykke på skjermen. Trykk deretter på en ledig plass på utklippstavlen (→ "Fig. 63-1").
2. Reagensstasjonen flyttes til utklippstavlen (→ "Fig. 63-1").
3. Velg deretter reagensstasjonen på utklippstavlen ved å trykke på og dra den til ønsket (ledig) stasjon (→ "Fig. 60-2") i fargebadlayouten.
4. Trykk på **Fullfør** (→ "Fig. 63-3") for å lagre endringene, og trykk på **Ja** for å bekrefte meldingen som vises, eller trykk på **Nei** for å gå tilbake til utklippstavlen.
5. Hvis du vil slette endringene, trykker du på **Avbryt** (→ "Fig. 63-2") og svare **Ja** på informasjonsmeldingen som vises.

Duplisere en reagensstasjon

1. Velg reagensstasjonen du vil duplisere i fargebadlayouten ved å trykke på skjermen.
  2. Deretter trykker du på **Dupliser** (→ "Fig. 63-5")-knappen.
  3. Reagensstasjonen vises deretter på utklippstavlen. Stasjonen og den originale stasjonen vises med et ekvivalenssymbol (→ "Fig. 60-4").
  4. Velg deretter den dupliserte reagensstasjonen på utklippstavlen ved å trykke på skjermen, og plasser den i ønsket (ledig) stasjon nær den opprinnelige stasjonen i fargebadlayouten.
  5. Trykk på **Fullfør** for å lagre endringene, og trykk på **Ja** for å bekrefte informasjonsmeldingen som vises, eller trykk på **Nei** for å gå tilbake til utklippstavlen.
- Hvis du vil slette endringene, trykker du på **Avbryt** og svarer **Ja** på informasjonsmeldingen som vises.



### Merk

- Dupliserte reagensstasjoner er praktiske i programtrinn som har lang hviletid i en reagens. Dupliserte stasjoner gir programtrinnet tilgang til to tilsvarende reagensstasjoner og sikrer høy prøvegjennomstrømning.
- Dupliserte reagensstasjoner kan slettes med **Slett**-knappen (→ "Fig. 63-4"). Da merker du først stasjonene i fargebadlayouten ved å trykke på dem. Trykk deretter på "Slett".

## 6. Daglig oppsett av instrumentet

### 6.1 Klargjøre instrumentet for daglig oppsett



#### Merk

- (→ "Fig. 64") viser en oversikt over de forskjellige stasjonene i beholderfeltet.
- Til sammen består beholderfeltet av 36 reagensstasjoner og 6 skyllevannstasjoner.
- Maks. kapasitet per reagensbeholder er 380 ml.

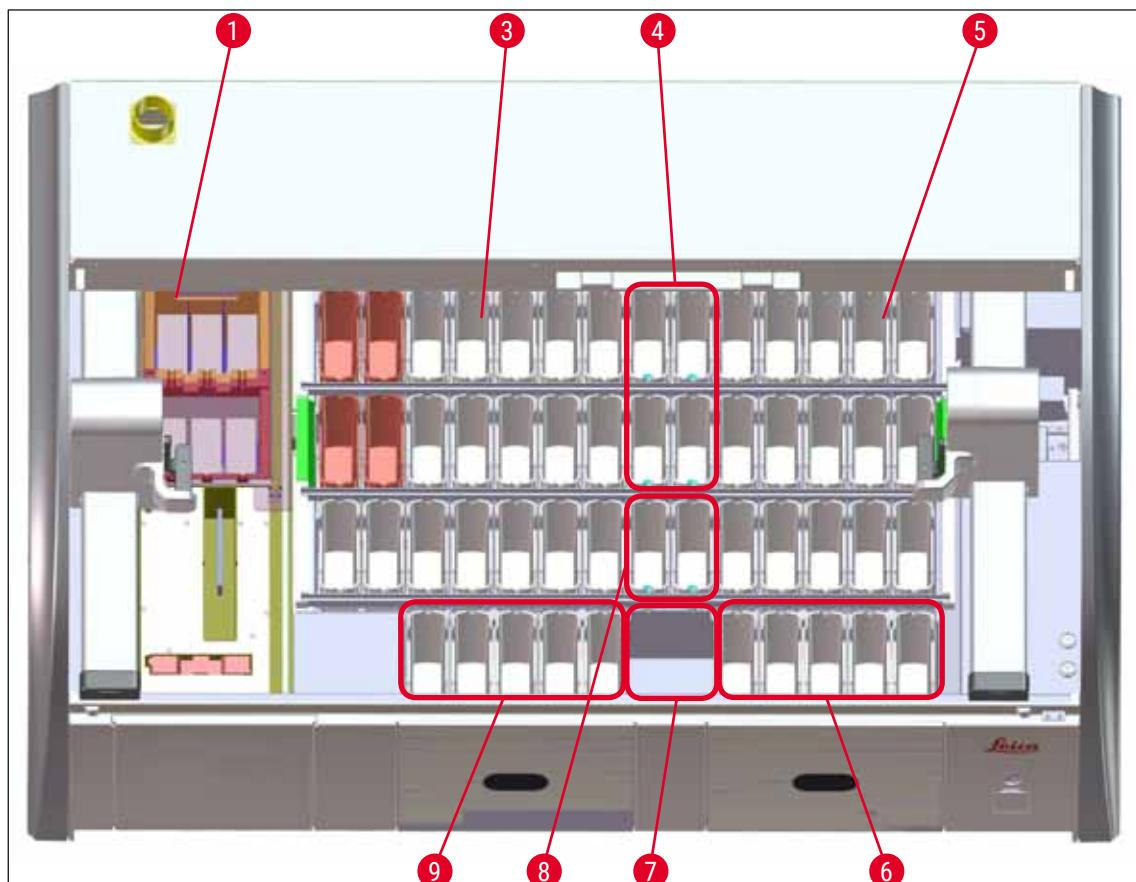


Fig. 64

- 1 6 ovnsstasjoner
- 3 Venstre beholderfelt
- 4 Skyllevannstasjoner (gruppe med fire)
- 5 Høyre beholderfelt
- 6 5 utmatingsstasjoner
- 7 Tørroverføringsstasjon
- 8 Skyllevannstasjoner (gruppe på to)
- 9 5 innmatingsstasjoner

## 6 Daglig oppsett av instrumentet

### 6.2 Daglig oppsett av instrumentet



#### Merk

Kontroller instrumentets vanninntak og skru det eventuelt på før det daglige instrumentoppsettet.

- Åpne instrumentdekselet og fjern lokkene på reagensbeholderne.
- Slå på instrumentet.

#### Automatisk skanning av påfyllingsnivå ved initialisering av instrumentet

I forbindelse med initialisering av instrumentet utføres en automatisk skanning av påfyllingsnivå i følgende områder:

- Reagensbeholdere
- Skyllevannsbeholdere
- Reagensbeholdere i inn- og utmatingsstasjonene
- Ovnsstasjon



#### Merk

Hvis instrumentet fremdeles inneholder stativer, reagensbeholdere som ikke er tilstrekkelig fylt (eller fremdeles er tildekket) og/eller skyllevannsbeholdere som ikke er klare til bruk, blir dette påvist under den automatiske skanningen av påfyllingsnivået. Resultatet vises når skanningen er fullført.

#### 6.2.1 Klargjøring og håndtering av reagensbeholdere

Følg merknadene nedenfor, og gå frem som følger for å sikre problemfri drift av instrumentet.

##### Feste håndtaket for reagensbeholderen

Kontroller om håndtaket til reagensbeholderen er riktig festet til reagensbeholderen. Er det ikke det, må håndtaket festes i henhold til ([→ "Fig. 65"](#)).

##### Fylle og tømme reagensbeholdere



#### Advarsel

Reagensbeholderne må alltid fylles og tømmes utenfor instrumentet. Det er for å unngå eller redusere fare for at det såles reagens i andre reagensbeholdere og på innvendige instrumentkomponenter. Vær forsiktig ved fylling og tömming av reagensbeholdere, og følg alle relevante, gjeldende laboratoriespesifikasjoner. Hvis det såles reagens, eller hvis andre reagensstasjoner er kontaminert, må sålet fjernes og beholderne fylles på nytt. Beholderne må dekkes til når instrumentet ikke er i bruk for å unngå unødvendig fordamping av reagensene.

### Riktig fyllnivå for reagensbeholdere

- Følg med på fyllnivåmerkene på innsiden av reagensbeholderne (→ "Fig. 65") (→ "Fig. 66") når du fyller på begge reagensbeholdertypene.
- Tilstrekkelig påfyllningsnivå er mellom maksimums- (→ "Fig. 65-1") og minimumsmerkene (→ "Fig. 65-2").
- Hvis reagensbeholderne (eller de oppvarmede reagensbeholderne) har innsatser for spesialfarger (→ "Fig. 66") for å redusere reagensvolumet, skal de settes inn i reagensbeholderen først. Fyll deretter reagensen til det angitte minimumsnivået (→ "Fig. 66-2") eller mer, men ikke over det maksimale påfyllningsnivået (→ "Fig. 66-1").

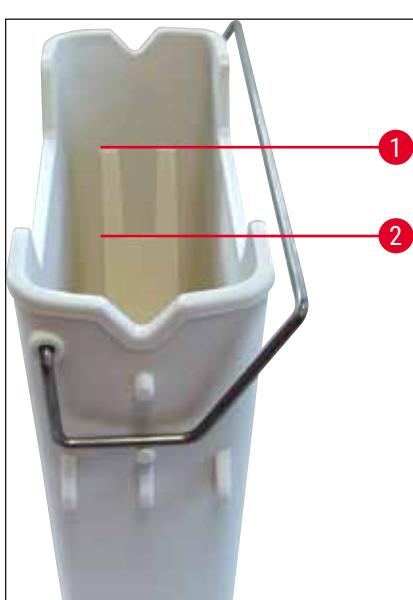


Fig. 65

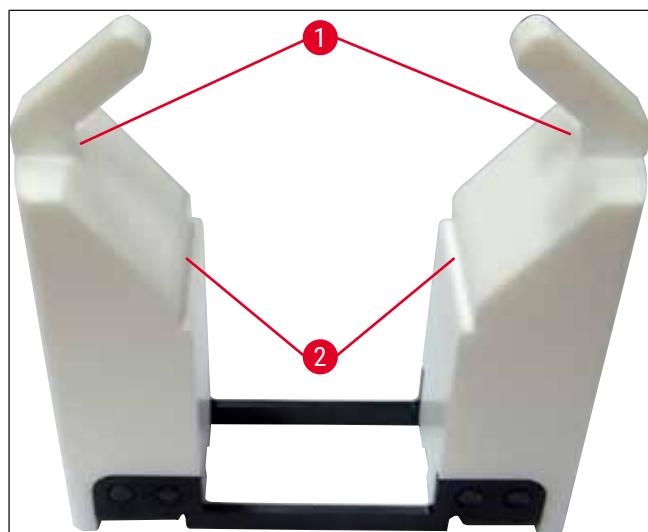


Fig. 66

### Sette reagensbeholderen i et beholderfelt

- Velg **Fargebadlayout** (→ S. 38 – 5.5 Hovedmeny – oversikt) i hovedmenyen, og sett reagensbeholderen i riktig posisjon i samsvar med oppsettet i fargebadlayouten.



#### Merk

Sett reagensbeholderen med håndtak forsiktig inn i beholderfeltet, slik at håndtaket er på høyre side av reagensbeholderen når du ser mot beholderfeltet (→ "Fig. 67-1"). Denne håndtaksretningen anbefales også ved plassering av reagensbeholdere i inn- og utmatingsstasjonen.



#### Merk

I likhet med stativhåndtaket for 5 objektglass har innsatsen for spesialfarging et spesialbelegg som hindrer kjemisk påvirkning av reagensene for spesielle bruksområder (f.eks. berlinerblå farging for påvisning av jern, eller sølvfarging, som Grocott eller Gomori). Mer informasjon om reagenser som skal brukes med belagt tilbehør, finnes i (→ S. 152 – A1. Vedlegg 1 – Kompatible reagenser).

## 6 Daglig oppsett av instrumentet

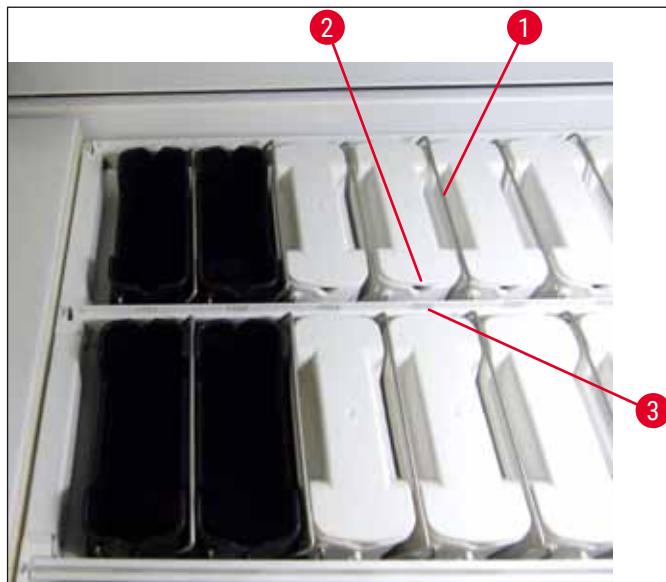


Fig. 67



### Advarsel

Sett ikke reagensbeholderne i instrumentet sideveis forskjøvet fra stasjonsnummeret. Det gjør du ved å kontrollere at hakket på fremsiden av reagensbeholderen (→ "Fig. 67-2") og stasjonsnummeret (→ "Fig. 67-3") er i samme høyde.

#### 6.2.2 Automatisk skanning av påfyllingsnivå

Etter at reagensbeholderne er fylt og satt inn, bør det utføres en automatisk skanning av påfyllingsnivået (→ "Fig. 68-1") for å kontrollere at alle reagensene som brukes har riktig påfyllingsnivå.



### Merk

- Det tas ikke hensyn til inn- og utmatingsstasjonene under utføringen av fargebadlayouten. Reagenser i inn- og utmatingsstasjonene må defineres og overvåkes av brukeren.
- Reagensene i inn- og utmatingsstasjonene overvåkes ikke av reagensstyringssystemet. Det er derfor brukerens ansvar å sørge for at reagensene i disse stasjonene er i feilfri stand.

Start skanning av påfyllingsnivå manuelt på følgende måte:

1. Finn **Fargebadlayout** (→ S. 38 – 5.5 Hovedmeny – oversikt) i hovedmenyen.
2. Knappen **Skanning av påfyllingsnivå** (→ "Fig. 68-1") er i den nedre delen av menyskjermbildet.
3. Trykk på knappen for å starte skanning av påfyllingsnivå.



### Merk

Uregelmessigheter som avdekkes under skanningen, vises på skjermen. Følg informasjonsmeldingene og, for eksempel, korriger påfyllingsnivå, fjern lokk, legg til reagensbeholdere e.l.

### 6.3 Reagensstyringssystem (RSS)



Trykk på menyknappen ved siden av (→ "Fig. 68") for å vise fargebadlayouten til instrumentet. Denne visningen viser den gjeldende oppstillingen for reagensstasjonene, skyllevannstasjonene og inn- og utmatingsstasjonene i instrumentet.



Fig. 68

Instrumentet leveres med tomt fargebadlayout fordi det ikke er definert reagenser eller utført en fargebadlayout.

Hvis reagenser (→ S. 58 – Opprette en ny reagens, eller kopiere en reagens) og programmer (→ S. 69 – 5.9.5 Opprette eller kopiere et nytt fargeprogram) er definert, og fargebadlayouten er utført (→ S. 76 – 5.9.9 Utføre fargebadlayout), viser oversikten (→ "Fig. 68") alle stasjonene i instrumentet i faktisk rekkefølge.

## 6 Daglig oppsett av instrumentet

Hver reagensbeholder som vises i fargebadlayouten, inneholder ytterligere informasjon:

- Stasjonsnummer ([→ "Fig. 68-2"](#))
- Forkortelse for reagensnavnet ([→ "Fig. 68-3"](#))
- Bakgrunnsfarge ([→ "Fig. 69"](#))
- Ekvivalenssymbol for eventuelle dupliserte reagensstasjoner ([→ "Fig. 68-4"](#))



### Merk

- Bakgrunnsfargen viser forbruksstatusen for reagensen ([→ "Fig. 69"](#)). Etterhvert som reagensen forbrukes, stiger fargestolpen fra bunnen til toppen og endrer farge i samsvar med forbruksstatusen.
- Den aktuelle reagensen må byttes så snart forbruksstatusen **RØD** ([→ "Fig. 69-3"](#)) er nådd. Når stasjonen blinker rødt, skal reagensen byttes umiddelbart. Hvis dette ikke blir gjort, kan ikke Leica-fargeprogrammene starte lenger.
- Se ([→ S. 57 – 5.8 Reagensliste](#)) for mer informasjon om RSS.

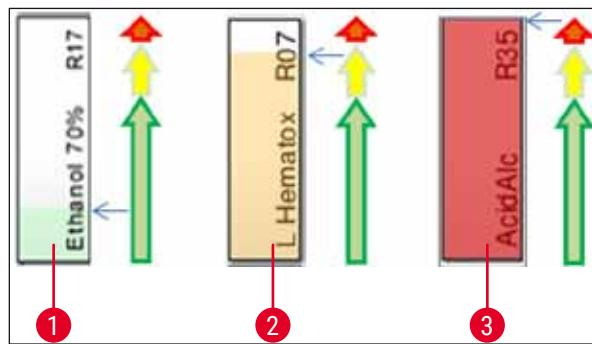


Fig. 69

- 1 Grønn: Forbruksstatus mellom 0–80 % av maksimal bruksgrense
- 2 Gul: Forbruksstatus mellom 80–95 % av maksimal bruksgrense
- 3 Rød: Forbruksstatus mellom 95–100 % av maksimal bruksgrense

## 6.4 Stasjonsdetaljer

Trykk på en stasjon i fargebadlayouten for å vise mer informasjon (stasjonsdetaljer). Følgende stasjonstyper skiller ut av forkortelsene:

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>L01-L05</b> | Innmatingsstasjoner  |
| <b>SID</b>     | Lesestasjon for objektglass og tittelblokkidentifikasjon (valgfritt)       |
| <b>001-006</b> | Ovnsstasjoner for tørking av objektglass og innledende smelting av parafin |
| <b>R01-R42</b> | Reagensstasjoner   |
| <b>W08-W09</b> | Skyllevannstasjoner (gruppe med fire)                                      |
| <b>W22-W23</b> |  |
| <b>W36-W37</b> | Skyllevannstasjoner (gruppe på to)   |
| <b>D01-D02</b> | Tørroverføringsstasjoner   |
| <b>U01-U05</b> | Utmatingsstasjoner i utmatingsskuffen                                      |

### Lesestasjon for objektglass (SID):

Når du trykker på denne stasjonen, vises en merknad om at dette er lesestasjonen for objektglass. Trykk på Lukk (→ "Fig. 70") for å lukke visningen.



Fig. 70

### Ovnsstasjoner:

En detaljert visning (→ "Fig. 71") av en ovnsstasjon viser:

- Gjeldende temperatur (→ "Fig. 71-1"),
- Måltemperaturjustering (→ "Fig. 71-2") og
- Driftsmodus (→ "Fig. 71-3") for de seks ovnsstasjonene

Trykk på Lukk (→ "Fig. 71-4") for å lukke visningen.

## 6 Daglig oppsett av instrumentet



Fig. 71

### Skyllevannstasjoner (gruppe med fire):

En detaljert visning av en skyllevannstasjon (→ "Fig. 72") viser alle andre skyllevannstasjoner som er tilkoblet samme vannkretsløp. Trykk på Lukk for å lukke visningen.

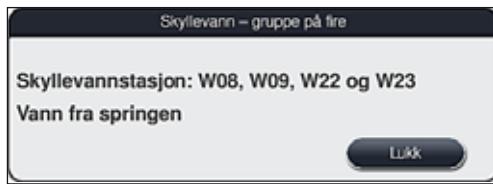


Fig. 72

### Skyllevannstasjoner (gruppe på to):

Når du trykker på en skyllevannstasjonsgruppe med to stasjoner, åpnes et informasjonsvindu som viser de to vannstasjonene som er tilkoblet det andre vannkretsløpet med f.eks. destillert vann, demineralisert vann (→ "Fig. 73-1") eller skyllevann (→ "Fig. 73-2").



#### Merk

Den aktuelle vannforsyningen velges i denne menyen avhengig av hva som er tilkobletsupply (→ S. 26 – 4.2.1 Knutepunktsforbindelse for alle seks skyllevannstasjoner) (→ S. 26 – 4.2.2 Kombinert tilkobling 4+2 skyllevannstasjoner).

Du må være pålogget som **administrator** for å programmere skyllevannstasjonene (gruppe på to).



#### Advarsel

Riktig tilordning og tilkobling av skyllevannsbeholdere er helt avgjørende for å oppnå god fargekvalitet.

- Trykk på Lagre (→ "Fig. 73-3") for å lagre innstillingene, eller trykk på Avbryt (→ "Fig. 73-4") for å lukke visningen uten å ta i bruk eventuelle endringer.



Fig. 73

### Innmatingsstasjoner i mateskuffen

Ingen reagenser er tilordnet matestasjonene når instrumentet forlater fabrikken.

Hvis en reagens skal tilordnes en matestasjon, må du gjøre som følger:

1. Velg den tilhørende stasjonen i fargebadlayouten (→ "Fig. 19-1") ved å trykke på den.
  2. I "Stasjonsdetaljer"-vinduet som åpnes, trykker du på den svarte Reagensnavn (→ "Fig. 74-1")-knappen for å åpne listen over tilgjengelige reagenser (→ S. 57 – 5.8 Reagensliste).
  3. Velg ønsket reagens ved å trykke på den, og trykk deretter på Påfør.
  4. Trykk på Lagre (→ "Fig. 74-2") for å lagre innstillingene, eller trykk på Avbryt (→ "Fig. 15-3") for å lukke visningen uten å ta i bruk eventuelle endringer.
- ✓ Det tilordnede reagensnavnet vises i fargebadlayouten.

Hvis det ikke lenger er behov for en bestemt reagens i matestasjonen, kan tilordningen til de aktuelle reagensene fjernes ved å trykke på knappene Slett (→ "Fig. 74-4") og Lagre (→ "Fig. 74-2") i Stasjonsdetaljer-vinduet.



Fig. 74

## 6 Daglig oppsett av instrumentet



### Merk

Det tas ikke hensyn til inn- og utmatingsstasjonene under utføringen av fargebadlayouten. Reagenser i inn- og utmatingsstasjonene må defineres og overvåkes av brukeren.



### Advarsel

Stativene transporteres inn i en ledig utmatingsstasjon på slutten av programmet.

Alle utmatingsstasjoner må derfor være fylt med samme type reagens.

Er de ikke det, kan prøvene bli ødelagt.

### Reagensstasjoner

Et informasjons vindu åpnes når du trykker på reagensstasjonen. Her vises annen relevant informasjon om stasjonstypen (reagensstasjon ([→ "Fig. 75"](#)), Leica-reagensstasjon ([→ "Fig. 76"](#))).

<b>Reagensnavn</b> ( <a href="#">→ "Fig. 75-1"</a> ), <b>Forkortelse</b> ( <a href="#">→ "Fig. 75-2"</a> )	(→ S. 58 – Opprette en ny reagens, eller kopiere en reagens)
<b>Forbruksstatus</b> ( <a href="#">→ "Fig. 75-3"</a> )	(→ S. 91 – 6.3 Reagensstyringssystem (RSS))
<b>Gjenværende objektglass</b> ( <a href="#">→ "Fig. 75-4"</a> ), <b>Maks. objektglass</b> ( <a href="#">→ "Fig. 75-6"</a> )	Viser antallet gjenværende objektglass som kan behandles. Når et stativ settes inn i instrumentet, blir objektglassene i stativet telt av lesestasjonen for objektglass og trukket fra antallet gjenværende objektglass.
<b>Objektglass etter utskifting</b> ( <a href="#">→ "Fig. 75-5"</a> )	Viser antall objektglass som har blitt behandlet siden forrige reagensbytte.
<b>Holdbarhet i systemet etter åpning</b> ( <a href="#">→ "Fig. 75-7"</a> )	Viser holdbarheten til reagensen som er fylt i reagensbeholderen.
<b>Angi Ja/Nei</b> ( <a href="#">→ "Fig. 75-8"</a> )	Ja indikerer at innsatsen for spesialfarger og objektglassholderen for 5 objektglass er i bruk. Denne stasjonen kan ikke brukes for programmer med stativer for 30 objektglass ( <a href="#">→ S. 57 – 5.8 Reagensliste</a> ).
<b>Utelukkende Ja/Nei</b> ( <a href="#">→ "Fig. 75-9"</a> )	Innstillingen Ja definerer at reagensen kun tilordnes ett program. Nei tillater bruk av flere programmer ( <a href="#">→ S. 72 – 5.9.6 Legge til eller kopiere et nytt programtrinn</a> ).
<b>Utløpsdato</b> ( <a href="#">→ "Fig. 76-1"</a> ), <b>Partinummer</b> ( <a href="#">→ "Fig. 76-2"</a> )	påføres automatisk når pakken til Leica-reagenssettet skannes.

### Detaljert visning av reagensstasjonen

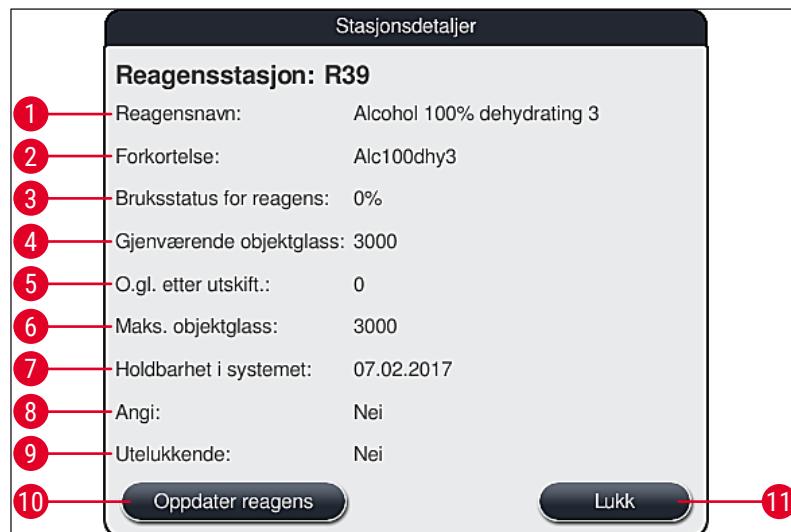


Fig. 75

### Detaljert visning av Leica-reagensstasjonen



Fig. 76

### Reagensutskiftning

- Hvis RSS viser at reagensen er helt eller nesten oppbrukt, må reagensen byttes. Dette byttet må bekreftes med knappen **Oppdater reagens** (→ "Fig. 75-10").
- Når du bytter Leica-reagensene, trykker du først på knappen "Oppdater reagens". Følg deretter instruksjonene for skanning og påfylling på skjermen.
- Trykk på **Lukk** (→ "Fig. 75-11") for å lukke visningen.

## 6 Daglig oppsett av instrumentet



### Merk

- Merk: Utskiftning av reagenser etterfulgt av en oppdatering til RSS-data er bare mulig hvis instrumentet er i driftsmodus og det ikke lenger er stativer i instrumentet (inkludert inn- og utmatingskuffene).

Hvis et brukerdefinert fargeprogram fremdeles er i bruk til tross for at reagensene må byttes, overskrides antallet objektglass verdien **Maks. objektglass** (→ "Fig. 75-6"). Det overskredne antallet objektglass kan fastslås ved å sammenligne informasjonen i radene **Objektglass siden bytting** og **Maks. objektglass** i stasjonsdetaljene (→ "Fig. 75-5").

- Reagensene i Leica-reagenssettene har en grense på 30 overskredne objektglass. Denne grensen gjelder ikke ekstra reagenser knyttet til Leica-programmer (f.eks. alkohol og xylen).



### Advarsel

- Hvis reagensstatusen oppdateres uten at den tilsvarende reagensen byttes, vil dette ha en negativ effekt på fargekvaliteten.
- Trykk **ALDRI** på **Oppdater reagens**-knappen med mindre reagensen er byttet.



### Merk

Hvert Leica-reagenssett kan bare skannes én gang!

Leica-reagenser som allerede er lagt til, utløper før best-før-datoen hvis fargebadlayouten er utført nylig.

### 6.5 Klargjøre stativet



### Advarsel

Hvert stativhåndtak (→ "Fig. 78-1") inneholder to RFID-brikker. Stativhåndtakene kan derfor bare festes til stativet (→ "Fig. 78-2") etter et eventuelt mikrobølgetrinn for klargjøring av prøver.

To ulike stativer med kompatible håndtak er tilgjengelige for bruk i fargemaskinen HistoCore SPECTRA ST:

- Stativ for 30 objektglass for rutinefarging (→ "Fig. 78").
- Stativ for 5 objektglass for spesialfarging (→ "Fig. 79").



### Merk

Hvis det brukes en dekkglassmaskin fra en annen produsent til påsetting av dekkglass på stativer farget av HistoCore SPECTRA ST, tilbyr HistoCore SPECTRA ST alternativet å bruke stativer fra andre produsenter. Disse stativene må utstyres med et stativhåndtak som er produsert av Leica og godkjent for denne produsenten. Stativer fra andre produsenter transporteres vanligvis til HistoCore SPECTRA ST-utmatingskuffen etter farging, og brukeren må fjerne dem derfra.

Se (→ S. 143 – Stativhåndtak for stativer fra andre produsenter) for tilgjengelige stativhåndtak.

De fargede håndtakene må festes korrekt før stativet brukes i instrumentet.

Stativhåndtakene må festes i henhold til den tidligere definerte programfargen (→ S. 65 – 5.9.1 Tilordner en stativhåndtaksfarge til et fargeprogram).

Håndtakene for objektglass finnes i 9 farger (8 programfarger og hvitt)  
(→ S. 141 – 9.2 Tilleggsutstyr).

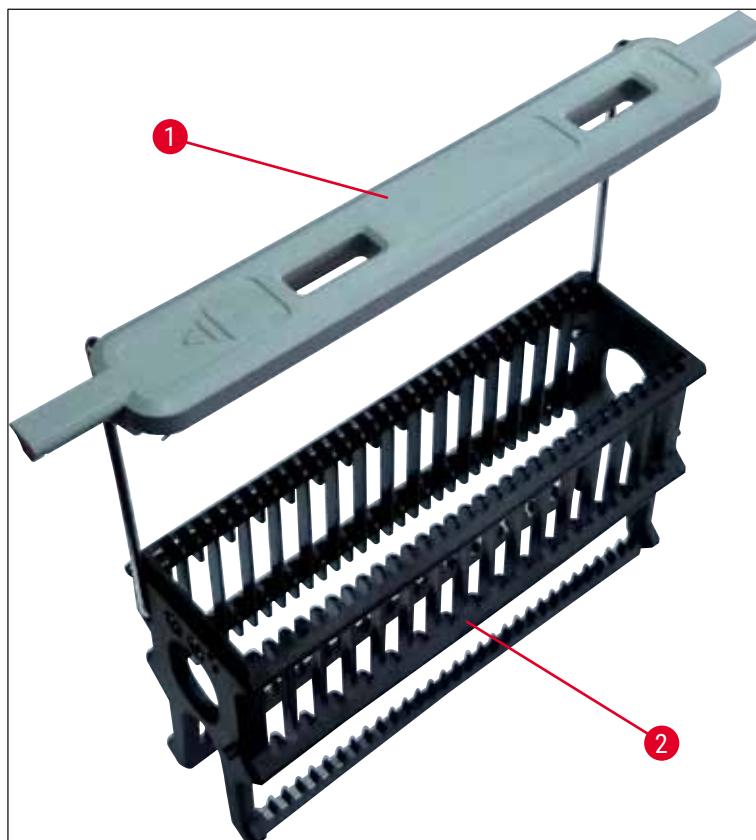


Fig. 78



Fig. 79

## 6 Daglig oppsett av instrumentet



### Merk

Stativhåndtaket for 5 objektglass har et spesialbelegg som hindrer kjemisk påvirkning av reagensene for spesielle bruksområder (f.eks. berlinerblå farging for påvisning av jern, eller sølvfarging, som Grocott eller Gomori). Mer informasjon om reagenser som skal brukes med belagt tilbehør, finnes i ([→ S. 152 – A1. Vedlegg 1 – Kompatible reagenser](#)).

Det hvite håndtakets spesialfunksjon:

- Det hvite håndtaket kan ikke tilordnes et fargeprogram på permanent basis.
- Det hvite håndtaket har en **JOKERFUNKSJON** og må tilordnes en programfarge hver gang programmet startes.
- Derfor åpnes en valgmeny på skjermen automatisk etter at stativet er satt inn.

**Fortsett som følger for å feste eller bytte stativhåndtaket:**

Løsne håndtaket fra stativet:

- Trekk håndtaket lett fra hverandre ([→ "Fig. 80"](#)) slik at håndtakstråden kan trekkes ut av hullene i stativet.

Feste håndtaket til stativet:

- Trekk håndtaket lett fra hverandre og løft det på stativet slik at håndtakstråden går inn i hullene til venstre og høyre på stativet ([→ "Fig. 80-1"](#)) ([→ "Fig. 80-2"](#)).



Fig. 80



### Merk

- Pass på at håndtaket er riktig plassert i den øvre posisjonen midt over stativet ([→ "Fig. 80"](#)).
- Stabiliser stativet under påfylling ([→ "Fig. 81-3"](#)) ved å brette håndtaket ([→ "Fig. 81-1"](#)) til siden så langt som mulig ([→ "Fig. 81-2"](#)) slik at det kan brukes som ekstra beskyttelse mot vipping.

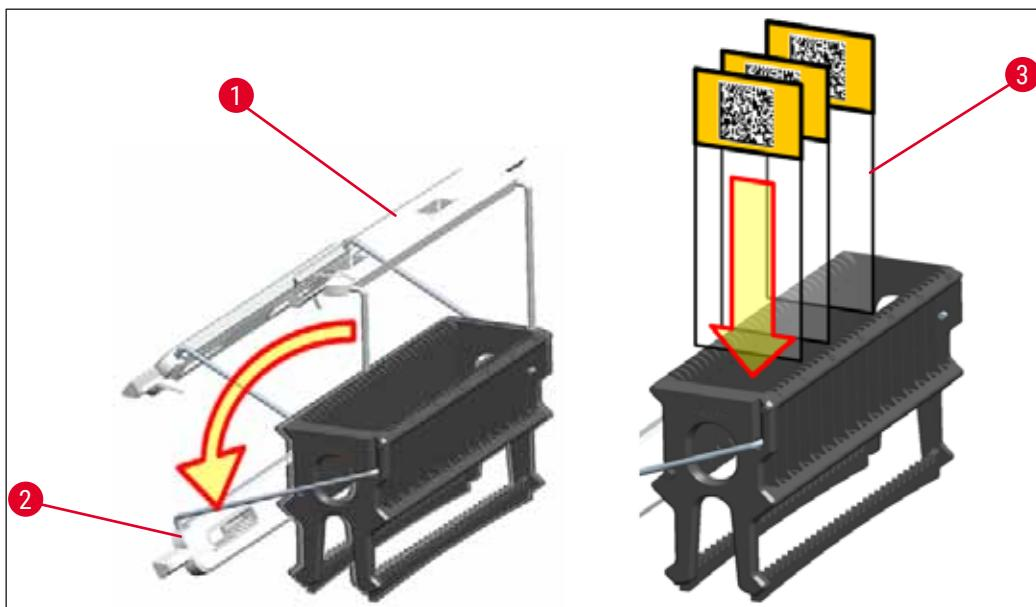


Fig. 81

**Advarsel**

- Påse at sideetiketten (→ "Fig. 81-3") peker oppover og mot brukeren når objektglassene settes inn. Siden av objektglasset med prøven skal vende mot forsiden av stativet.
- Forsiden av stativet er merket med Leica-logoen. Når håndtaket er festet, ser du ordet **FRONT** når du ser på håndtaket (→ "Fig. 81").
- Hvis objektglassene ikke settes inn korrekt, kan prøvene bli ødelagt under fargeprosessen.
- Merkene og/eller etikettene som brukes på objektglassene, må tåle løsningsmidlene som brukes i instrumentet.

**Merk**

- Kun objektglass som innfri kravene i DIN ISO 8037-1-standarden, må benyttes.
- Før du tar i bruk trykte eller håndskrevne etiketter på stativhåndtakene og objektglassene, må du kontrollere at de tåler løsningsmidler.
- Når objektglasset settes inn i stativet, må du sørge for at objektglassene settes inn i respektivt stativ for ønsket fargeprogram. De fargede stativhåndtakene gjør det lett å tilordne dem til riktig fargeprogram.
- Sørg for at kun ett objektglass er satt inn i innsettingssporet, og at objektglassene ikke sitter fast.

## 6 Daglig oppsett av instrumentet

### 6.6 Fargeprosessen

Følgende krav må være innfridd for at fargeprosessen skal kunne gjennomføres:

- Alle innstillinger er optimert (parametere for ovn, osv.).
- Alle nødvendige programmer for fargeprosessen er opprettet ([→ S. 69 – 5.9.5 Opprette eller kopiere et nytt fargeprogram](#)).
- Reagensstasjonene er fylt med riktige reagenser ([→ S. 88 – 6.2.1 Klargjøring og håndtering av reagensbeholdere](#)).
- Skanning av påfyllingsnivå er utført ([→ S. 88 – 6.2 Daglig oppsett av instrumentet](#)).
- Stativene som er beregnet på farging, er riktig fylt, og riktige håndtak er festet til dem ([→ S. 98 – 6.5 Klargjøre stativet](#)).



#### Merk

Kontrollert avstenging av instrumentet startes hvis [driftsbryteren](#) ([→ "Fig. 13"](#)) blir aktivert mens fargeprosessen pågår ([→ S. 110 – 6.6.6 Fullføre den daglige driften](#)). Dette gjøres ved at brukeren trykker to ganger på [driftsbryteren](#) for å bekrefte avstengingen av instrumentet.

#### 6.6.1 Starte fargeprosessen



#### Advarsel

- Stikk ikke hånden inn i bevegelsesområdet til mateskuffen.
- Stativet kan bare settes inn med mateskuffen. Det er ikke tillatt å sette holderen direkte inn i en reagens- eller ovnsstasjon ved å åpne instrumentdekselet. Stativer som er satt inn på denne måten, registreres ikke av instrumentet og kan forårsake kollisjoner.
- Hvis dekselet åpnes mens et fargeprogram pågår, vil det føre til forsinkelser i behandlingen, siden prosessen stopper opp så lenge dekselet er åpent. Denne forsinkelsen kan forringe fargekvaliteten.
- Sørg for at dekselet er lukket så lenge fargeprogrammene pågår. Leica påtar seg intet ansvar for tap av kvalitet som skyldes at dekselet ble åpnet under fargeprosessen.
- Hvis stativer med hvite håndtak er satt inn i mateskuffen, og de er tilordnet et program, må de tilordnes på nytt når skuffen og/eller dekselet åpnes igjen. Vær derfor nøyne med å følge eventuelle informasjonsmeldinger som vises på skjermen.

Starte fargeprosessen

1. Bøy stativhåndtaket til stående stilling (→ "Fig. 81").
2. Hvis mateskuffen lyser grønt (→ "Fig. 82-1"), trykker du på den og åpner skuffen.
3. Sett stativet inn i en tilgjengelig posisjon i mateskuffen, som vist i (→ "Fig. 82-2").



Fig. 82

4. Sett inn stativet slik at både Leica-logoen på forsiden av stativet og ordet "Front" øverst på det fargede håndtaket peker mot brukeren. Pilen på toppen av det fargede håndtaket skal peke inn i instrumentet.
5. Trykk på knappen til mateskuffen igjen for å lukke den.
6. Brukeren får en informasjonsmelding hvis mateskuffen er åpen i mer enn 60 sekunder.

**Advarsel**

Vær forsiktig når du åpner og lukker skuffene. Klemfare! Skuffene er motoriserte og åpnes automatisk når du trykker på knappen. Pass på at ingenting blokkerer for skuffene.

7. Når mateskuffen er lukket, registrerer instrumentet RFID-brikkene i det fargede håndtaket.
8. Håndtaksfargen som registreres, vises i fargebadlayouten ved den aktuelle stasjonen sammen med forkortelsen for det tilordnede programmet (→ "Fig. 83").

## 6 Daglig oppsett av instrumentet

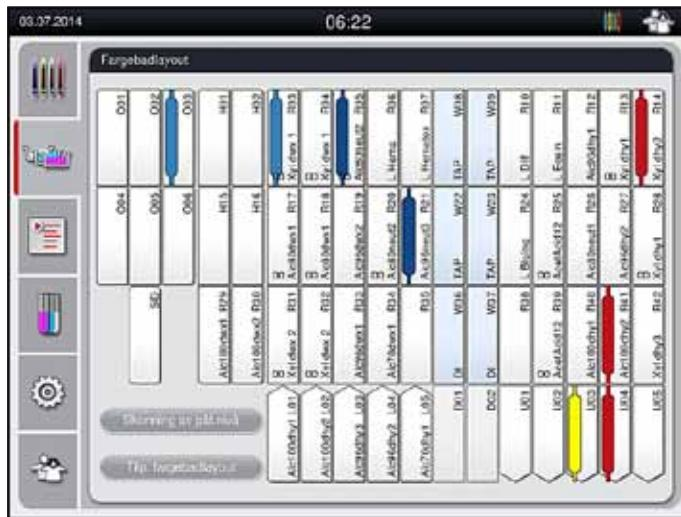


Fig. 83

### Merk

- Instrumentet registrerer det, og gir beskjed når et stativ er satt inn feil vei og må snus av brukeren.
- Hvis fargen på håndtaket til stativet som er satt inn i mateskuffen, ikke er tilordnet et program i fargebadlayouten (→ "Fig. 84"), påviser instrumentet dette og varsler brukeren via en informasjonsmelding. Stativet må fjernes fra instrumentet. Fest håndtaket med riktig farge til stativet, og sett det inn i mateskuffen igjen i samsvar med de oppstartbare programmene (→ S. 69 – Fig. 44).

SPECTRA ST LHE DWX DHY TS1

Fig. 84

### Merk

Instrumentet beregner gjennomstrømningsoptimerte starttider for stativene som er satt inn. Disse kan avvike fra rekkefølgen til de innsatte stativene.

- Før det første programtrinnet utføres, teller instrumentet objektglassene som er satt inn i stativet i lesestasjonen for objektglass (→ "Fig. 3-2").
- Det fastslåtte antallet objektglass registreres og behandles i RSS, og forbruksstatusen til de aktuelle reagensene oppdateres.
- Etterpå transporteres stativet til en ovnsstasjon eller reagensstasjon, avhengig av hvilket programtrinn som er definert som det første.

**Advarsel**

Hvis mateskuffen og instrumentets deksel var åpne samtidig før en fargeprosess ble startet (f.eks. for visuell inspeksjon av reagensene), viser instrumentet en informasjonsmelding etter 60 sekunder, som ber brukeren om å lukke mateskullen. Hvis stativet settes inn før mateskullen lukkes, må du kontrollere at dekselet er lukket og at programmene startes.

Hvis programmet ikke startes automatisk, må du åpne mateskullen og lukke den på nytt.

**6.6.2 Overvåking av fargeprosessen**

Ved hjelp av den følgende menyen kan brukeren hente frem eller overvåke detaljene for pågående programmer:

- Fargebadlayout med stasjonsdetaljer (→ "Fig. 83").
- Prosesstatusvisning med beregnet gjenstående programtider og trinntider (→ S. 35 – 5.3 Prosesstatusvisning).
- Statuslinjen (→ S. 34 – 5.2 Elementene i statusvisningen) med dato, klokkeslett og symboler som viser til meldinger og advarsler som er utløst.

**Merk**

Du kan hente frem de siste 20 aktive informasjonsmeldingene og advarslene ved å trykke på det tilsvarende symbolet på statuslinjen (→ "Fig. 16-2") (→ "Fig. 16-3"). Det gjør at brukeren kan holde seg oppdatert selv etter å ha vært borte fra instrumentet, og iverksette eventuelle nødvendige tiltak.

**6.6.3 Fargeprosess fullført**

- Når et stativ har kjørt gjennom hele fargeprosessen, transporteres det til utmatingsskullen (→ "Fig. 19-4") og plasseres i en ledig posisjon (→ "Fig. 85"). Brukeren hører en signallyd og får en informasjonsmelding som informerer om dette.

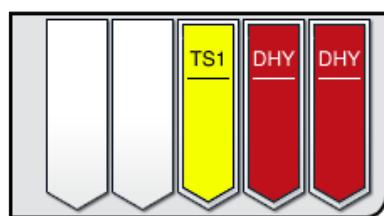


Fig. 85

- For å fjerne stativet fra utmatingsstasjonen trykker du på knappen på utmatingsskullen (→ "Fig. 19-4") for å åpne den, før du fjerner stativet.
- Trykk på knappen igjen for å lukke utmatingsskullen.

## 6 Daglig oppsett av instrumentet



### Advarsel

- Stikk ikke hånden inn i bevegelsesområdet til utmatingsskuffen.
- Utmatingsskuffen må åpnes, og stativene må tas ut senest når du ser varslemeldingen om at utmatingsstasjonen er helt full (→ "Fig. 86"). Hvis varslemeldingen ignoreres, kan ikke stativene transporteres videre til utmatingsstasjonene. Avvikende trinttider og forsinkelser i fargeprosessen kan endre og i verste fall gjøre fargeresultatene ubrukelige.

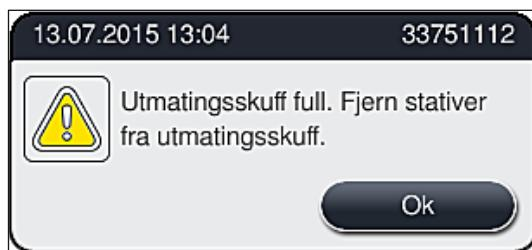


Fig. 86

- Brukeren får en informasjonsmelding (→ "Fig. 87") hvis utmatingsskuffen er åpen i mer enn 60 sekunder.

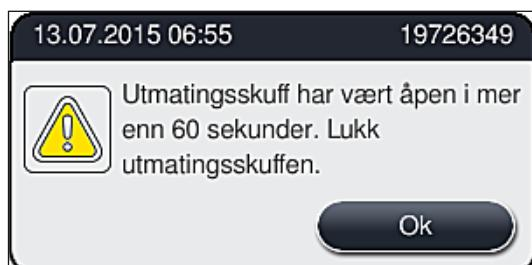


Fig. 87



### Merk

Varslemeldingen ber brukeren om å lukke utmatingsskuffen for å forhindre mulige forsinkelser. Når utmatingsskuffen er åpen, kan ikke instrumentet plassere de ferdigbehandlede stativene i utmatingsstasjonene. Avvikende trinttider og forsinkelser i fargeprosessen kan endre og i verste fall gjøre fargeresultatene ubrukelige.

- Trykk på knappen på utmatingsskuffen for å lukke den.

#### 6.6.4 Avbryte fargeprogrammet



##### Merk

- Fargeprogrammer kan bare avbrytes via prosesstatusvisningen.
- Du kan ikke avbryte et program som allerede er i lesestasjonen for objektglass (→ "Fig. 3-2").

- Hvis du vil avbryte et fargeprogram, velger du det tilsvarende stativet i prosesstatusvisningen (→ "Fig. 17-3") ved å trykke på det.
- En liste over programtrinn (→ "Fig. 88") vises. Det gjeldende trinnet er merket med rødt (→ "Fig. 88-1").



Fig. 88

- Vindusrammen viser fargen som er tilordnet programmet, programnavnet og den lagrede forkortelsen.
- Trykk på knappen **Avbryt program** (→ "Fig. 88-2").
- I den følgende informasjonsmeldingen (→ "Fig. 89") bekrefter du programavbrytelsen ved å trykke på **Ja**. Trykk på **Nei** hvis du vil gå tilbake til prosesstatusvisningen.



Fig. 89



##### Merk

Informasjonen i meldingen (→ "Fig. 89") skal følges.

## **6 Daglig oppsett av instrumentet**


6. Fargebadlayouten vises hvis du trykker på **Ja**-knappen. Posisjonen til stativet i instrumentet er merket med oransje (→ "Fig. 90-1").
  7. Åpne instrumentdekselet og fjern stativet fra den utevede stasjonen.



**Advarsel**

Hvis den markerte stasjonen er en ovnsstasjon, må du kanskje flytte den venstre transportarmen (→ "Fig. 3-1") til midten av instrumentet. Trekk deretter ovnsdekselet fremover og ta ut stativet.

- Bekreft fjerningen av stativet ved å trykke på den markerte stasjonen (→ "Fig. 90-1").

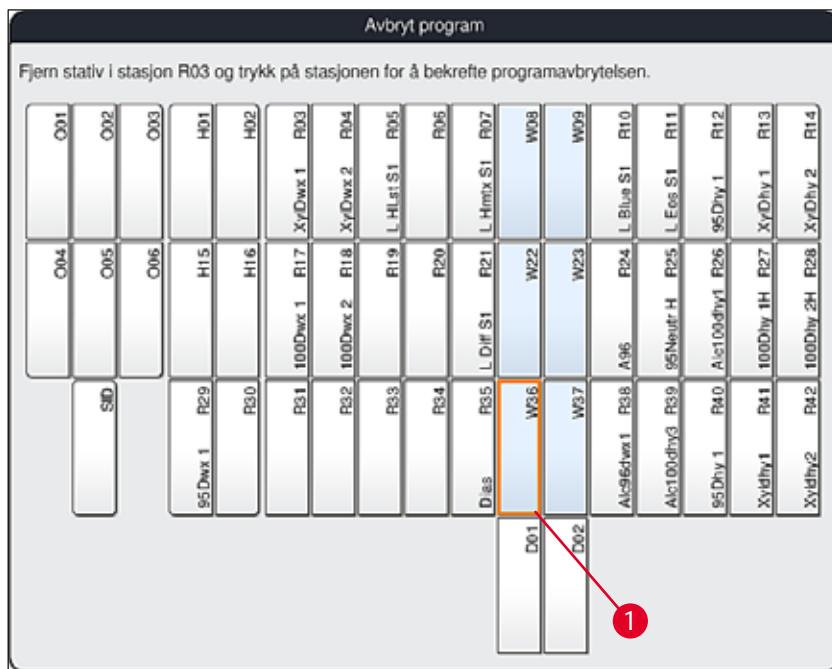

**Fig. 90**

- Lukk dekselet igjen.



## **Advarsel**

- Jobb raskt når du fjerner stativet, og påse at dekselet kun holdes åpent en kort stund. Av hensyn til sikkerheten stoppes alle bevegelser fra dekselet åpnes til det lukkes igjen. Hver gang dekselet åpnes under fargeprosessen, kan dette skape avvikende trinttider, forsinkelser og endringer i fargeresultatene.
  - Hold deg unna bevegelsesområdet til ovnslokket (ovnens svingområde) for å unngå personskader.



Merk

Gjenværende fargeprogrammer fortsetter etter at et program er avsluttet.

### 6.6.5 Drift som arbeidsstasjon

HistoCore SPECTRA ST kan brukes som en arbeidsstasjon sammen med den automatiske dekkglassmaskinen HistoCore SPECTRA CV. På denne måten er arbeidsflyten kontinuerlig helt fra fargeprosessen frem til de fullførte objektglassene med dekkglass fjernes.

En overføringsstasjon (tilleggsutstyr) er også tilgjengelig for denne løsningen  
(→ S. 141 – 9.1 Tilleggsutstyr til instrumentet).



#### Merk

- Monteringen av overføringsstasjonen (tilleggsutstyr) og tilkoblingen av HistoCore SPECTRA CV til HistoCore SPECTRA ST skal kun utføres av en Leica-sertifisert servicetekniker.
- Ethvert program må programmeres med en endelig målstasjon. I arbeidsstasjonsmodus skal overføringsstasjonen velges som siste trinn.



#### Advarsel

Brukeren må følge disse retningslinjene i arbeidsstasjonsmodus.

- Utmatingsstasjonene til HistoCore SPECTRA ST skal fylles med den samme reagensen (xylen) som matestasjonen (e) til HistoCore SPECTRA CV.
- Hver reagens som legges til, må være kompatibel med festemiddelet som benyttes.
- Det er absolutt nødvendig å fylle utmatingsstasjonene til HistoCore SPECTRA ST og matestasjonene til HistoCore SPECTRA CV med samme reagens. Stativene blir nemlig transportert til utmatingsstasjonen under fargeprosessen hvis HistoCore SPECTRA CV ikke er tilgjengelig. Denne situasjonen kan oppstå hvis reagensbeholderne til mateskuffen er fylt med stativer i HistoCore SPECTRA CV fordi brukeren ikke etterfylte forbruksartiklene i tide, eller hvis det oppsto en feil i instrumentet.
- Stativene for 5 objektglass kan ikke overføres til HistoCore SPECTRA CV. Disse stativene settes alltid inn i utmatingsskuffen på slutten av fargeprosessen, uavhengig av om overføringsstasjonen er spesifisert som siste stasjon i fargeprogrammet.
- Hvis det benyttes et hvitt stativhåndtak, må fargen til fargeprogrammet velges når stativet settes inn i mateskuffen. Etter dette åpnes et andre vindu hvor det må velges et parametersett for HistoCore SPECTRA CV. Fargen på parametersettet i HistoCore SPECTRA CV trenger ikke stemme overens med fargen til det valgte fargeprogrammet. Hvis HistoCore SPECTRA CV-parametersettet ikke er tilordnet, transporterer stativet til HistoCore SPECTRA ST-utmatingsskuffen etter farging. Brukeren vil se en merknad om dette.
- Hvis HistoCore SPECTRA CV ikke kan ta imot stativer fra HistoCore SPECTRA ST (f.eks. på grunn av en instrumentfeil i HistoCore SPECTRA CV, eller dersom mateskuffen til HistoCore SPECTRA CV er opptatt), transporterer de til HistoCore SPECTRA ST-utmatingsskuffen.
- Dersom det oppstår en instrumentfeil i overføringsstasjonområdet til HistoCore SPECTRA ST, overføres ikke stativene til HistoCore SPECTRA CV, men transporterer til HistoCore SPECTRA ST-utmatingsskuffen. Dersom det oppstår en vedvarende funksjonsfeil i overføringsstasjonen, må dette meldes til den ansvarlige Leica-serviceorganisasjonen.
- Driften som arbeidsstasjon er beskrevet nærmere i brukerhåndboken til HistoCore SPECTRA CV.

## 6 Daglig oppsett av instrumentet



### Advarsel

Hvis de spesifiserte stasjonene ikke fylles som anbefalt, kan prøvene skades på grunn av dårlig kvalitet på fargingen og dekkglassene. Hvis stasjonene ikke fyller, kan prøvene tørke og bli ødelagt.

#### 6.6.6 Fullføre den daglige driften

Når den daglige fargeoperasjonen er fullført, må instrumentet settes i ventemodus:

1. Kontroller om det fremdeles står stativer i disse stasjonene og fjern dem:
  - Mateskuff (→ "Fig. 64-9")
  - Utmatingskuff (→ "Fig. 64-6")
  - Ovn (→ "Fig. 64-1")
  - Tørroverføringsstasjon (→ "Fig. 64-7")
  - Reagensbeholderfelt (→ "Fig. 64-3"), (→ "Fig. 64-4"), (→ "Fig. 64-5") og (→ "Fig. 64-8")
2. Dekk så til alle reagensbeholdere med lokkene.
3. Trykk én gang på den grønne driftsbryteren (→ "Fig. 9-2").
4. Instrumentet ber brukeren om å bekrefte avstengningen av instrumentet ved å trykke på driftsbryteren én gang til.
5. Når driftsbryteren trykkes inn for andre gang, slås instrumentet av på en kontrollert måte.
6. Driftsbryteren blir nå rød, og instrumentet går over i ventemodus.
7. Slå til slutt av vanntilførselen.



### Advarsel

Hvis instrumentet skal rengjøres eller vedlikeholdes, må du slå av hovedbryteren (→ "Fig. 9-1") til instrumentet også.

## 7. Rengjøring og vedlikehold

### 7.1 Viktige merknader om rengjøring av instrumentet



#### Advarsel

Generelle instruksjoner:

- Før rengjøring må instrumentet slås av ved å trykke på driftsbryteren (→ "Fig. 9-2"), og deretter slås av med hovedbryteren (→ "Fig. 9-1").
- Bruk egnede beskyttelsesklær (laboratoriefrakk og hansker) som beskytter mot reagenser og potensielt smittefarlige mikrobiologiske stoffer ved rengjøring av instrumentet.
- Væske skal ikke komme i kontakt med elektriske koblinger, eller trenge seg inn i instrumentet eller kabinettet under transportarmene.
- Når du bruker rengjøringsmidler, må du være oppmerksom på produsentens sikkerhetsinstruksjoner og laboratoriebestemmelserne som gjelder i brukerlandet.
- Brukte reagenser kastes i henhold til retningslinjene for laboratorier i brukerlandet.

Følgende gjelder alle instrumentflater:

- Tørk umiddelbart opp løsemidler (reagenser) som er sølt. Overflaten til dekselet er bare betinget bestandig mot løsemidler ved langvarig eksponering.
- Ikke bruk noen av følgende midler til rengjøring av utsiden på instrumentet: alkohol, vaskemidler som inneholder alkohol (f.eks. glasspussemidler), slipende vaskemidler, løsemidler som inneholder aceton eller xylen.

### 7.2 Eksterne flater, lakkerte flater, instrumentdeksel

Flatene kan rengjøres med et mildt, pH-nøytralt, alminnelig tilgjengelig rengjøringsmiddel. Tørk av flatene med en klut fuktet med vann etter rengjøring.



#### Advarsel

Lakkerte flater og plastflater (f.eks. dekselet) skal ikke rengjøres med løsemidler som aceton, xylen, toluen, xylenerstatninger, alkohol, alkoholblandinger eller slipende midler. Instrumentets flater og deksel er bare betinget bestandig mot løsemidler.

### 7.3 TFT-berøringsskjerm

Rengjør skjermen med en lofrei klut. Et egnet skjermrengjøringsmiddel kan brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.

### 7.4 Innside og dreneringspanne

- Reagensbeholderne og skyllevannsbeholderne må fjernes før innsiden og dreneringspannen rengjøres.

Bruk et mildt, pH-nøytralt, alminnelig tilgjengelig rengjøringsmiddel.

- Skyll godt med vann etter rengjøring av dreneringspannen.

### 7.5 Transportarmer

Rengjør transportarmene ([→ "Fig. 91-1"](#)) ved å tørke av flatene med en klut fuktet med vann eller et mildt, pH-nøytralt rengjøringsmiddel.



#### Advarsel

Påse at det ikke har lekket væske under kabinetten ([→ "Fig. 91-2"](#)) til transportarmene. Det inneholder flere sensitive deler.

### 7.6 Lesestasjon for objektglass

Se etter smuss og reagensrester i fordypningen i lesestasjonen. Bruker du objektglass som allerede har skadde kanter, kan små glassbiter og splinter samles her ([→ "Fig. 91-3"](#)). Alt smuss i dette området må derfor fjernes varsomt for å unngå personskader.



#### Advarsel

Bruk egnede beskyttelsesklær (laboratoriefrakk og hanske) for å hindre kuttskader.

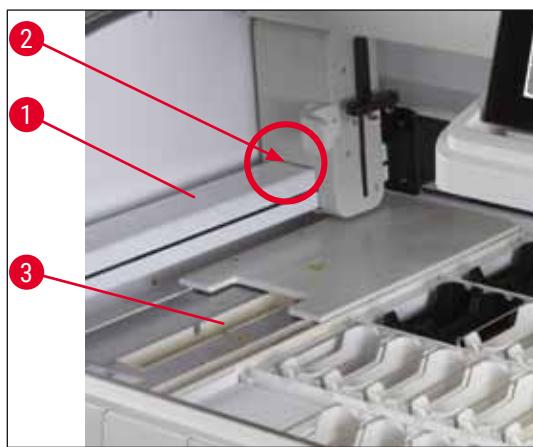


Fig. 91

## 7.7 Mate- og utmatningsskuffer

- Fjern reagensbeholderne fra begge skuffene, og oppbevar dem utenfor instrumentet.
- Se etter og fjern eventuelle reagensrester i skuffene.
- Sett deretter reagensbeholderne tilbake på plass.
- Følg merkingen (→ "Fig. 92-1") for stasjonene i skuffene.

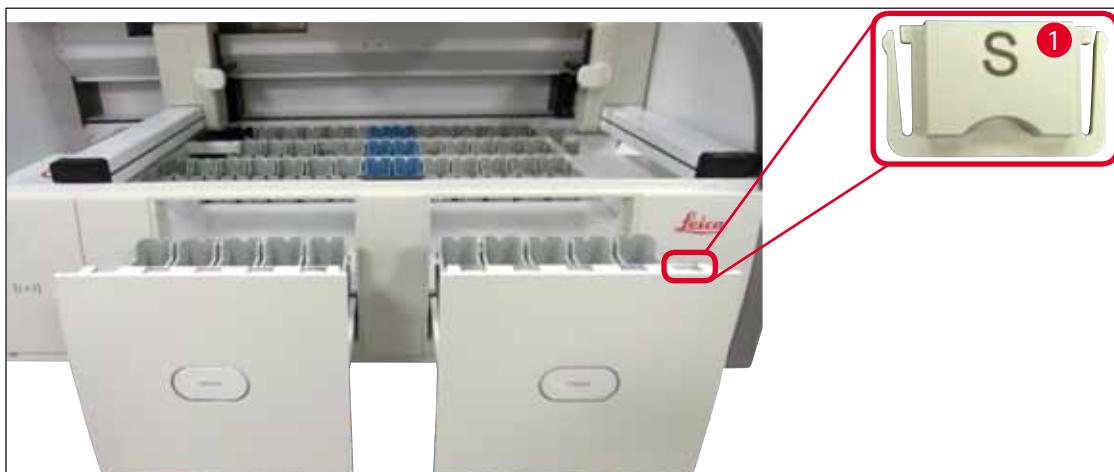


Fig. 92



### Merk

Bruk merkene i (→ S. 18 – 3.1 Standard levering) til å merke reagensbeholderne i mate- og utmatningsskuffen. De trykte bokstavene har følgende betydning:

- H<sub>2</sub>O = vann eller destillert vann
- A= alkohol
- S= løsemiddel, f.eks. xylen

## 7.8 Tørroverføringsstasjon

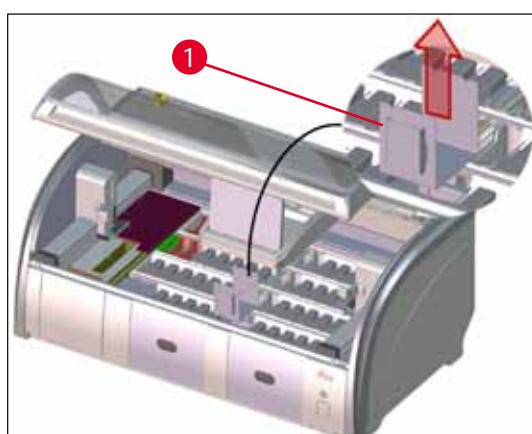


Fig. 93

Etter overføring til tørroverføringsstasjonen, kan det dryppre reagens. Disse restene må fjernes med jevne mellomrom.

- Det gjøres ved å fjerne innsatsen (→ "Fig. 93-1") i tørroverføringsstasjonen ved å trekke den opp. Se etter kontaminering og rengjør om nødvendig.
- Sett innsatsen tilbake, og påse at den smetter helt tilbake på plass.

### 7.9 Overføringsstasjon (tilleggsutstyr)

- Se etter og fjern eventuelle reagensrester i overføringsstasjonen (→ "Fig. 94") regelmessig.  
Bruk et mildt rengjøringsmiddel med nøytral pH-verdi.

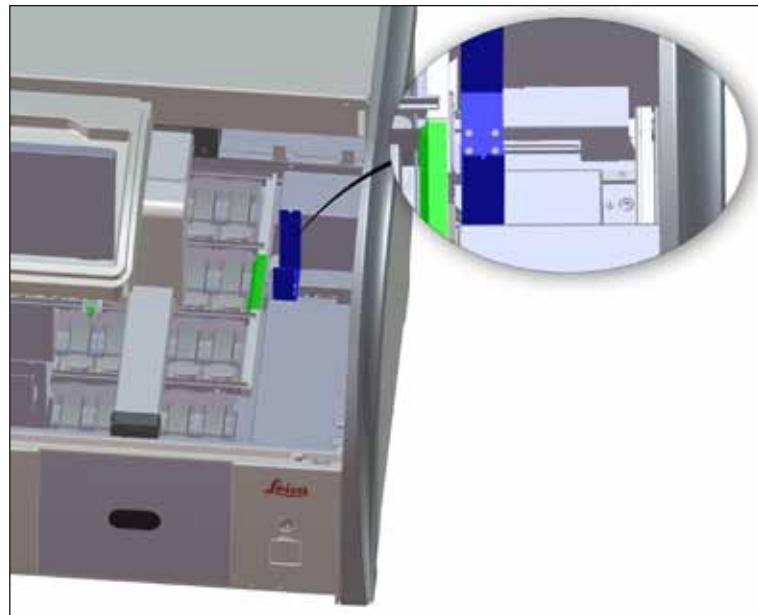


Fig. 94

### 7.10 Reagensbeholderes og skyllevannbeholderes

- Fjern beholderne fra håndtaket én og én. Forviss deg om at håndtaket er i riktig posisjon (→ S. 88 – 6.2.1 Klargjøring og håndtering av reagensbeholderes) slik at du ikke sører reagens.
- Tetningsringen (→ "Fig. 95-1") skal fremdeles være festet til skyllevannbeholderen.
- Brukte reagenser deponeres i henhold til lokale retningslinjene for laboratorier.
- Reagens- og skyllevannbeholderne kan vaskes i oppvaskmaskin på maks. 65 °C og med et alminnelig tilgjengelig vaskemiddel for lab-oppvaskmaskiner. Håndtakene kan sitte på beholderne under denne prosessen.



#### Advarsel

- Tilbehør med belegg (innsatser for spesialfarger og håndtak for stativ for 5 objektglass) skal ikke vaskes i oppvaskmaskin. Dette kan skade belegget. Pass på at belegget ikke skades når tilbehøret vaskes for hånd. Hvis det belagte tilbehøret skades, kan det oppstå kjemiske reaksjoner med reagensene for spesielle bruksområder (→ S. 152 – A1. Vedlegg 1 – Kompatible reagenser).
- Fargereagensbeholderne må vaskes for hånd før de vaskes i oppvaskmaskin. Fjern så mye av fargemiddelet som mulig, slik at du unngår misfarging av de andre reagensbeholderne i oppvaskmaskinen.
- Vask aldri reagensbeholder av plast ved temperaturer høyere enn 65 °C, siden det kan føre til at reagensbeholderen deformeres.

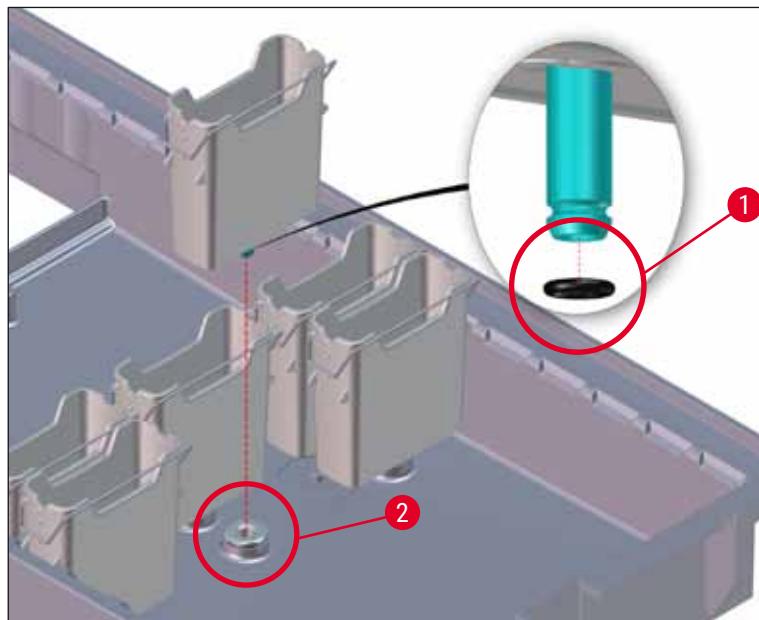


Fig. 95

**Merk**

- Skyllevannsbeholderne må sjekkes regelmessig for forkalkning, synlige, mikrobiologiske bakterierester, sopp, alger og permeabilitet. Kalkrester kan fjernes med en mild, eddikbasert vaskeløsning. Skyll til slutt beholderne med rent vann til alle rester av rengjøringsmiddelet er fjernet.
- Etter at skyllevannsbeholderne er rengjort og før de settes tilbake i instrumentet, må det kontrolleres om overgangsstykket til vannforsyningssystemet er i riktig posisjon på den svarte o-ringen (→ "Fig. 95-1").
- Hvis o-ringer står igjen i instrumentet når skyllevannsbeholderne tas ut (→ "Fig. 95-2"), må de fjernes forsiktig med en tang og settes tilbake på riktig tilkoblingsport.
- Hvis en o-ring mangler eller monteres feil, skal skyllevannsbeholderen ikke settes tilbake etter rengjøring. Ellers er det fare for at primingfunksjonen under fargeprosessen ikke fungerer.
- Når o-ringene er festet eller korrigert, må den smøres med Molykote 111-fett, som er inkludert i (→ S. 18 – 3.1 Standard levering).
- Skyllevannsbeholderne kan deretter settes tilbake på plass.

**Advarsel**

Hvis de rengjorte og fylte reagensbeholderne skal settes tilbake i instrumentet, må de settes i riktig posisjon i samsvar med fargebadlayouten (→ S. 76 – 5.9.9 Utføre fargebadlayout). Det gjør du ved å slå på og initialisere instrumentet.

### 7.11 Stativ og håndtak

- Stativet må kontrolleres jevnlig for fargerester og annen kontaminasjon.
- Det avkjølte håndtaket må fjernes fra stativet for å rengjøres.
- Fjern fargerester fra stativene ved å legge dem i et bad med lunkent vann og et mildt, pH-nøytralt laboratorierengjøringsmiddel. La rengjøringsmiddelet få virke en stund. Vær nøyne med å følge alle anbefalinger fra produsenten angående bruk av rengjøringsmidler og bruksområder.
- Kraftig farging kan fjernes med en børste.
- Prime stativene grundig med rent vann til alle rester av farge eller rengjøringsmiddel er fjernet.
- Hvis det er rester av festemiddel på stativene, kan de legges i et løsemiddelbad.



#### Advarsel

Stativene og håndtakene må ikke ligge lenge i løsemiddel (f.eks. i flere timer eller over natten). Dette kan føre til deformasjon.

Det er viktig å sikre at løsemiddelet som brukes, er kompatibelt med festemiddelet. Xylen- eller toluenbaserte festemidler kan fjernes i et xylenbad. Xylensubstituttbaserte festemidler kan fjernes i et bad som inneholder et tilsvarende xylensubstitutt.



#### Merk

Maksimal eksponeringstid i løsemiddelbad er 1–2 timer. Løsemiddelet kan vaskes av med alkohol. Prime stativene godt med vann og tørk dem. Hvis en ekstern ovn brukes for tørking, skal temperaturen ikke overskride 70 °C.

### 7.12 Avløpssystem



#### Advarsel

Instrumentets avløpssystem må rengjøres og kontrolleres regelmessig for å sikre godt avløp. Hvis denne prosedyren ikke fullføres, kan avløpssystemet gå tett, noe som kan føre til avbrudd eller funksjonseffekt i fargeprosessen.

- Før rengjøring av avløpssystemet må du fjerne de fire skyllevannsbeholderne (→ "Fig. 64-4") bak og alle reagensbeholderne rundt dem.
- Resten av reagensbeholderne må dekkes til med lokk.
- Fjern avløpsfilteret og rengjør om nødvendig (→ "Fig. 96-1").
- Legg én eller to rengjøringstabletter med aktivt oksygen (f.eks. til tannproteser) i avløpet, og løs dem opp i vann for å fjerne diverse rester (reagenser, bakterier, sopp, alger).
- Rengjør deretter hele det buede avløpet inne i instrumentet med en lang, fleksibel børste (→ "Fig. 96-2").
- Skyll med store mengder vann for å teste avløpsstrømningen.
- Sett tilbake avløpsfilteret, og sett beholderne tilbake i sine opprinnelige, definerte posisjoner.

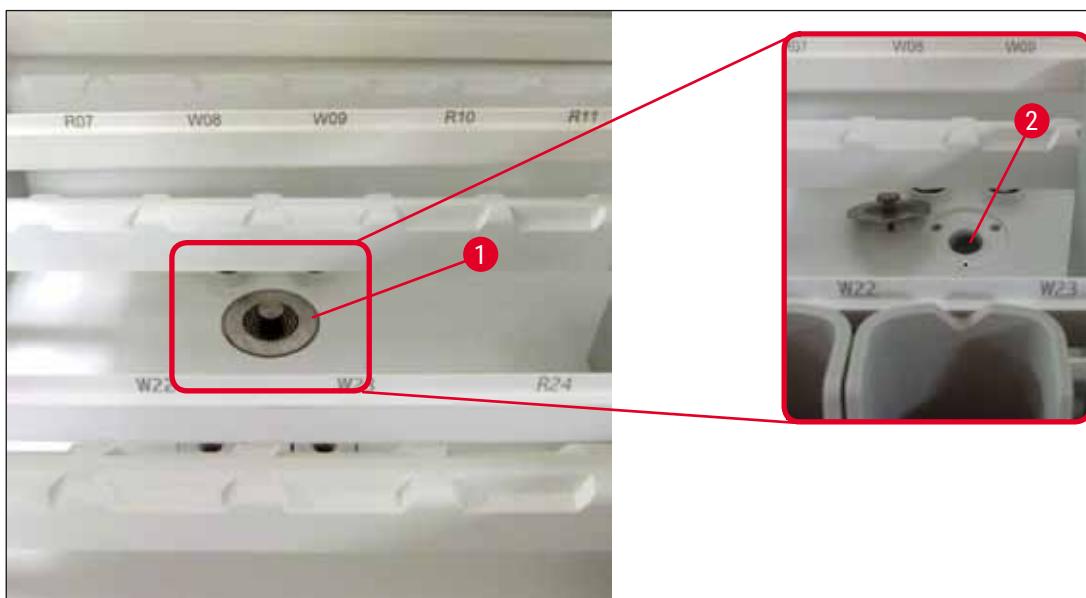


Fig. 96

### 7.13 Avløpsslange

Avløpsslangen må kontrolleres én gang i året av en Leica-autorisert servicetekniker.

### 7.14 Skifte filterinnsatsen til vanninnløpsfilteret



#### Advarsel

Huset til vanninnløpsfilteret tåler ikke løsemidler og kan derfor bli skjørt og ødelegges. Ikke bruk alkohol eller rengjøringsmidler som inneholder alkohol til rengjøring av vannfilterhuset (→ "Fig. 97-2"). Konsekvensen kan være at det lekker vann på en ukontrollert måte, noe som kan skade laboratoriet eller laboratoriemiljøet.

Vanninnløpsfilteret og filterinnsatsen må kontrolleres og byttes én gang i året av en Leica-autorisert servicetekniker.

Det integrerte innløpsfilteret (→ "Fig. 97-1") beskytter instrumentets interne vannkretsløpskomponenter mot skade fra avsetninger og mineralbelegg.

Vannfilterets holdbarhet avhenger av vannkvaliteten på installasjonsstedet. Maksimal levetid for vannfilteret er 1 år.

Vanninnløpsfilteret må derfor kontrolleres regelmessig ved å se etter synlig smuss gjennom filterhuset.

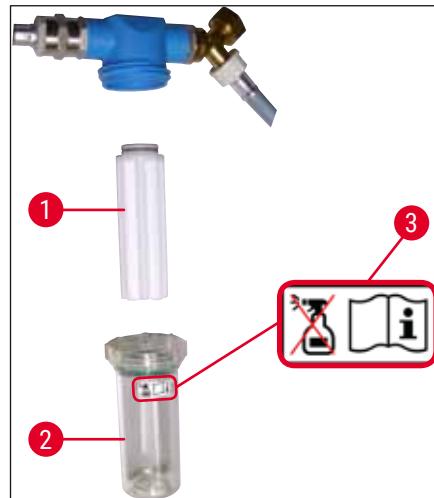


Fig. 97

- 1 Filterhus
- 2 Filterinnsats, bestillingsnr. 14 0512 49332
- 3 Advarselsetikett: Ikke bruk noen form for alkohol til rengjøring, og følg bruksanvisningen.

**Merk**

Hvis betydelige mengder smuss er synlig i vannfilteret før neste planlagte vedlikehold (1 år), må det byttes av en Leica-servicetekniker.

### 7.15 Bytte det aktive kullfilteret

Det aktive kullfilteret (→ "Fig. 1-1") som er installert i instrumentet, bidrar til å redusere reagensdampen i avtrekksluften. Filterets levetid varierer sterkt avhengig av hvor intensivt filteret brukes og instrumentets reagenskonfigurasjon. Bytt derfor det aktive kullfilteret jevnlig (hver 2.–3. måned), og kast det i samsvar med gjeldende laboratoriebestemmelser i brukerlandet.

- Filterenheten består av to separate filterinnsatser (→ "Fig. 98-1"), som brukeren har tilgang til foran på instrumentet.
- Du trenger ikke verktøy for å få tilgang til innsatsene. De kan trekkes ut ved hjelp av håndtakene (→ "Fig. 98-2").
- Sett inn de nye filterinnsatsene slik at du får tak i håndtakene når de er satt helt inn. Artikkelenummeret (→ "Fig. 98-3") som er trykt på dem, skal være synlig.
- Noter installasjonsdatoen for filterinnsatsen på den hvite etiketten, og lim den på venstre eller høyre side av det aktive kullfilteret (→ "Fig. 98-4").
- Begge de aktive kullfiltrene må skyves inn helt til du kjenner at de treffer bakpanelet på instrumentet.



Fig. 98

**Advarsel**

Hvis de aktive kullfiltrene er satt inn feil, kan de komme i veien for de to transportarmene og forhindre eller forstyrre fargeprosessen.

## 7.16 Rengjøre ovnene

**Advarsel**

- Forsiktig, varm overflate! Hvis ovnen har vært brukt i fargeprosessen, slår du av instrumentet og venter i minst 10 minutter til det kjøles ned. Hold ovnsinnsatsene kun i de beskrevne posisjonene.
- Det må ikke brukes løsemidler til rengjøring av innsiden av ovnen, da løsemiddelrester kan komme inn i ovnen og fordampe i ovnen når prosessen settes i gang.

Se jevnlig etter smuss på blikkplatene som samler opp parafinrester i ovnen.

- Trekk det bevegelige ovnsdekselet (→ "Fig. 99-1") mot fronten av instrumentet for hånd. Ovnsdekselet må ikke løftes opp til siden.
- Flytt eventuelt den venstre transportarmen til siden, slik at ovnsinnsatsen blir lettere tilgjengelig.
- Ta tak i sidene til den fremre ovnsinnsatsen (→ "Fig. 99-2"). Løft innsatsen opp og ut av instrumentet. Fjern deretter den bakre ovnsinnsatsen (→ "Fig. 100-2").

- Koble de to ovnskamrene fra hverandre ved å trekke dem i motsatt retning.
- Du kan nå trekke ut platen som samler opp parafinrester fra ovnsinnsatsene (→ "Fig. 100-3") og (→ "Fig. 100-4").
- Se etter parafinrester og smuss på blikkplatene, og rengjør dem. Plasser platene i en ekstern laboratorieovn for å smelte bort eventuelle parafinrester.
- Når platene er varme, tørkes parafinrestene bort med en lofri klut.
- Kontroller at ventilasjonspjeldene i ovnskamrene fungerer som de skal. Hvis de er synlig skitne, må de rengjøres med en lofri klut.
- Skyv blikkplatene tilbake inn i ovnsinnsatsene i riktig retning (den perforerte siden skal vende opp).
- Etter rengjøring settes først den bakre ovnsinnsatsen (→ "Fig. 100-2") tilbake i instrumentet i korrekt posisjon. Sett deretter på plass den fremre ovnsinnsatsen (→ "Fig. 99-2"). Se riktig plassering av de tilkoblede ovnsinnsatsene.

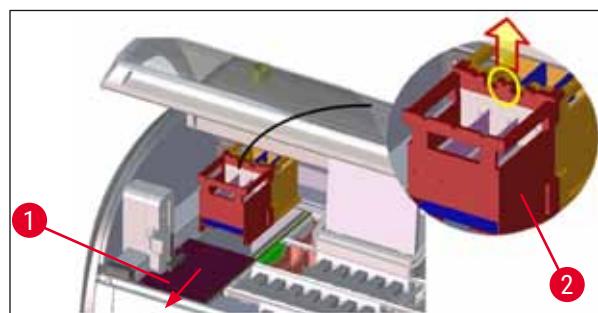


Fig. 99

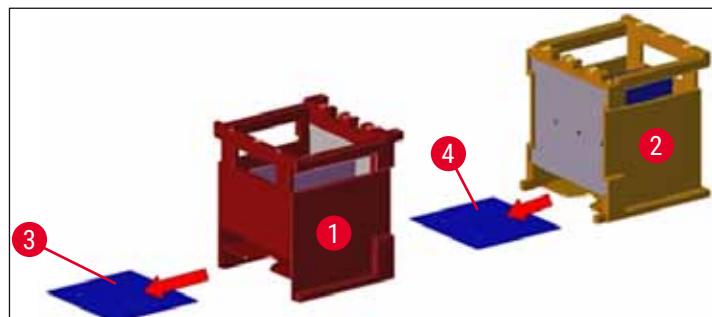


Fig. 100

## 7.17 Ovnens luftfilter

Luftfilteret i ovnen må kontrolleres, rengjøres og byttes med jevne mellomrom.

- Fjern filterinnsatsen (→ "Fig. 101-1") og rist den, eller bytt den med en ny filterinnsats (→ S. 141 – 9.2 Tilleggsutstyr).
- Sett filteret inn i ovnen på samme måte etterpå.

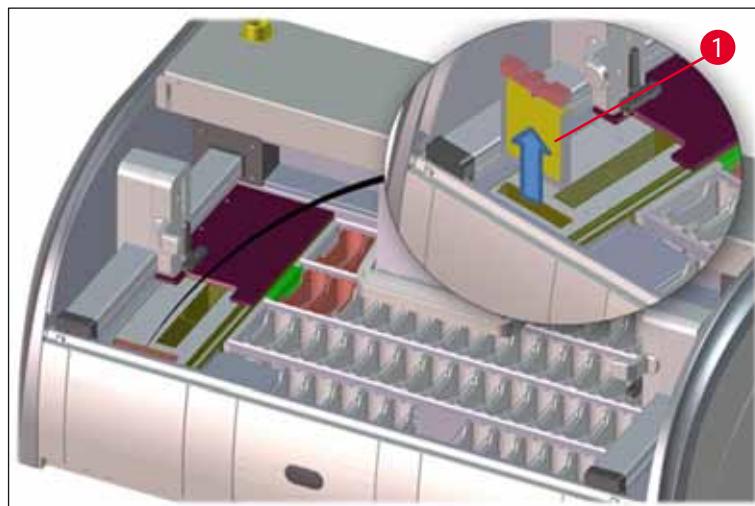


Fig. 101



### Merk

Installeringen gjøres i motsatt rekkefølge.

## 7.18 Intervaller for rengjøring og vedlikehold



### Advarsel

- Vedlikeholds- og rengjøringsoppgavene som står oppgitt nedenfor, må utføres.
- Instrumentet må kontrolleres av en Leica-autorisert, kvalifisert servicetekniker én gang i året for å sikre kontinuerlig funksjon.

Hvis du vil sikre en problemfri og langvarig drift av instrumentet, anbefales følgende tiltak på det sterkeste:

- Inngå en servicekontrakt når garantiperioden er over. Kontakt det aktuelle tekniske servicesenteret hvis du ønsker mer informasjon.

### 7.18.1 Daglig rengjøring og vedlikehold



#### Advarsel

Hvis sensitive instrumentdeler og -områder blir svært skitne, eller det såles reagens, må de rengjøres umiddelbart for å sikre videre drift.

- 1 Kontrollere og fylle/etterfylle reagensbeholderne. ([→ S. 88 – 6.2.1 Klargjøring og håndtering av reagensbeholderne](#))
- 2 Dekke til reagensbeholderne og eventuelt oppbevare dem tildekket i kjøleskap.
- 3 Se etter parafin- og fargerester samt knust glass i stativet og håndtakene. ([→ S. 116 – 7.11 Stativ og håndtak](#))
- 4 Se etter og fjern eventuelle reagensrester i lesestasjonen for objektglass. ([→ S. 112 – 7.6 Lesestasjon for objektglass](#))
- 5 Se etter løsemiddelrester, og rengjør flatene rundt mate- og utmatingsskuffene ved behov. ([→ S. 113 – 7.7 Mate- og utmatingsskuffer](#))
- 6 Rengjør innsatsene i tørroverføringsstasjonen. ([→ S. 113 – 7.8 Tørroverføringsstasjon](#))
- 8 Se etter og fjern eventuelle reagensrester i overføringsstasjonen (tilleggsutstyr). ([→ S. 114 – 7.9 Overføringsstasjon \(tilleggsutstyr\)](#))

### 7.18.2 Rengjøring og vedlikehold etter behov

- 1 Rengjør skjermen med en lofrei klut. Et egnet skjermrengjøringsmiddel kan brukes i samsvar med produsentens anbefalinger. ([→ S. 111 – 7.3 TFT-berøringsskjerm](#))
- 2 Rengjør utvendige/malte flater. ([→ S. 111 – 7.2 Eksterne flater, lakkerte flater, instrumentdeksel](#))
- 3 Rengjør dekselet til instrumentet. ([→ S. 111 – 7.2 Eksterne flater, lakkerte flater, instrumentdeksel](#))

**7.18.3 Ukentlig rengjøring og vedlikehold**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Kontroller/rengjør skyllevannsbeholderne for bakteriell kontaminering og kontroller at tetningsringene er på plass. | (→ S. 114 – 7.10 Reagensbeholdere og skyllevannbeholdere) |
| 2 | Rengjør reagensbeholderne.  | (→ S. 114 – 7.10 Reagensbeholdere og skyllevannbeholdere) |
| 4 | Rengjør stativene og håndtakene.  | (→ S. 116 – 7.11 Stativ og håndtak)                       |
| 5 | Kontrollere avløpet og avløpsfilteret i instrumentet, og rengjøre etter behov.                                      | (→ S. 116 – 7.12 Avløpssystem)                            |
| 6 | Se etter smuss i transportarmene og rengjør dem om nødvendig.   | (→ S. 112 – 7.5 Transportarmer)                           |

**7.18.4 Månedlig vedlikehold og rengjøring**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Kontrollere vanninnløpsfilteret (se gjennom filterhuset).                                       | (→ S. 117 – 7.14 Skifte filterinnsatsen til vanninnløpsfilteret)    |
| 2 | Kontroller, rengjør eller eventuelt bytt luftfilteret i ovnen.                                  | (→ S. 141 – 9.2 Tilleggsutstyr) (→ S. 121 – 7.17 Ovnens luftfilter) |
| 3 | Rengjøre dryppbakken.   | (→ S. 112 – 7.4 Innside og dreneringspanne)                         |
| 4 | Se etter parafinrester i tørkeovnsinnsatsen og oppsamlingsbrettet, og fjerne eventuelle rester. | (→ S. 119 – 7.16 Rengjøre ovnene)                                   |

**7.18.5 Rengjøring og vedlikehold hver tredje måned**

- |   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Bytte det aktive kullfilteret. | (→ S. 118 – 7.15 Bytte det aktive kullfilteret) |
|---|--------------------------------|---|

**7.18.6 Årlig vedlikehold og rengjøring**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Instrumentet må kontrolleres og vedlikeholdes én gang i året av en Leica-autorisert servicetekniker. |
|---|--|

## 8. Feil og feilsøking

### 8.1 Mulige løsninger på maskinfeil

Feil/problem	Årsak	Feilsøking
Stigende vannivå i dreneringspannen og alarm.	Avløpet er helt eller delvis tett.	Kontroller og vedlikehold vannavløpslangen (→ "Fig. 7-1"). Ta kontakt med det ansvarlige Leica-servicesenteret.
	Avløpssystemet inni instrumentet og/eller avløpsfilteret er helt eller delvis tett.	Kontroller og vedlikehold avløpslangen i instrumentet. Følg rengjøringsinstruksjonene i (→ S. 121 – 7.18 Intervaller for rengjøring og vedlikehold).
Redusert priming i fargesyklusen og muligvis ujevne fargeresultater.	Vanninnløpet til skyllevannsbeholderne redusert/tett.  Mulige årsaker: <ul style="list-style-type: none"><li>• Skyllevannsbeholderne er feil installert (kontroller o-ringen).</li><li>• Forkalkning i skyllevannsbeholderne.</li></ul>	Hvis blokkeringen ikke fjernes, stoppes vanntilførselen til skyllevannsbeholderne, og fargeprosessen avbrytes. Prøvene må derfor fjernes fra instrumentet og settes i trygge posisjoner eller til midlertidig oppbevaring (→ S. 126 – 8.2 Strømbrudd og maskinfeil). Hold øye med og vedlikehold skyllevannsbeholderne. Følg rengjøringsinstruksjonene (→ S. 114 – 7.10 Reagensbeholdere og skyllevannsbeholdere).
Skyllevannsbeholderne tappes ikke automatisk ved driftspauser i instrumentet. Stillestående vann er en kilde til mikrobiologisk kontaminering i skyllevæskebeholderne og prøvene.	Tilleggstappehullet i bunnen av skyllevæskebeholderen er tettet av kalk/smuss.	Oppretthold intervallene for regelmessig vedlikehold. Hold øye med og vedlikehold skyllevannsbeholderne. Følg rengjøringsinstruksjonene (→ S. 114 – 7.10 Reagensbeholdere og skyllevannsbeholdere). Oppretthold intervallene for regelmessig vedlikehold.

Feil/problem	Årsak	Feilsøking
Utilstrekkelig skylling i fargesyklusen kan gi ujevne fargeresultater.	Vanntrykket er for lavt i innløpssystemet til laboratoriet, eller varierer i løpet av dagen.	De spesifiserte minimumskravene for vanntrykk ( <a href="#">→ S. 19 – 3.2 Spesifikasjoner</a> ) må være innfridd (og ta høyde for mulige avvik i løpet av dagen).
Reagensbeholderne er deformert.	Bruk av reagenser som ikke er tillatt (f.eks. fenol i Ziehl-Neelson-farge eller Gram-farge osv.). Rengjøringsprosedyren er feil utført.	Kontroller reagensene som brukes mot listen over tillatte reagenser ( <a href="#">→ S. 152 – A1. Vedlegg 1 – Kompatible reagenser</a> ). Følg rengjøringsinstruksjonene ( <a href="#">→ S. 114 – 7.10 Reagensbeholdere og skyllevannbeholdere</a> ).
Ujevne fargeresultater	Tillatt avvik for programtrinnet for fargereagenser er feil definert.	Kontroller fargeprogrammene og reagensene. De fleste korte programtrinn krever at fargetrinnet følges nøyaktig. Tillatt avvik for reagensen må være 0 %.
Varierende fargeresultater	Behandlingsklassene (parafinfjerning, farging osv.) for reagensene ble tilordnet feil. Det betyr at den utførte fargebadlayouten kanskje ikke var optimal. Reagenser som kun skal brukes av ett program, brukes av andre programmer. Reagensen ble skitten fordi den ikke var programmert som "Utelukkende".	Inspeksjon og korrigering av de tilordnede reagensklassene ( <a href="#">→ S. 58 – Opprette en ny reagens, eller kopiere en reagens</a> ). Kontroller og korrigér programmeringen av de forskjellige reagensene.
Utilstrekkelig fargekvalitet	Vannkvaliteten oppfyller ikke kravene til Type 1, ISO 3696	Test vannkvaliteten i samsvar med ISO 3696, og juster den etter behov.
Vevet er ikke godt nok festet til objektglasset etter tørking, og flyter bort under fargeprosessen.	I kundedefinerte programmer er den valgte oppvarmingstiden og ovnstemperaturen (eller begge deler) for lav.	Inspiser og korrigér informasjonen om oppvarmingstid og ovnstemperaturer for kundedefinerte programmer.

Feil/problem	Årsak	Feilsøking
Fargeprosessen er fullført, men gjentatt eller ytterligere programmering (administratormodus) er ikke mulig.	Programmeringen kan bare foretas når instrumentet står i hvilemodus. Med andre ord kan ingen stativer være under behandling. Dette gjelder også posisjonene til utmatingskuffen.	Ta stativene ut fra utmatingskuffen, og fortsett programmeringen.
Kan ikke fullføre initialisering av instrumentet.	Armene er blokkert.	Kontroller at det aktive kullfilteret står i riktig posisjon.
Automatisk skanning av påfyllingsnivå viser feil resultater.	Klemmen på den innsatte reagensbeholderen stikker ut over reagensbeholderen og feiltolkes ved skanning av påfyllingsnivå.	Kontroller at klemmen på reagensbeholderen er riktig plassert, og korriger den om nødvendig.
Automatisk skanning av påfyllingsnivå viser feil resultater for matestuffstasjonene og/eller tørroverføringsstasjonen. Individuelle stasjoner rapporteres som "manglerende".	Rester i bunnen av den tomme reagensbeholderen og/eller tørroverføringsstasjonen påvirker målemetodene som brukes ved automatisk skanning av påfyllingsnivå.	Rengjør reagensbeholderne og/eller tørroverføringsstasjonen, og fjern eventuell forkalkning. Gjenta deretter skanning av påfyllingsnivå ( <a href="#">→ S. 90 – 6.2.2 Automatisk skanning av påfyllingsnivå</a> ).

## 8.2 Strømbrudd og maskinfeil



### Merk

- HistoCore SPECTRA ST har en intern UPS (avbruddsfri strømforsyning) i tilfelle det oppstår korte strømbrudd. Brukeren varsles om korte strømbrudd via en informasjonsmelding på skjermen. Informasjonsmeldingen forsvinner så snart strømmen er tilbake. Hendelsen lagres i hendelsesloggen.
- Langvarige strømbrudd kan bare omgås med en ekstern UPS ([→ S. 29 – 4.3.1 Bruk av avbruddsfri strømforsyning \(UPS\)](#)).

Instrumentet slås av hvis det oppstår lengre strømbrudd (varighet > 3 sekunder). Hendelsen lagres i hendelsesloggen.

Den interne UPS-en sørger for at stativer som kan overføres, plasseres i en sikker posisjon over to reagensstasjoner ([→ "Fig. 102"](#)) slik at de ikke senkes i en ikke-kompatibel reagens ved en feiltagelse.

**Advarsel**

Reagensforskyvning kan oppstå på grunn av fastklistrede reagenser når stativet settes til side. Kontroller om det er rester i de aktuelle reagensbeholderne før du starter en fargeprosess, og skift dem ved behov (→ S. 97 – Reagensutskiftning).



Fig. 102

Instrumentet starter igjen så snart strømmen er tilbake.

Under initialisering sender programvaren i instrumentet ut en rekke meldinger og instruksjoner til brukeren, slik at han/hun får informasjon om strømbruddet og hva som må gjøres.

Brukeren kan avbryte eller gjenoppta fargeprosessprogrammet ved hjelp av veiledningen som vises.

**Advarsel**

Stativer i kritiske posisjoner skal fjernes fra instrumentet umiddelbart av brukeren.

Reagensstasjoner som defineres som "kritiske" posisjoner, er stasjonene med svært lange hviletider som kan føre til forringet fargekvalitet eller ødelagte prøver.

### Kritiske posisjoner:

- » Stasjoner med skyllevann (→ "Fig. 103-1") og avionisert vann (→ "Fig. 103-2")
  - ⓘ Beholderne kan bli tømt og prøvene kan tørke ut hvis vann tømmes automatisk og kontinuerlig i bunnen av beholderen. Prøvene må fjernes fra instrumentet og oppbevares på et trygt sted utenfor instrumentet. Fargeprosessen må altså fullføres manuelt.
- » Tørroverføringsstasjon (→ "Fig. 103-3")
  - ⓘ Prøvene er ikke plassert i en reagens, og kan tørke ut. Prøvene må fjernes fra instrumentet og oppbevares på et trygt sted utenfor instrumentet. Fargeprosessen må altså fullføres manuelt.
- » Lesestasjon for objektglass (SID) (→ "Fig. 103-4")
  - ⓘ Hvis det oppstår et strømbrudd, blir stativet som er satt inn i lesestasjonen for objektglass, plassert i en sikker posisjon mellom to reagensstasjoner (→ "Fig. 102"). Fjern stativet som beskrevet (→ S. 134 – 8.2.4 Løsne et stativ fra gripmekanismen), og sett det tilbake i mateskuffen.
- » Ovnsstasjoner (→ "Fig. 103-5")
  - ⓘ Under et langvarig strømbrudd kan temperaturen i ovnsstasjonen synke. Dette kan føre til at prøvene ikke tørker skikkelig. De aktuelle stativene skal fjernes fra ovnen og settes inn i mateskuffen igjen.
- » Overføringsstasjon (→ "Fig. 103-8")
  - ⓘ Prøvene er ikke plassert i en reagens, og kan tørke ut. Prøvene skal fjernes fra instrumentet og lagres på et sikkert sted utenfor instrumentet, eller det skal settes inn manuelt og påføres dekkglass i mateskuffen til HistoCore SPECTRA CV.



### Advarsel

Brukeren må kontrollere om det finnes ekstra stativer i de gjenværende reagensstasjonene (→ "Fig. 103-6") med svært lang hviletid. Dette kan føre til redusert fargekvalitet på grunn av reagensene som brukes i disse spesifikke stasjonene. Prøvene må fjernes fra instrumentet og oppbevares på et trygt sted utenfor instrumentet. Fargeprosessen må altså fullføres manuelt.

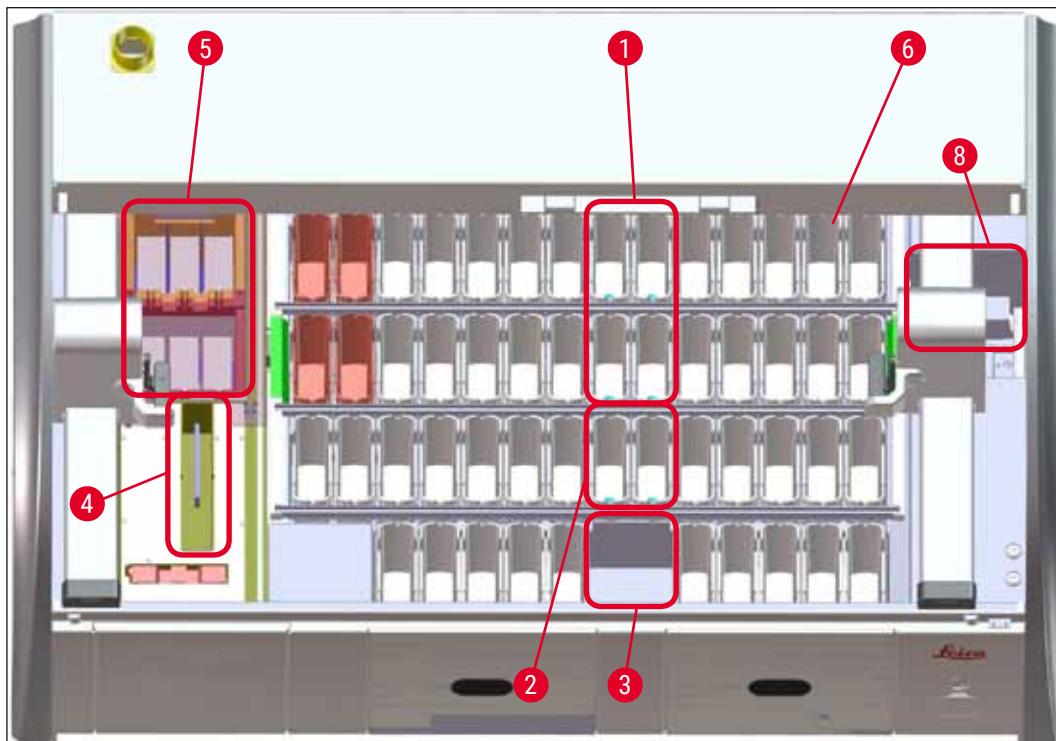


Fig. 103

#### 8.2.1 Prosedyre etter strømbrudd

- ① Den første informasjonsmeldingen etter at enheten starter igjen, varsler brukeren automatisk om tidspunkten for strømbruddet (→ "Fig. 104"). Bekreft meldingen med **OK**-knappen. Deretter vises flere instruksjoner om hvordan fargeprosessen skal fortsettes.

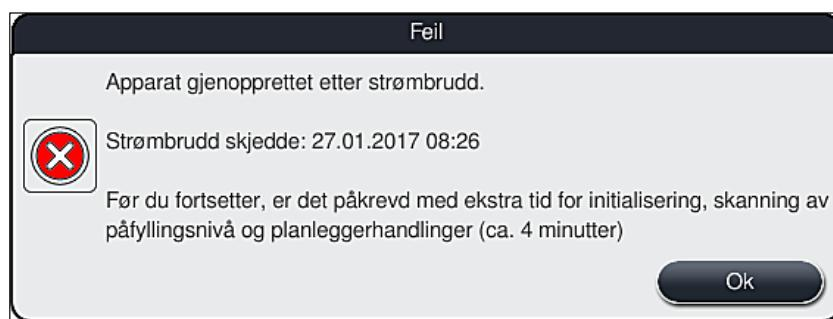


Fig. 104

1. Etter at brukeren har bekreftet informasjonsmeldingen, vises informasjon om at fargeperiodene kan være overskredet. Enkelte stativer kan altså allerede ha vært for lenge i en reagens under visse omstendigheter, eller de kan ha vært i en kritisk stasjon. Dette kan forringe fargekvaliteten. Bekreft informasjonsmeldingen (→ "Fig. 105"), og fortsett ved å trykke på **OK**-knappen.

## 8 Feil og feilsøking



Fig. 105

2. Informasjonsmeldingen ber deretter brukeren kontrollere (→ "Fig. 106") om instrumentet har plassert ett eller to stativer i en sikker posisjon mellom to reagensbeholderne (→ "Fig. 102").



Fig. 106

3. Når du har trykket på **OK**-knappen (→ "Fig. 106"), vises en ny melding (→ "Fig. 107") med instruksjoner om korrekt prosedyre for å fjerne de aktuelle stativene.

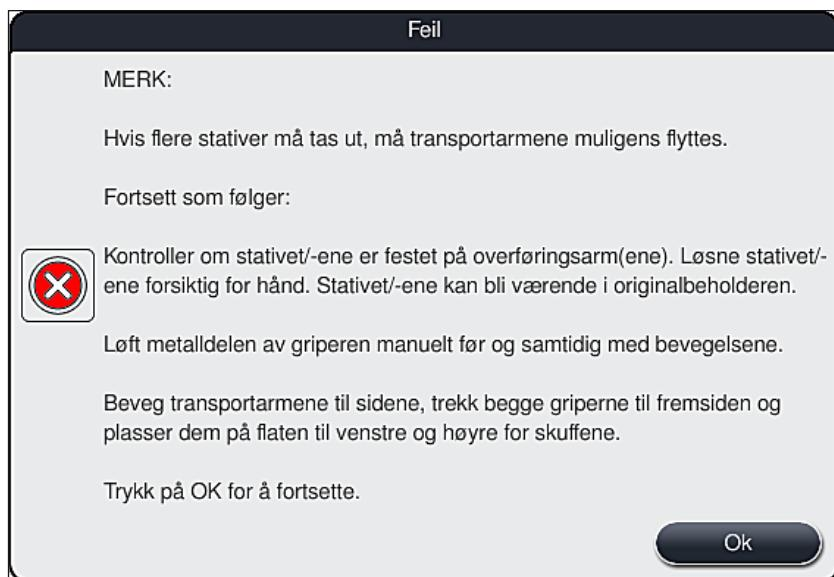


Fig. 107

4. Deretter kan brukeren velge om fargeprosessen skal gjenopptas (→ S. 131 – 8.2.2 Gjenoppta fargeprosessen etter et strømbrudd) eller avbrytes (→ S. 133 – 8.2.3 Avbryte alle fargeprosesser etter et strømbrudd)(→ "Fig. 108").

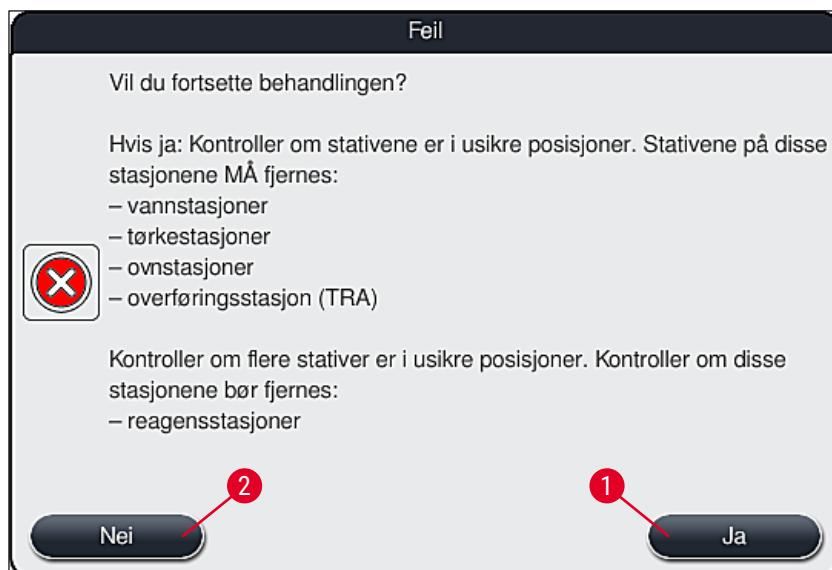


Fig. 108

### 8.2.2 Gjenoppta fargeprosessen etter et strømbrudd

- Trykk på **Ja**-knappen (→ "Fig. 108-1") for å gjenoppta fargeprosessen.



#### Merk

I menyen som følger, vises stativene under behandling i oversikten over fargebadlayouten (→ "Fig. 109").

- Fjern de kritiske stativene fra instrumentet i samsvar med forrige informasjonsmelding (→ "Fig. 108"), og bekrefte fjerningen ved å trykke på den tilsvarende stasjonen (→ "Fig. 109-1") på skjermen.



#### Merk

- Det er bare mulig å bruke metoden som beskrives her for å fjerne stativene som behandles under strømbruddet.
- Prøvene i stativene som fjernes fra instrumentet, skal oppbevares på et trygt sted utenfor instrumentet.  
Fargeprosessen må altså fullføres manuelt.

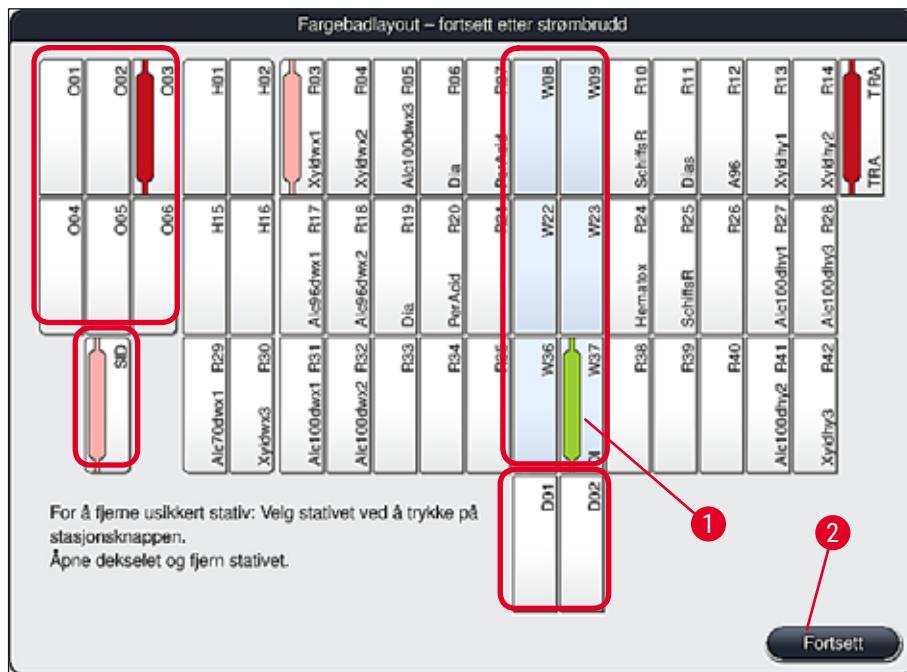


Fig. 109

3. Hvis alle kritiske stativer er fjernet, trykker du på **Fortsett**-knappen. Følg informasjonsmeldingen som vises, og bekrefte ved å trykke på **OK**-knappen.
4. Til slutt utfører instrumentet en automatisk skanning av påfyllingsnivå og gjenopptar fargeprosessen for stativene som er igjen i instrumentet.

**Advarsel**

- Under visse omstendigheter påvises ikke stativene som er igjen i mateskuffen. I så fall åpner og lukker du mateskuffen.
- Du må tilordne et program til de hvite stativene igjen.
- Innmatringsskuffen må også åpnes for hvite stativer. Kontroller objektglassenes program-merke for å fastslå hvilket program som skal tilordnes på nytt.

### 8.2.3 Avbryte alle fargeprosesser etter et strømbrudd

- Hvis fargeprosessen skal avbrytes for alle stativene, trykker du på Nei (→ "Fig. 108-2") og bekrefter neste varselsmelding med OK (→ "Fig. 110-1"), slik at du kan begynne å fjerne stativene.


**Merk**

Du kan angre avbrytelsen av fargeprosessen og return til forrige valgmeny (→ "Fig. 108") ved å trykke på Avbryt-knappen (→ "Fig. 110-2").



Fig. 110

- Åpne dekselet til instrumentet og fjern stativene.
- Bekreft fjerningen av stativet ved å trykke på den tilsvarende stasjonen (→ "Fig. 111-1") på skjermen.



Fig. 111

- Når du har fjernet alle stativene, trykker du på "OK"-knappen (→ "Fig. 111-2") for å forlate menyen og gjenoppta initialiseringen av instrumentet.

**Advarsel**

- Under visse omstendigheter påvises ikke stativene som er igjen i mateskuffen. I så fall åpner og lukker du mateskuffen.
- Du må tilordne et program til de hvite stativene igjen.
- Mateskuffen må også åpnes for hvite stativer. Kontroller objektglassenes program-merke for å identifisere korrekte programmer.

✓ Når de kritiske stativene er fjernet fra instrumentet, behandles de gjenværende stativene videre, og nye stativer kan plasseres i mateskuffen.

**8.2.4 Løsne et stativ fra gripmekanismen**

- ① Stativene er sikret til bunnen av gripmekanismen med to kroker. Under strømbrudd må stativet løsnes fra gripmekanismen slik at det kan fjernes fra instrumentet.
1. Ta tak med én hånd under det fargelede stativhåndtaket (→ "Fig. 113-2") og skyv det litt oppover (→ "Fig. 113-3").
  2. Skyv stativet ca. 1 cm mot innsiden av prøven (→ "Fig. 113-4").
  3. Ta tak i gripmekanismen (→ "Fig. 113-1") med den ledige hånden, skyv den oppover (→ "Fig. 113-5") og hold den godt fast.
  4. Nå kan du fjerne stativet fra instrumentet og sette det til side.
  5. Trekk deretter gripmekanismen fremover, og plasser den varsomt på den ledige flaten ved siden av venstre mateskuff (→ "Fig. 114-3"), eller ved siden av høyre utmatningsskuff (→ "Fig. 114-6").



Fig. 113

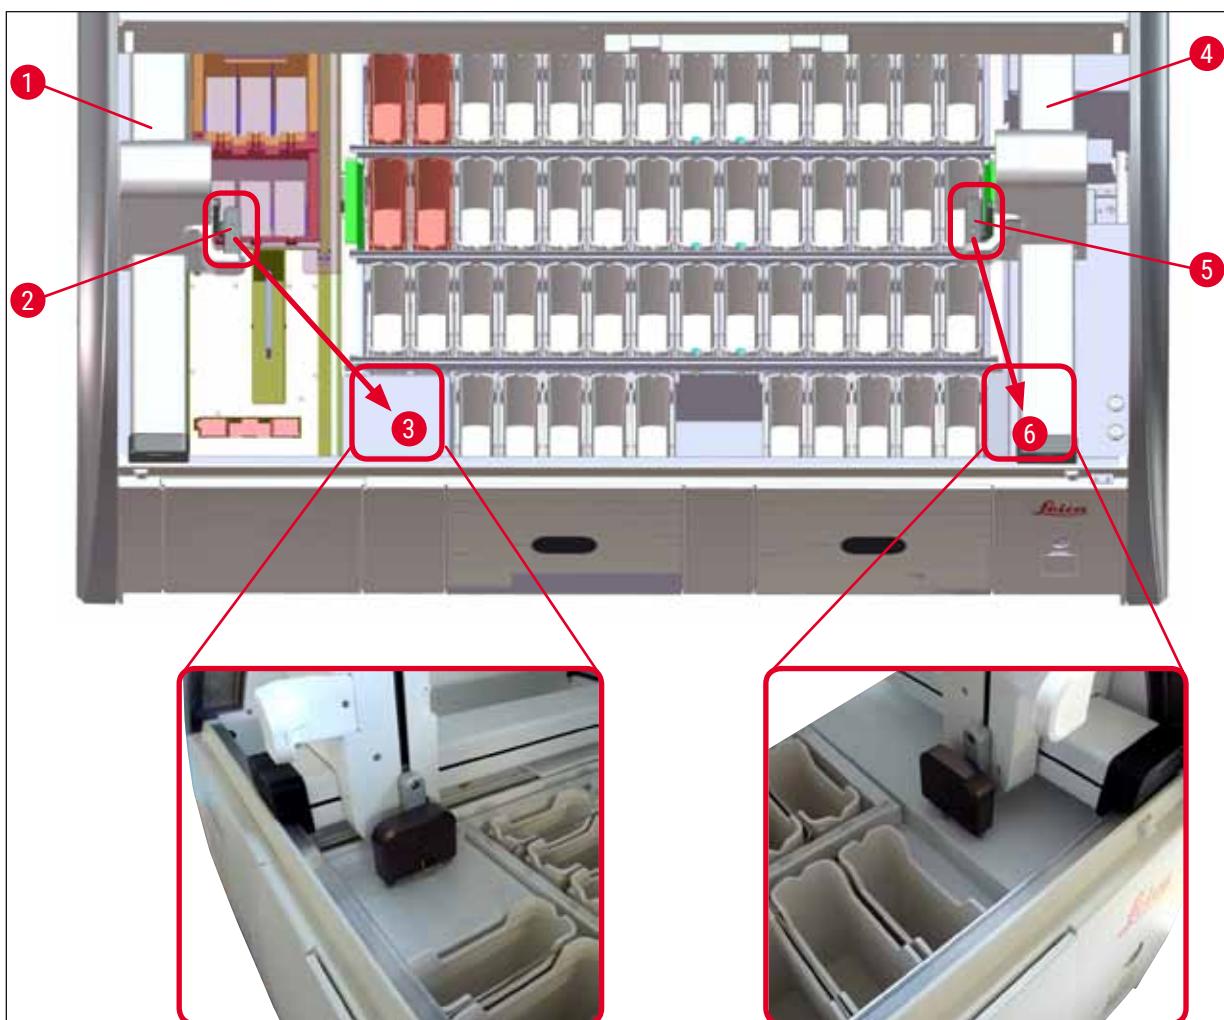


Fig. 114

**Advarsel**

Når du har startet instrumentet på nytt, vises en feilmelding. Den kan brukes til å hente fargebadlayouten (→ "Fig. 39") slik at det blir lettere å fjerne det spesifiserte stativet. Alle stasjoner under behandling skal umiddelbart fjernes manuelt fra instrumentet av brukeren. Kontroller også lesestasjonen for objektglass (→ "Fig. 3-2") og ovnen (→ "Fig. 3-10") på stativet, og skift dem ved behov:

Prøvene må oppbevares utenfor instrumentet i en egnet reagens, og trinnene i de påbegynte fargeprogrammene må fullføres manuelt til programmet er ferdig. Brukeren er ansvarlig for viderebehandling av prøvene.

- Når strømmen er tilbake, kan instrumentet startes på nytt og lastes med nye prøver.

**Merk**

I tilfelle alvorlig maskinfeil som krever at prøvene fjernes fra instrumentet på grunn av avbrudd i fargeprosessen, må prosedyren for strømbrudd følges. Alvorlig maskinfeil angis med en definert alarmlyd (→ S. 45 – 5.7.4 Meny for alarmlyder – Feil- og signallyder).

### 8.2.5 Fjerne et stativ fra overføringsstasjonen

- ⓘ Hvis det oppstår en funksjonsfeil i arbeidsstasjonsmodus mens overføringsenheten til HistoCore SPECTRA ST overfører et stativ til HistoCore SPECTRA CV ved bruk av overføringsstasjonen, må brukeren kontrollere hvor stativet befinner seg.

1. Åpne dekslet til HistoCore SPECTRA ST.
2. Kontroller om stativet fortsatt er synlig fra overføringsstasjonen (→ "Fig. 115-1").

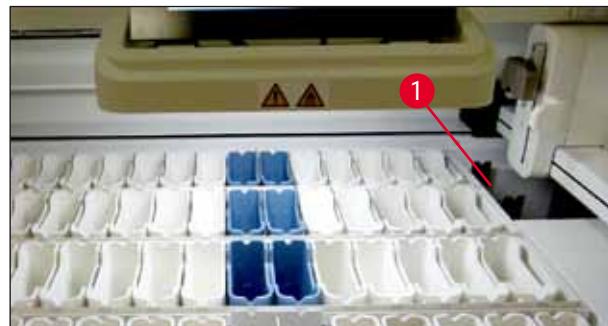


Fig. 115

3. Dersom dette er tilfelle, må du skyve sleden (→ "Fig. 116-1") for overføringsstasjonen inn i HistoCore SPECTRA ST igjen manuelt (→ "Fig. 116-2") og fjerne stativet (→ "Fig. 116-3") fra holderen (→ "Fig. 116-4").

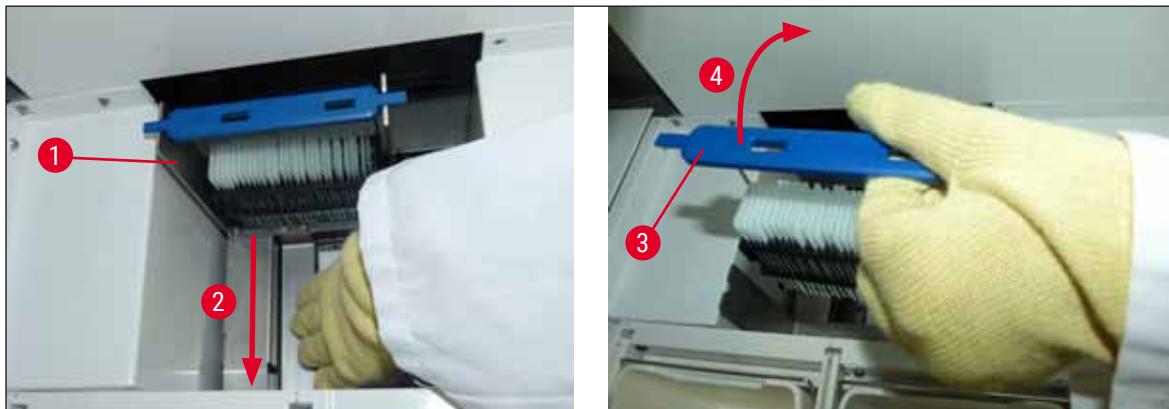


Fig. 116

4. Etterpå fjerner du stativet fra instrumentet og oppbevarer det på et trygt sted.
5. Etter at feilen på instrumentet er rettet, setter du inn stativet i mateskuffen til HistoCore SPECTRA CV for å starte prosessen med påsetting av dekkglass.

### 8.3 Skifte hovedsikringer



#### Advarsel

I tilfelle maskinsvikt må instrumentet slås av med strømbryteren og kobles fra strømtilførselen. Hovedsikringene kan så inspiseres.

- Åpne dekselet, og skru opp de to sikringsholderne på toppen av det høyre dekselet (→ "Fig. 117-1") med en flathodet skrutrekker. Se etter skade.



#### Advarsel

Bruk en egnet flathodet skrutrekker slik at sikringsholderen ikke skades.



#### Advarsel

Vær oppmerksom på defekte sikringer. Potensiell fare for personskade på grunn av knust glass.



Fig. 117

- Hvis sikringen er defekt, må den tas ut av sikringsholderen og skiftes (→ S. 18 – 3.1 Standard levering).
- Sikringen installeres i motsatt rekkefølge.

### 8.4 Fjernhjelp

En Leica-servicetekniker kan ved hjelp av Fjernhjelp eksternt overvåke, få tilgang til og reparere produkter som er i bruk i brukerens lokaler.

Hvis instrumentet er tilkoblet Fjernhjelp ([→ S. 56 – 5.7.10 Nettverksinnstillinger](#)) og det oppstår en funksjonsfeil, kan Leica Service få direkte tilgang til skjermen når brukeren gir tillatelse til det.

- Kontakt Leica-serviceteamet og informer dem om funksjonsfeilen.
- Leica-serviceteknikeren kan nå få tilgang til instrumentet via Fjernhjelp.
- Brukeren blir informert via en informasjonsmelding på skjermen, og må godkjenne tilgang til instrumentet ved å bekrefte meldingen.
- Leica-serviceteknikeren prøver å fikse funksjonsfeilen i samarbeid med brukeren.
- Når reparasjonen er fullført, brytes tilkoblingen til Fjernhjelp igjen av enten brukeren ([→ "Fig. 16-4"](#)) eller Leica-serviceteknikeren.



#### Merk

Brukeren kan når som helst trykke på tilkoblingssymbolet ([→ "Fig. 16-4"](#)) og avslutte en aktiv Fjernhjelp-tilkobling.

### 8.5 Blokkert avløpssystem

Vannivået i dreneringsspannen kan stige hvis avløpssystemet blokkeres (i avløpsfilteret ([→ "Fig. 96-1"](#)) eller avløpslangen ([→ "Fig. 7-1"](#))). Dette kan føre til at vannivået i instrumentet blir kritisk. Brukeren mottar en feilmelding ([→ "Fig. 118"](#)) på skjermen, og hører en alarm.

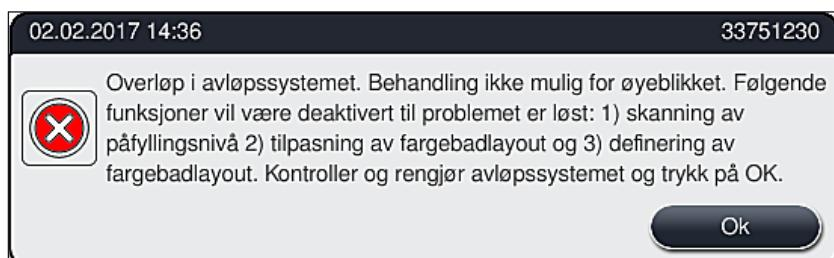


Fig. 118



#### Advarsel

Høyt vannivå i instrumentet på grunn av blokkert avløpssystem kan føre til at fargeprosessen forsinkes eller forringes. Aktive fargeprogrammer stanses midlertidig. Brukeren må fjerne blokeringen umiddelbart som beskrevet nedenfor.

Fjerne blokkering i avløpssystemet**Advarsel**

- Hvis stativene fremdeles befinner seg i skyllevannsbeholderne, skal de fjernes og oppbevares midlertidig i vann utenfor instrumentet.
- Skriv ned posisjonen til stativet du har fjernet, slik at fargeprosessen kan gjenopptas når blokkeringen er fjernet.
- Dekk til reagensbeholderne ved siden av for å beskytte dem. De kan stå i instrumentet så lenge.

1. Åpne dekselet til instrumentet hvis varselmeldingen (→ "Fig. 118") vises.
2. Fjern forsiktig skyllevannbeholderne (og reagensbeholderne ved siden av ved behov) over avløpsfilteret (→ S. 116 – 7.12 Avløpssystem).

**Advarsel**

Vær forsiktig når du fjerner skyllevannbeholderne. Løft hver enkel skyllevannbeholder og la vannet i beholderen renne ned i dreneringspannen. Alt vann må renne ut av beholderne slik at du kan fjerne dem uten at det drypper vann ned i reagensbeholderen.

3. Kontroller om avløpsfilteret og det buede avløpet inne i instrumentet (→ "Fig. 96-2") er tilstoppet. Rengjør dem som beskrevet i (→ S. 116 – 7.12 Avløpssystem) og (→ S. 117 – 7.13 Avløpsslange) ved behov.
4. Hvis det blokkerte vannet forsvinner, kan du sette på plass skyllevannbeholderne, reagensbeholderne og stativene som du fjernet.

**Advarsel**

Dekslene til reagensbeholderne du dekte til, må fjernes før du lukker dekselet til instrumentet igjen.

5. Lukk dekselet til instrumentet, og trykk på **OK**-knappen for å bekrefte meldingen (→ "Fig. 119").

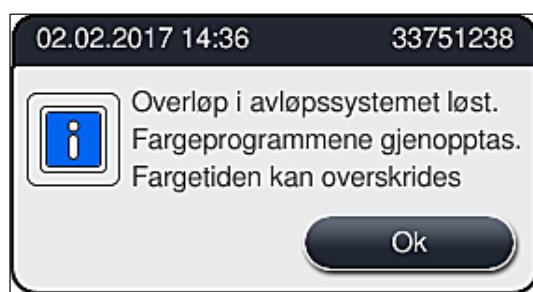


Fig. 119



### Advarsel

Hvis brukeren ikke kan fjerne blokkeringen og vannivået i dreneringspannen fortsatt er kritisk, må alle stativene fjernes fra instrumentet. Følg instruksjonene om fjerning av stativ i informasjonsmeldingen (→ "Fig. 120") som vises på skjermen. Denne informasjonsmeldingen vises etter at du har lukket dekselet til instrumentet og instrumentet har påvist at blokkeringen ikke kan fjernes.

Programmene kan ikke startes på nytt. Kontakt Leica brukerstøtte.

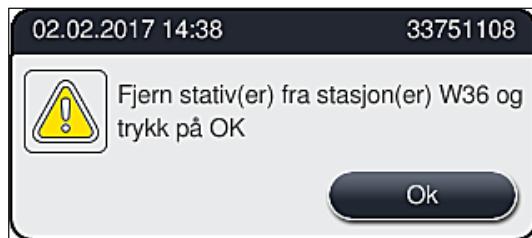


Fig. 120

## 9. Instrumentkomponenter og -spesifikasjoner

### 9.1 Tilleggsutstyr til instrumentet

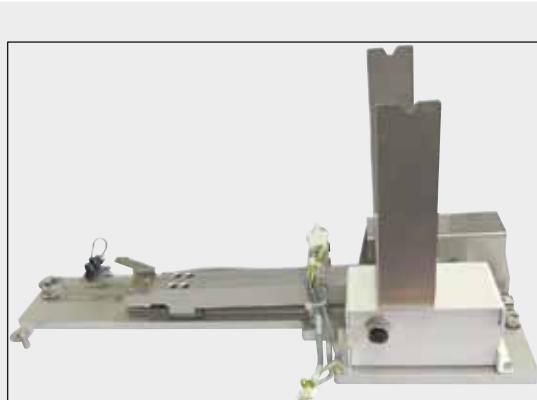


Fig. 122

#### HistoCore arbeidsstasjonsett

Brukes i HistoCore SPECTRA ST for å overføre prøver til den automatiske dekkglassmaskinen HistoCore SPECTRA CV, som må være tilkoblet. De to instrumentene danner en arbeidsstasjon etter at settet er installert.

Settet inneholder overføringsmodulen og alle deler som er nødvendige for integreringen i HistoCore SPECTRA ST.

**Bestillingsnr.:**

**14 0512 54355**

### 9.2 Tilleggsutstyr

Betegnelse	Bestillingsnr.
Avløpsslange, 2 m	14 0512 54365
Aktivt kullfiltersett (2 stk.)	14 0512 53772
Reservefilter for ovnens luftfilter (3 stk.)	14 0512 54943
Avløpsslange, 2 m	14 0512 55279
Tilførselsslange	14 0474 32325
Reagensbeholder, sett, inkludert reagensbeholderlokk	14 0512 47086
Sett med beholderlokk, inneholder 3 lokk	14 0512 57846
<b>Vanntilkoblingsutstyr, bestående av:</b>	<b>14 0512 49324</b>
2 stk. vanninnløpsslange, 10 mm, 2,5 m	14 0474 32325
1 stk. forlengelsesslange, 1,5 m	14 0512 49334
1 stk. Y-kobling G3/4	14 3000 00351
1 stk. dobbeltnippel G3/4 G1/2	14 3000 00359
1 stk. filterhus	14 0512 49331
1 stk. filterinnsats	14 0512 49332
1 stk. rørkobling G3/4	14 3000 00360
1 stk. blindhette G3/4	14 3000 00434
1 stk. tetningsskive	14 0512 54772
1 stk. skrunøkkel med ett hode SW30 DIN894	14 0330 54755

Betegnelse	Bestillingsnr.
HistoCore arbeidsstasjonsett	14 0512 54355
Innsats for spesialfarger	14 0512 49261
Vannfilterholder	14 0512 59363
Skyllevannsbeholder, blå, sett	14 0512 47087
Molykote 111 smørefett, 100 g	14 0336 35460
Etikettsett til mate- og utmatningsskuffer (10 blanke, 5 med hhv. "H2O" = vann, "A" = alkohol og "S" = løsemiddel, f.eks. xylen)	14 0512 55161
O-ringer 7x2, til overgangsstykke for skyllevannsbeholder (12 stk. per pakke)	14 0253 54716
Stativ for 30 objektglass* (3 stk. per pakke)	14 0512 52473
Stativ for 5 objektglass* (3 stk. per pakke)	14 0512 52475
Håndtak for 30 objektglass* (gult, 3 stk. per pakke)	14 0512 52476
Håndtak for stativ for 30 objektglass* (lyseblått, 3 stk. per pakke)	14 0512 52477
Håndtak for stativ for 30 objektglass* (mørkeblått, 3 stk. per pakke)	14 0512 52478
Håndtak for stativ for 30 objektglass* (rosa, 3 stk. per pakke)	14 0512 52479
Håndtak for stativ for 30 objektglass* (rødt, 3 stk. per pakke)	14 0512 52480
Håndtak for stativ for 30 objektglass* (lysegroent, 3 stk. per pakke)	14 0512 52481
Håndtak for stativ for 30 objektglass* (svart, 3 stk. per pakke)	14 0512 52482
Håndtak for stativ for 30 objektglass* (grått, 3 stk. per pakke)	14 0512 52483
Håndtak for stativ for 30 objektglass* (hvitt, 3 stk. per pakke)	14 0512 52484
Håndtak for 5 objektglass* (gult, 3 stk. per pakke)	14 0512 52494
Håndtak for stativ for 5 objektglass* (lyseblått, 3 stk. per pakke)	14 0512 52495
Håndtak for stativ for 5 objektglass* (mørkeblått, 3 stk. per pakke)	14 0512 52496
Håndtak for stativ for 5 objektglass* (rosa, 3 stk. per pakke)	14 0512 52497
Håndtak for stativ for 5 objektglass* (rødt, 3 stk. per pakke)	14 0512 52498
Håndtak for stativ for 5 objektglass* (lysegroent, 3 stk. per pakke)	14 0512 52499
Håndtak for stativ for 5 objektglass* (svart, 3 stk. per pakke)	14 0512 52500
Håndtak for stativ for 5 objektglass* (grått, 3 stk. per pakke)	14 0512 52501
Håndtak for stativ for 5 objektglass* (hvitt, 3 stk. per pakke)	14 0512 52502
(* objektglass)	

**Merk**

- Kontakt Leica brukerstøtte for informasjon om tilgjengelige Leica-reagenssett og godkjente Leica-programmer.
- En brukerhåndbok med informasjon om import av godkjente Leica-programmer følger med hvert Leica-reagenssett.

**Stativhåndtak for stativer fra andre produsenter****Merk**

Bruk av denne stativadapteren er godkjent i HistoCore SPECTRA ST sammen med Sakura objektglassholder (Sakura kurv til 20 objektglass, produktkode 4768) tilgjengelig i oktober 2017.

Siden produsenten kan gjøre endringer på objektglassholderen til typen som er godkjent av Leica, anbefaler vi at kunden utfører en testkjøring før adapteren brukes klinisk.

Adapterhåndtak for Sakura 20 stativ (gult, 3 stk. per pakke)	14 0512 55661
Adapterhåndtak for Sakura 20 stativ (lyseblått, 3 stk. per pakke)	14 0512 55662
Adapterhåndtak for Sakura 20 stativ (mørkeblått, 3 stk. per pakke)	14 0512 55663
Adapterhåndtak for Sakura 20 stativ (rosa, 3 stk. per pakke)	14 0512 55664
Adapterhåndtak for Sakura 20 stativ (rødt, 3 stk. per pakke)	14 0512 55665
Adapterhåndtak for Sakura 20 stativ (lysegrønt, 3 stk. per pakke)	14 0512 55666
Adapterhåndtak for Sakura 20 stativ (svart, 3 stk. per pakke)	14 0512 55667
Adapterhåndtak for Sakura 20 stativ (grått, 3 stk. per pakke)	14 0512 55668
Adapterhåndtak for Sakura 20 stativ (hvitt, 3 stk. per pakke)	14 0512 55669



Fig. 123

**Avløsslange**

Lengde: 2 m

**Bestillingsnr.:****14 0512 55279**

Fig. 124

**Tilførselsslange for skyllevann**

Lengde: 2,50 m sett med 3/4" overgangsstykke til vannkran, inkl. reservetetning

**Bestillingsnr.:****14 0474 32325**

Fig. 125

**Vanntilkoblingsutstyr****Bestillingsnr.:****14 0512 49324**

Innhold:

- 2x vanninnløpsslange, 10 mm, 2,5 m 14 0474 32325
- Forlengelsesslange, 1,5 m 14 0512 49334
- Y-kobling G3/4 14 3000 00351
- 2x dobbeltnippel G3/4 G1/2 14 3000 00359
- Filterhus 14 0512 49331
- Filterinnsats 14 0512 49332
- Rørkobling G3/4 14 3000 00360
- Blindhette G3/4 14 3000 00434
- Tetningsskive 14 0512 54772
- Skrunøkkel med ett hode SW30 DIN894 14 0330 54755



Fig. 126

## Avløpsslange

Lengde: 2 m

Bestillingsnr.:

14 0512 54365

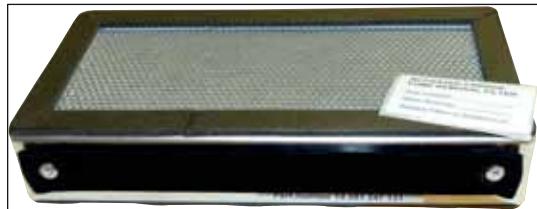


Fig. 127

## Aktivt kullfilter

1 sett, bestående av 2 stk.

Bestillingsnr.:

14 0512 53772



Fig. 128

## Reagensbeholder

Sett, inkl. reagensbeholderlokk

Bestillingsnr.:

14 0512 47086

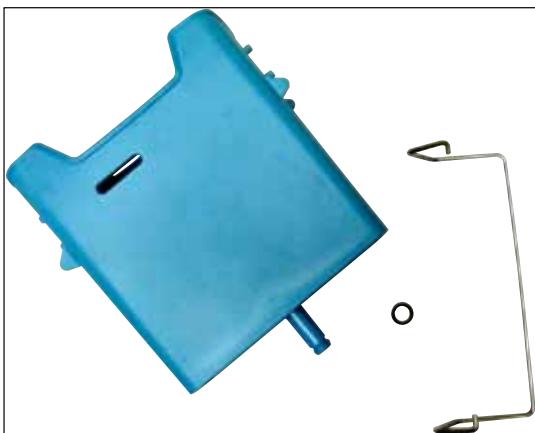


Fig. 129

### Skyllevannsbeholder

sett

Bestillingsnr.:

14 0512 47087



Fig. 130

### Innsats for spesialfarger

(kun for stativer for opptil 5 objektglass)

Bestillingsnr.:

14 0512 49261



Fig. 131

### Stativer

30 objektglass (3 stk. per pakke)

Bestillingsnr.:

14 0512 52473



Fig. 132

**Håndtak for stativ**

30 objektglass (3 stk. per pakke)

**Farge**

- gult 14 0512 52476
- lyseblått 14 0512 52477
- mørkeblått 14 0512 52478
- rosa 14 0512 52479
- rødt 14 0512 52480
- lysegrønt 14 0512 52481
- svart 14 0512 52482
- grått 14 0512 52483
- hvitt 14 0512 52484

**Bestillingsnr.:**

Fig. 133

**Stativer**

5 objektglass (3 stk. per pakke)

**Bestillingsnr.:****14 0512 52475**

Fig. 134

**Håndtak for stativ**

5 objektglass (3 stk. per pakke)

**Farge**

- gult 14 0512 52494
- lyseblått 14 0512 52495
- mørkeblått 14 0512 52496
- rosa 14 0512 52497
- rødt 14 0512 52498
- lysegrønt 14 0512 52499
- svart 14 0512 52500
- grått 14 0512 52501
- hvitt 14 0512 52502

**Bestillingsnr.:**

## 9 Instrumentkomponenter og -spesifikasjoner



Fig. 135

### Sett med beholderlokk

Ett lokk kan dekke en hel rad med reagensbeholdere (14 stk.) i beholderfeltet (→ "Fig. 64").

**Bestillingsnr.:** 14 0512 57846

Innhold:

• 3 beholderlokk 14 0512 57847

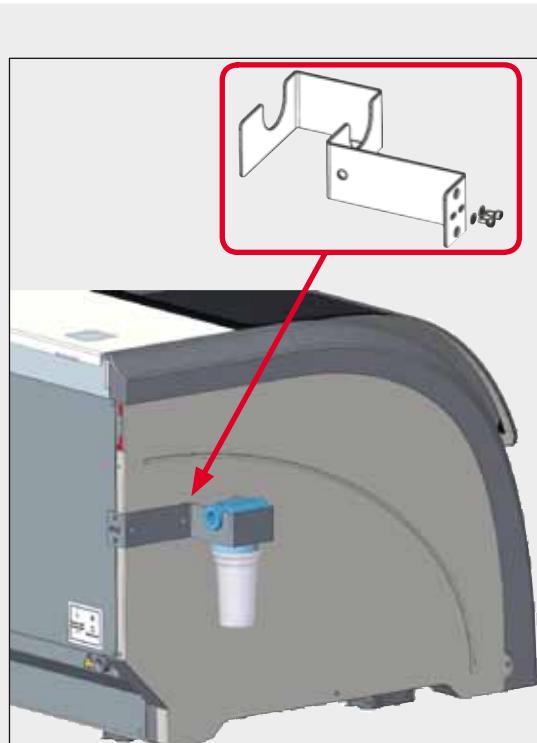


Fig. 136

### Vannfilterholder

Festes på venstre side av HistoCore SPECTRA ST

Vannfilterholderen kan brukes til å feste vannfilteret og gi brukeren forbedret tilgjengelighet og oversikt.

**Bestillingsnr.:** 14 0512 59363

Innhold:

• 1 vannfilterholder 14 0512 59364  
• 2 hodeskruer 14 2101 03234  
• 2 skiver 14 2171 02114

**Merk:** Installasjon av vannfilterholderen må bare utføres av Leica-autorisert personale!

## 10. Garanti og service

### Garanti

Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterer at produktet som er levert i henhold til kontrakten, har gjennomgått omfattende kvalitetskontroller basert på Leicas interne teststandarder, og at produktet er feilfritt og i samsvar med alle tekniske spesifikasjoner og/eller avtalte egenskaper.

Garantiomfanget er basert på innholdet i kontrakten som er inngått. Garantivilkårene til din Leica-salgsorganisasjon eller organisasjonen du har kjøpt produktet fra, skal gjelde til utelukkelse av alle andre.

### Serviceinformasjon

Hvis du trenger støtte eller reservedeler, kontakt din Leica-representant eller Leica-forhandleren som du kjøpte instrumentet fra.

Følgende opplysninger på instrumentet må oppgis:

- Instrumentets modellnavn og serienummer.
- Stedet hvor instrumentet befinner seg og navn på kontaktperson.
- Grunnen til at du tar kontakt.
- Leveringsdato for instrumentet.

## 11 Driftsnedlegging og kassering

### 11. Driftsnedlegging og kassering



#### Advarsel

Instrumentet og instrumentets deler må deponeres i henhold til gjeldende lokale bestemmelser. Alle objekter som er kontaminert med reagenssøl, må straks desinfiseres med et egnert desinfeksjonsmiddel for å hindre spredning til andre områder av laboratoriet eller laboratoriepersonell.

Informasjon om rengjøring av fargeinstrumentet HistoCore SPECTRA ST finnes i kapitlet ([→ S. 111 – 7. Rengjøring og vedlikehold](#)) og i dekontaminasjonerklæringen ([→ S. 151 – 12. Dekontaminasjonerklæring](#)) på slutten av denne brukerhåndboken.

Instrumentet kan bli kontaminert ved bruk av prøver som utgjør en mikrobiologisk risiko. Grundig desinfisering er påkrevd før driften av instrumentet kan legges ned og det kan deponeres (f.eks. flere rengjøringstrinn, desinfisering eller sterilisering). Deponer instrumentet i tråd med gjeldende laboratoriespesifikasjoner.

Kontakt din Leica-representant for nærmere informasjon.



Instrumentkomponenter som datamaskin, skjerm osv., som er merket med en søppeldunk med kryss over, omfattes av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF av 27. januar 2003 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

Disse objektene skal kastes via innsamlingspunkter, i samsvar med lokale bestemmelser. Mer informasjon om kassering av instrumentet fås fra ditt lokale behandlingsanlegg eller din lokale Leica-brukerstøtte.

## **12. Dekontaminasjonserklæring**

Alle produkter som returneres til Leica Biosystems, eller som må vedlikeholdes på stedet, skal rengjøres og dekontamineres grundig. Du finner malen med dekontaminasjonserklæringen i produktmenyen på nettstedet [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com). Denne malen skal brukes for å samle inn alle nødvendige data.

Når du returnere et produkt, skal en kopi av den utfylte og signerte erklæringen legges ved eller leveres til serviceteknikeren. Senderen er ansvarlig for produkter som returneres uten denne erklæringen eller med ufullstendig erklæring. Returnerte varer som selskapet anser som en potensiell fare, blir sendt tilbake. Senderen må dekke kostnader og risiko.

## A1 Vedlegg 1 – Kompatible reagenser

### A1. Vedlegg 1 – Kompatible reagenser



#### Advarsel

- Bruk av andre reagenser enn de som er oppgitt på listen (f.eks. aceton eller løsninger som inneholder fenol), eller reagenser og syrer i høyere konsentrasjoner enn oppgitt, kan føre til ødelagte prøver, personskader og skade på instrumentet. Bruk av disse stoffene i instrumentet skjer på eget ansvar. Leica Biosystems og deres tilknyttede salgs- og serviceorganisasjoner gir ingen garantier og påtar seg intet ansvar for disse.
- Brannfarlige reagenser og løsemidler må ikke varmes opp, da dette kan føre til brann og eksplosjon. Hold avstand til alle tennkilder ved håndtering av brannfarlige løsemidler og reagenser.



#### Merk

Fargekvaliteten og materialekompatibiliteten til alle Leica-reagensene for forhåndsinstallerte Leica-programmer er testet med instrumentet.

Fargemetode eller reagensgruppe	Reagensnavn	Merknader
H&E-sett	Leica Infinity ST Hemalast ST Hematoxylin ST Differentiator ST Bluing ST Eosin	
	Leica SelecTech Hemotoxylin 560 Hemotoxylin 560MX Define MX-aq Blue Buffer-8 Y515 Alkoholholdig eosin Y515LT Alkoholholdig eosin 515 Eosin Trichrome Eosin Phloxine	
Andre H&E-reagenser	Leica Gill II Hematoxylin Gill III Hematoxylin Harris Hematoxylin Mayer's Hemalaun	
	Leica Alkoholholdig eosin Vandig eosin (1 %)	
	Leica Scott's Tap Water-løsning	
	Leica Syre-alkohol 0,5 %	
	Leica Syre-alkohol 1,0 %	
	Brukerdefinert Saltsyre 2 %	

# Vedlegg 1 – Kompatible reagenser A1

Fargemetode eller reagensgruppe	Reagensnavn	Merknader	
<b>PAS</b>	Leica	Periodesyre 0,5 %	
	Brukerdefinert	Periodesyre (opptil 10 %)	
	Leica	Schiffs reagens	
<b>Diastase-PAS</b>	Leica	Diastase-løsning (37 °C)	
<b>Alcian blå-PAS</b>	Leica	Alcian blå-løsning	
<b>Alcian blå</b>	Leica		
<b>Alcian blå og andre fargemetoder</b>	Leica	Nuclear fast Red	
<b>Gomori Trichrome blå og grønn kollagenfarging</b>	Leica	Weigert Hematoxylin (A+B-løsning) Gomori Trichrome blå farge 1 % eddiksyre Lysegrønn	
<b>Perls jernfarging</b>	Leica	Kaliumferrocyanid-løsning Hydrokloridsyre-løsning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Må ikke komme i kontakt med metallioner</li> <li>• Skal bare brukes med belagte håndtak til stativer for 5 objektglass</li> </ul>
<b>Giemsa</b>	Leica	Metanolløsning A Farge 1 løsning B Farge 2 løsning C Bufferløsning D	
<b>Kongorød amyloidfarge</b>	Leica	Kongorødløsning	
	Leica	1 % kaliumhydroksidløsning	
	Brukerdefinert	Mettet litiumkarbonatløsning	
<b>Alcian-gult for Helicobacter Pylori</b>	Leica	Alcian-gult-løsning (0,25 % alcian-gult) 5 % periodesyre 5 % natriummetabisulfitt 6,8 pH Sorensen-buffer Toluidin-blå løsning	
<b>Elastisk farge / Verhoeffs van Gieson</b>	Leica	5 % alkoholholdig hematoxylin 10 % ferriklorid Lugols jodløsning 2 % ferriklorid Verhoeffs fargeløsning Van Giesons farge	

## A1 Vedlegg 1 – Kompatible reagenser

Fargemetode eller reagensgruppe	Reagensnavn	Merknader
<b>Gomori metenamin-sølvfarging</b>	Leica  Modifisert kromsyre (opptil 5 %)  Metenaminboraks  0,5 % sølvnitrat    1 % natriumbisulfat  1 % gullklorid  2 % natriumtiosulfat  Lysegrønn	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Må ikke komme i kontakt med metallioner</li> <li>• Skal bare brukes med belagte håndtak til stativer for 5 objektglass</li> </ul>
<b>Papanicolaou (PAP)</b>	Leica EA-50  Leica Orange G-6  Leica EA-65 (sekundær kontrastfarge)	
<b>Schmorls fortynning</b>	Schmorls løsning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skal bare brukes med belagte håndtak til stativer for 5 objektglass</li> </ul>
<b>(Müller) kolloid jern</b>	Kolloid jernløsning  Ferrocyanid-saltsyre-løsning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skal bare brukes med belagte håndtak til stativer for 5 objektglass</li> </ul>
<b>Andre reagenser</b>	Brukerdefinert Anilinblått  Brukerdefinert Metylenblått  Brukerdefinert Fast Green  Brukerdefinert Karmin  Brukerdefinert Southgate eller Mayers Mucicarmine  Brukerdefinert Nøytralrødt  Brukerdefinert Safranin	

## Vedlegg 1 – Kompatible reagenser A1

Fargemetode eller reagensgruppe	Reagensnavn	Merknader
<b>Løsemiddel</b>	Leica/ brukerdefinert	Xylen, toluen
	Leica	Leica Ultra ST Xylenesterstatning basert på alifatiske hydrokarboner
	Leica	Leica Clearene Limonenbasert xylenesterstatning
	Merck	Merck Neo-Clear Xylenesterstatning basert på alifatiske hydrokarboner
	Carl Roth	Roti®-Histol Limonenbasert xylenesterstatning
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Clear-Rite 3 Xylenesterstatning basert på alifatiske hydrokarboner
<b>Alkohol</b>	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Citrus Clearing Solvent Limonenbasert xylenesterstatning
	Leica/ brukerdefinert	2-Propanol (isopropylalkohol)
	Leica/ brukerdefinert	Etanol Metanol
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Dehydrant Etylalkohol, metylalkohol
<b>Vanlige syrer (maks. konsentrasjon)</b>	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Flex Isopropylalkohol, alkohol, metylalkohol
	Brukerdefinert	Eddiksyre (opptil 15 %) Saltsyre (opptil 5 %) Pikrinsyre (opptil 3 %)





[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Strasse 17 - 19  
69226 Nussloch  
Tyskland

Tlf.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Faks: +49 - (0) 6224 - 143 268  
Internett: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)