

# VT1000 S

## Leica VT1000 S – Микротом с вибрирующим лезвием

Руководство по эксплуатации

Русский

№ для заказа: 14 0472 80113 - Редакция L

Хранить рядом с прибором.

Внимательно изучить перед началом эксплуатации.

CE





Содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации информация, числовые данные, указания и оценки отражают современный уровень науки и техники, изученный нами в рамках детальных исследований.

Мы не берем на себя обязательство регулярно адаптировать данное руководство к новым техническим разработкам и рассыпать нашим клиентам его обновленные версии.

Наша ответственность за содержащиеся в данном руководстве неверные сведения, неточные рисунки, технические изображения и прочее исключается в рамках допустимого согласно действующему национальному законодательству. В частности, мы не несем никакой ответственности за материальный и косвенный ущерб, возникший в связи с использованием параметров, характеристик и прочей информации, содержащейся в данном руководстве.

Данные, схемы, иллюстрации и прочая информация как содержательного, так и технического характера в данном руководстве не являются гарантированными свойствами нашей продукции.

Основополагающими являются только договорные условия между нами и нашими клиентами.

Leica сохраняет за собой право на внесение изменений в технические спецификации и производственные процессы без предварительного уведомления. Только таким образом можно реализовать непрерывный процесс технических и производственно-технических улучшений.

Данная документация защищена законом об авторском праве. Все авторские права принадлежат компании Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Тиражирование текста и иллюстраций (в том числе их частей) путем перепечатки, фотокопирования, микрофильмирования, использования веб-камер и прочими способами — включая различные электронные системы и носители — разрешается только с предварительного письменного согласия компании Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Серийный номер и год изготовления указаны на заводской табличке прибора.



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Str. 17 - 19  
69226 Nussloch  
Germany  
Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Факс: +49 - (0) 6224 - 143 268  
Веб-сайт: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)

Изготовлено по заказу Leica Microsystems Ltd. Shanghai.

# **Содержание**

---

<b>1.</b>	<b>Важные указания .....</b>	<b>5</b>
1.1	Символы и их значение.....	5
1.2	Тип прибора.....	8
1.3	Информация .....	8
1.4	Группа пользователей .....	8
1.5	Использование по назначению/недопустимое использование .....	8
<b>2.</b>	<b>Безопасность .....</b>	<b>9</b>
2.1	Указания по технике безопасности.....	9
2.2	Предупреждения об опасности .....	9
2.3	Предписания по технике безопасности при обращении с прибором.....	10
<b>3.</b>	<b>Свойства прибора .....</b>	<b>11</b>
3.1	Технические характеристики .....	11
3.2	Общий вид - VT1000 S.....	12
<b>4.</b>	<b>Установка.....</b>	<b>14</b>
4.1	Стандартный комплект поставки .....	14
4.2	Распаковка и установка прибора.....	15
<b>5.</b>	<b>Управление .....</b>	<b>18</b>
5.1	Требования к месту установки.....	18
5.2	Перед вводом прибора в эксплуатацию .....	18
5.3	Органы управления и принципы их функционирования – VT1000 S .....	20
5.4	Регулировка амплитуды .....	24
5.5	Ежедневная работа с VT1000 S.....	24
5.6	Ежедневное текущее обслуживание и выключение прибора – VT1000 S.....	28
<b>6.</b>	<b>Неисправности: значение и устранение .....</b>	<b>29</b>
<b>7.</b>	<b>Очистка и техническое обслуживание .....</b>	<b>33</b>
7.1	Чистка прибора.....	33
7.2	Замена предохранителя .....	34
<b>8.</b>	<b>Информация для заказа: запасные детали, принадлежности, расходные материалы.....</b>	<b>35</b>
8.1	Информация для заказа .....	35
8.2	Ножной переключатель .....	35
8.3	Буферный поддон.....	36
8.3.1	Буферный поддон S с двойной стенкой.....	36
8.4	Увеличитель, светодиодная подсветка .....	37
8.5	Циркуляционный охладитель Julabo FL300 .....	38
<b>9.</b>	<b>Гарантия и обслуживание .....</b>	<b>39</b>
<b>10.</b>	<b>Подтверждение обеззараживания .....</b>	<b>40</b>

## 1. Важные указания

### 1.1 Символы и их значение



#### Важно

Leica Biosystems GmbH не несет ответственности за косвенные убытки или повреждения, полученные из-за несоблюдения следующих инструкций. Это в частности относится к транспортировке и выполнению погрузочно-разгрузочных работ, а также к невыполнению инструкций по осторожному обращению с инструментом.

#### Символ:



#### Название символа:

#### Описание:

Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям

Несоблюдение может привести к серьезным травмам или летальному исходу.

#### Символ:



#### Название символа:

#### Описание:

Важно

Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая при несоблюдении предписания может привести к серьезным травмам или летальному исходу.

#### Символ:



#### Название символа:

#### Описание:

Указание

Обозначает ситуацию, при которой может быть нанесен ущерб имуществу, и которая при несоблюдении предписания может привести к повреждению механизма или предметов, находящихся вблизи него.

#### Символ:

→ "Рис. 7 - 1"

#### Название символа:

#### Описание:

Номер позиции

Номера позиций на иллюстрациях. Числа красного цвета обозначают номера позиций на иллюстрациях.

#### Символ:

запуска

#### Название символа:

#### Описание:

Функциональная клавиша

Программные символы, нажимаемые в окне ввода, выделены серым жирным шрифтом и подчеркиванием.

#### Символ:



#### Название символа:

#### Описание:

Китайский стандарт RoHS

Символ экологической безопасности по китайскому стандарту RoHS. Число в символе показывает "Срок экологически безопасного использования" изделия в годах. Символ используется в том случае, если применяется вещество в концентрации, превышающей предельно допустимые в Китае нормы.

#### Символ:




#### Название символа:

#### Описание:

Символ WEEE


Символ WEEE указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, подлежащего утилизации, и представляет собой перечеркнутый контейнер для мусора на колесах (§ 7 Закона об электрическом и электронном оборудовании).

<b>Символ:</b>	<b>Название символа:</b>	Изготовитель
	<b>Описание:</b>	Указывает на изготовителя медицинского изделия.
<b>Символ:</b>	<b>Название символа:</b>	Дата изготовления
	<b>Описание:</b>	Указывает на дату изготовления медицинского изделия.
<b>Символ:</b>	<b>Название символа:</b>	Декларация соответствия
	<b>Описание:</b>	Использование знака соответствия стандартам ЕС является декларацией производителя, свидетельствующей о соответствии медицинского изделия требованиям применимых директив ЕС.
<b>Символ:</b>	<b>Название символа:</b>	Выполняйте указания руководства пользователя.
	<b>Описание:</b>	Указывает на необходимость соблюдения указаний в руководстве по эксплуатации.
<b>Символ:</b>	<b>Название символа:</b>	№ для заказа
	<b>Описание:</b>	Указывает на номер для заказа, по которому производитель может идентифицировать медицинское изделие.
<b>Символ:</b>	<b>Название символа:</b>	Серийный номер
	<b>Описание:</b>	Указывает на серийный номер, по которому производитель может идентифицировать конкретное медицинское изделие.
<b>Символ:</b>	<b>Название символа:</b>	Хрупкое, обращаться осторожно
	<b>Описание:</b>	Указывает на медицинское изделие, которое при ненадлежащем обращении может быть сломано или повреждено.
<b>Символ:</b>	<b>Название символа:</b>	Хранить в сухом виде
	<b>Описание:</b>	Обозначает медицинское изделие, которое необходимо защищать от влаги.
<b>Символ:</b>	<b>Название символа:</b>	Верх
	<b>Описание:</b>	Показывает правильное вертикальное положение части оборудования.
<b>Символ:</b>	<b>Название символа:</b>	Не складывать друг на друга
	<b>Описание:</b>	Складывать друг на друга можно не более 2 упаковок.

**Символ:****Название символа:****Описание:**


Ограничение температуры при транспортировке

Обозначает предельную температуру при транспортировке, которую медицинское изделие может выдержать без риска быть поврежденным.

**Символ:****Название символа:****Описание:**

Ограничение температуры при хранении

Обозначает предельную температуру при хранении, которую медицинское изделие может выдержать без риска быть поврежденным.

**Символ:****Название символа:****Описание:**

Ограничение влажности воздуха при транспортировке и хранении

Обозначает диапазон влажности при транспортировке и хранении, которую медицинское изделие может выдержать без риска быть поврежденным.

**Символ:****Название символа:****Описание:**

Индикатор наклона

Индикатор Tip-n-Tell служит для контроля выполнения требований при перевозке и хранении груза. Начиная с наклона в 60°, синий кварцевый песок персыпается в поле индикации в виде стрелки и остается там.

Ненадлежащее обращение с перевозимым грузом сразу становится заметным и может быть неоспоримо доказано.

**Символ:****Название символа:****Описание:**

Индикатор удара Shockdot

Встроенный в систему Shockwatch индикатор Shockdot показывает удары и толчки, сила которых находится за пределами допустимого, изменяя свой цвет на красный. Превышение определенного значения ускорения (g) вызывает изменение цвета трубки индикатора.

**Символ:****Название символа:****Описание:**

Переработка

Указывает позицию, которая может быть переработана при наличии подходящих мощностей.

**Символ:****Название символа:****Описание:**

Знак соответствия нормативным документам (RCM)

Знак соответствия нормативным документам (RCM)

свидетельствует о соответствии устройства применимым техническим стандартам АСМА Австралии и Новой Зеландии - то есть стандартам теле- и радиокоммуникации, ЭМС и ЭМЭ.

**1.2 Тип прибора**

Все приведенные в данном руководстве по эксплуатации данные относятся только к прибору, тип которого указан на титульном листе. Заводская табличка с серийным номером закреплена на задней стороне прибора.

**1.3 Информация**

При обращении за консультациями необходимо правильно указать следующие данные:

- Тип прибора
- Серийный номер

**1.4 Группа пользователей**

К работе с прибором должны допускаться только обученные сотрудники лаборатории VT1000 S. Прибор предназначен только для профессионального применения.

Начинать работу с прибором можно только после внимательного изучения данного руководства по эксплуатации и ознакомления со всеми техническими особенностями прибора.

**1.5 Использование по назначению/недопустимое использование**

Прибор VT1000 S предназначен для получения срезов для таких областей как медицина, биология, а также для промышленного применения, в частности, для срезов образцов фиксированных и нефиксированных живых тканей в буферном растворе.

**Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям**

Прибор VT1000 S разрешается использовать исключительно в исследовательских целях. Срезы, получаемые с помощью VT1000 S, НЕЛЬЗЯ использовать для диагностики!

Использование прибора должно осуществляться только в соответствии с указаниями настоящего руководства пользователя.

Любое другое использование прибора является недопустимым.

## 2. Безопасность



### Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям

Обязательно соблюдайте правила техники безопасности и предупреждения об опасности, приведенные в этой главе.

Прочтите их даже в том случае, если вы уже имеете навыки обращения с прибором Leica и правилами его эксплуатации.

### 2.1 Указания по технике безопасности

В этом руководстве по эксплуатации содержатся важные указания и сведения, относящиеся к эксплуатационной надежности и ремонту прибора.

Оно является существенной составной частью прибора, должно быть внимательно изучено перед началом эксплуатации прибора и храниться рядом с ним.

Данный прибор изготовлен и проверен в соответствии с правилами безопасности для электрических измерительных, регулирующих и лабораторных приборов.

Для поддержания такого состояния и обеспечения безопасной эксплуатации пользователь обязан выполнять все указания и предупреждения, содержащиеся в настоящем руководстве пользователя.

Последнюю информацию о сертификате соответствия ЕС можно найти на сайте: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



### Указание

Руководство по эксплуатации должно быть дополнено соответствующими указаниями, если это необходимо согласно действующим региональным предписаниям по предотвращению несчастных случаев и охране окружающей среды в стране эксплуатации.



### Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям

Запрещается снимать или модифицировать защитные приспособления, имеющиеся на приборе и принадлежностях. Открывать и ремонтировать прибор разрешается только специалистам, авторизованным компанией Leica.

### 2.2 Предупреждения об опасности

Защитные приспособления, установленные изготовителем на данном приборе, являются лишь основой защиты от несчастных случаев. Основную ответственность за безаварийный рабочий процесс несет прежде всего владелец предприятия, в котором эксплуатируется прибор, а также назначенные им лица, эксплуатирующие, обслуживающие или чистящие прибор.

Для обеспечения безуокоризненной работы прибора необходимо соблюдать следующие указания и предупреждения.

### 2.3 Предписания по технике безопасности при обращении с прибором

#### Опасность



**Важно**

опасность травмирования при контакте с острым ножом/лезвием!



**Важно**

опасность инфицирования при работе с живыми тканями!



**Важно**

опасность возникновения пожара в связи с неприкрытым лупой!



**Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям**

Надлежащий образ действий

#### **Будьте очень осторожны при обращении с лезвиями или ножами!**

- Держите ножи так, чтобы исключить возможность травмирования о режущую кромку!
- Ножи и снятые держатели ножей с зажатыми ножами/лезвиями не должны лежать открытыми!
- Необходимо принять необходимые защитные меры, чтобы предотвратить опасность инфицирования!
- Необходимо надевать защитную одежду в соответствии с директивой "Работа с опасными для здоровья веществами" (лицевая маска, перчатки, одежда)!
- Во время рабочих перерывов прикрывайте лупу.
- При обращении с лупой возможен эффект зажигательного стекла.
- Красный **АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ** (справа на приборе) может быть задействован в экстренном случае путем нажатия. Его блокировка осуществляется путем поворота в направлении стрелки.
- Прибор разрешается открывать только авторизованным сотрудникам сервисной службы.
- Перед тем как открыть прибор, всегда вынимайте вилку из розетки.

### 3. Свойства прибора

#### 3.1 Технические характеристики

##### Общие характеристики

Частота резания ( $\pm 10\%$ )	0–100 Гц
амплитуды	5-ступенчатая регулировка: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 мм
Скорость резания ( $\pm 10\%$ )	0,025–2,5 мм/с
Скорость обратного хода ( $\pm 10\%$ )	5 мм/с
общий вертикальный подъем	15 мм (с электроприводом)
Диапазон резки	1–40 мм (с возможностью регулировки)
Ретракция	0–999 $\mu$ м (с возможностью регулировки и деактивизации)
Максимальный размер образца:	
со стандартным держателем ножа	33 x 40 мм
Устройство ориентации образца	330°
Настройка толщины среза	1–999 $\mu$ м, с шагом 1 $\mu$ м
Лупа, в сборе (стандартные принадлежности сконфигурированного прибора)	2-кратное увеличение

##### Условия окружающей среды

Диапазон рабочих температур	мин.5°C – макс.40°C
Относительная влажность воздуха	макс.80 %
Высота	до 2000 м над уровнем моря

##### Электрические параметры

Диапазон номинального напряжения ( $\pm 10\%$ )	100 В - 240 В
Номинальная частота ( $\pm 10\%$ )	50 - 60 Гц
Потребляемая мощность	50 ВА
Предохранители электросети	T 1.25 A
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II
Задача от электрической перегрузки	да
Внутреннее ограничение тока для электронных компонентов	да

##### Размеры

Д x Ш x В	480 мм x 360 мм x 200 мм
Высота с держателем лупы	285 мм
Масса:	
без держателя лупы	17 кг
только держатель лупы	2 кг
общая масса	19 кг

### 3 Свойства прибора

#### 3.2 Общий вид - VT1000 S

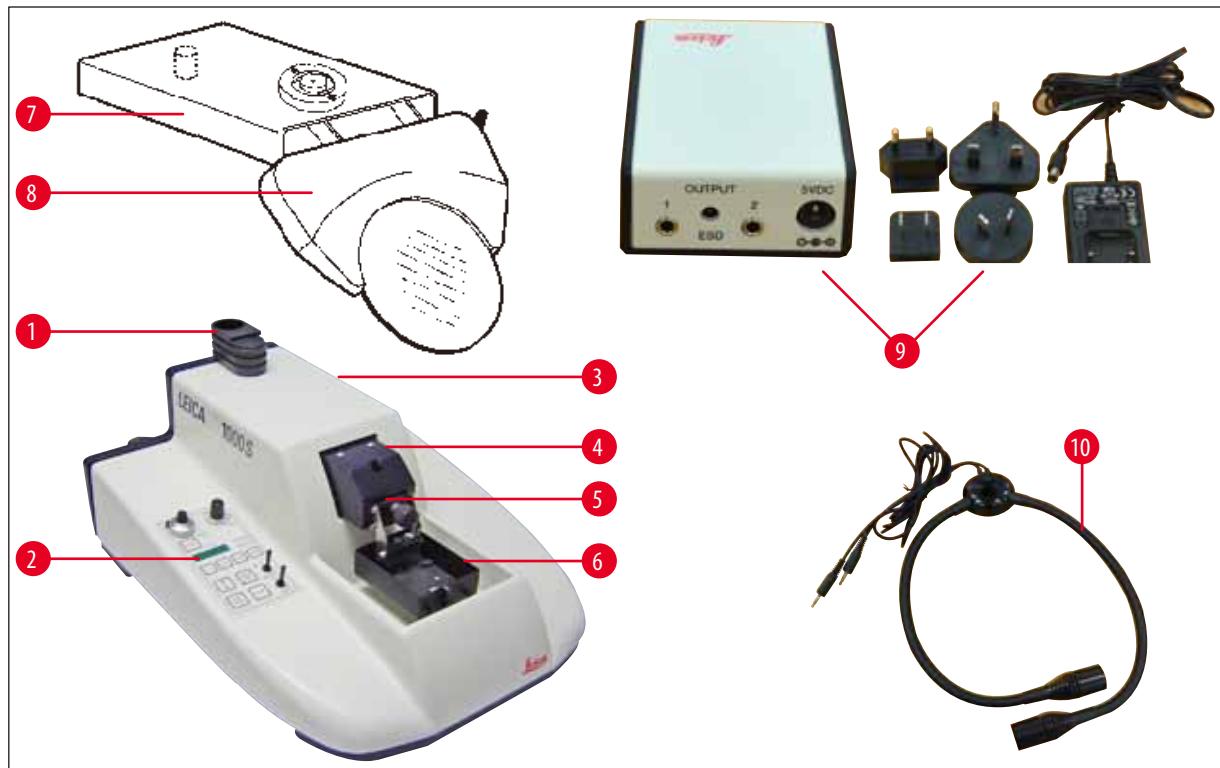


Рис. 1

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1 Крепление держателя лупы      | 6 Буферный поддон S   |
| 2 Панель управления             | 7 Держатель лупы  |
| 3 Аварийный выключатель (скрыт) | 8 Лупа  |
| 4 Режущая головка               | 9 Модуль высокомощного светодиодного спота 1000 (опция)         |
| 5 Держатель ножа                | 10 Модуль высокомощных светодиодных спотов, с 2 ножками (опция) |

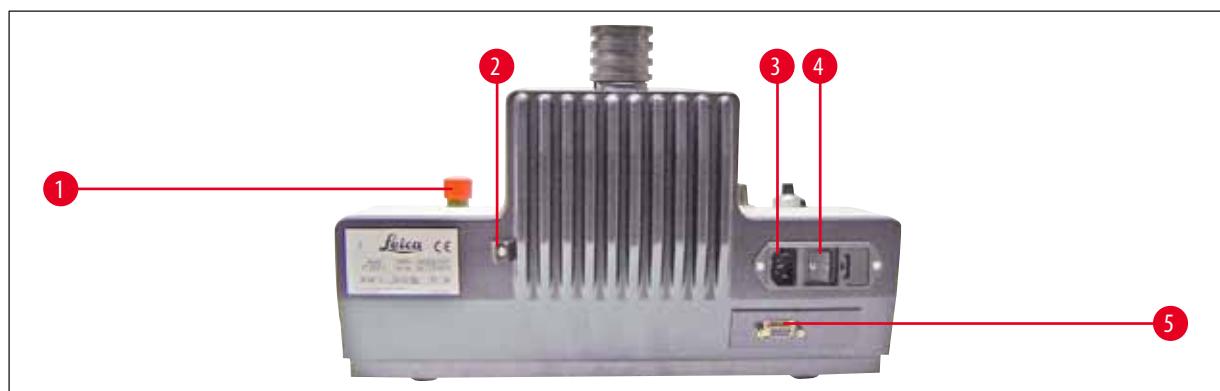


Рис. 2

- |  |  |
|--|--|
| 1 Аварийный выключатель                  | 3 Разъем для сетевого кабеля                   |
| 2 Зажимное крепление для сливного шланга | 4 Сетевой выключатель                          |
|  | 5 Разъем для ножного переключателя, 9-полюсный |

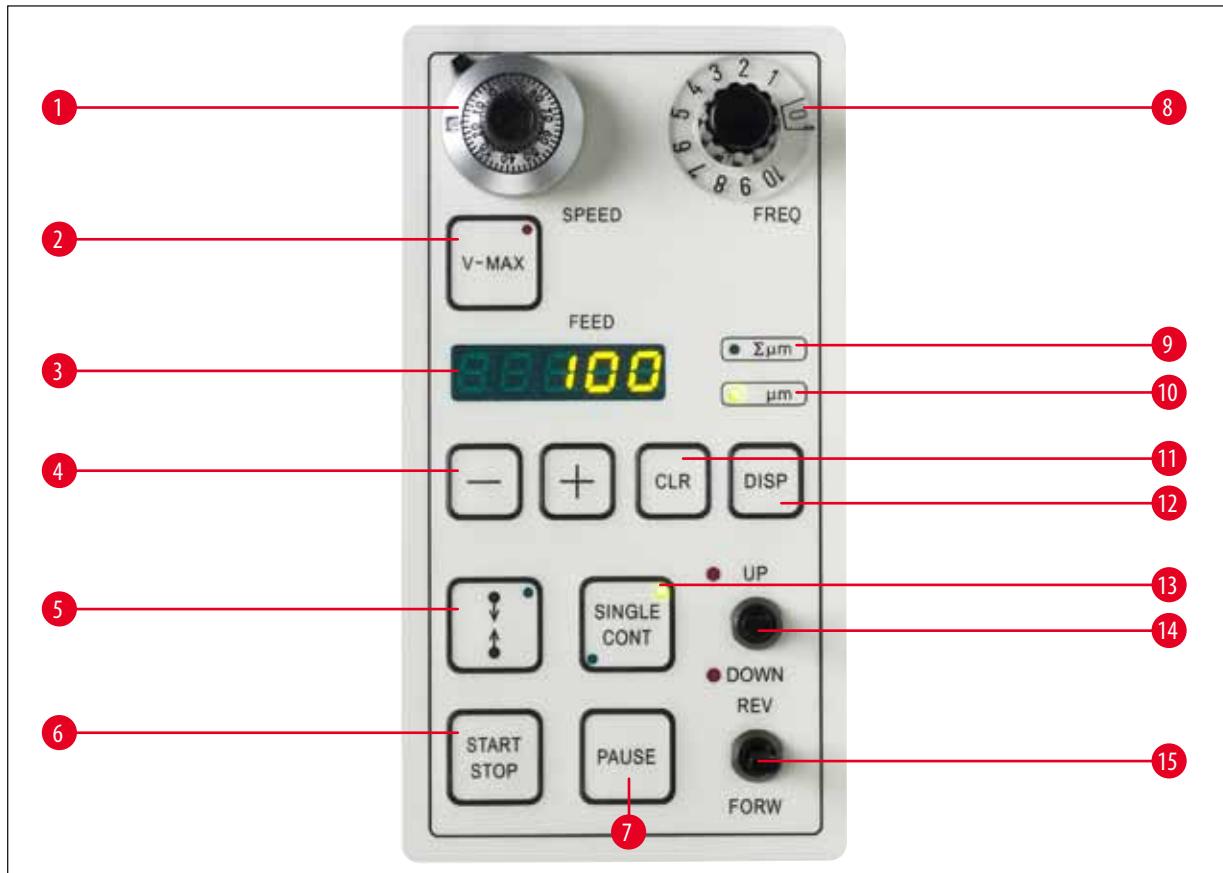


Рис. 3

- |          |   |           |  |
|----------|---|-----------|--|
| <b>1</b> | Поворотная ручка для регулировки скорости резания   | <b>8</b>  | Поворотная ручка для регулировки частоты резания   |
| <b>2</b> | Клавиши для регулировки максимальной скорости подачи  | <b>9</b>  | Светодиоды для индикации режима: "Дополнительная толщина среза"  |
| <b>3</b> | Индикация выбранной толщины среза или дополнительной толщины среза в $\mu\text{m}$            | <b>10</b> | Светодиоды для индикации режима: "толщина среза"   |
| <b>4</b> | Клавиши настройки толщины среза +/- (1–999 $\mu\text{m}$ ), настройка ретракции или громкости | <b>11</b> | Клавиша CLEAR (CLR)  |
| <b>5</b> | Кнопка для регулировки устанавливает ограничение для окна резки.                              | <b>12</b> | Клавиша для программирования (DISP)  |
| <b>6</b> | Кнопка запуска для одиночного хода/непрерывного хода  | <b>13</b> | Клавиша переключения "Одиночный ход/непрерывный ход" (выбор отображается с помощью светодиодов)                                |
| <b>7</b> | Клавиша PAUSE   | <b>14</b> | Перекидной переключатель/кнопка "Регулировка высоты буферного поддона" (конечные положения отображаются с помощью светодиодов) |
|          |   | <b>15</b> | Перекидной переключатель/кнопка для движения ножа вперед-назад   |

## 4. Установка

### 4.1 Стандартный комплект поставки

Кол-во	Название	№ для заказа
	Базовый прибор	14 0472 35612
1	силиконовый шланг	14 0462 27513
1	комплект запасных предохранителей, 2 x T 1,25 A	14 6943 01251
1	набор инструментов:	
1	ключ для болтов с внутренним шестигранником, SW 2.5	14 0194 13195
1	ключ для болтов с внутренним шестигранником, SW 8.0	14 0194 04792
1	манипулятор	14 0462 28930
1	пылезащитный кожух	14 0212 04091
1	Руководство по эксплуатации, печатное (английский язык, компакт-диск с версиями на других языках 14 0472 80200)	14 0472 80001
<b>VT1000 S Полная конфигурация</b>		<b>14 0472 35613</b>
	VT1000 S Базовый прибор	14 0472 35612
	диска для образцов S, не ориентируемые	14 0463 27404
	Буферный поддон S	14 0462 30132
5	винтов с потайной головкой M	14 2101 77121
2	Шланговый зажим	14 0481 41952
	Держатель ножа S, для инжекторных и бритвенных лезвий	14 0462 30131
	Штифтовой ключ под шестигранник с рукояткой, SW 3	14 0194 04764
1	флакон с цианакрилатным kleem	14 0371 27414
	Лупа в сборе (Держатель лупы и лупа, в сборе)	14 0462 31191

Кабель питания с особенностями для конкретной страны необходимо заказывать отдельно. Вы можете найти список кабелей питания для своего устройства на нашем сайте [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com) в разделе продукции.



#### Указание

При заказе других принадлежностей сравните поставленный комплект с вашим заказом. При обнаружении расхождений сразу же обратитесь к своему дилеру.

#### 4.2 Распаковка и установка прибора



##### Указание

Упаковка содержит два индикатора, фиксирующих нарушение правил транспортировки: ShockDot Impact Indicator и Tilt Indicator. При получении прибора следует сначала проверить эти индикаторы. Если индикаторы сработали, транспортировка выполнялась с нарушениями. Отметьте это в сопроводительной документации и проверьте наличие возможных повреждений на грузе.



Рис. 4

- Снимите упаковочную и клейкую ленты ([→ Рис. 4-1](#)).
- Снимите картонную крышку с упаковки ([→ Рис. 4-2](#)).
- Достаньте коробку с принадлежностями ([→ Рис. 4-3](#)).
- Возьмите ключ с внутренним шестигранником № 8 из коробки с принадлежностями и отложите в сторону — он пригодится позднее.
- Выньте фиксирующую картонную перемычку ([→ Рис. 4-4](#)).
- Удалите внешнюю стенку коробки ([→ Рис. 4-5](#)).
- Извлеките прибор из коробки с помощью ремней для переноски ([→ Рис. 4-6](#)) и установите на подходящем прочном лабораторном столе.

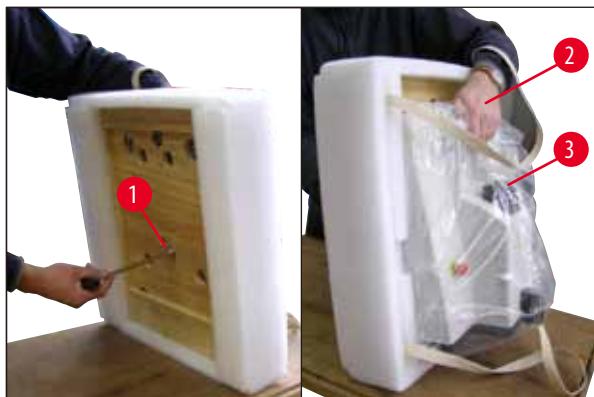


Рис. 5

- Слегка наклоните прибор вместе с основанием ([→ Рис. 5](#)), удерживая одной рукой за выемку ([→ Рис. 5-2](#)) буферного поддона! НИКОГДА не поднимайте и не удерживайте прибор за режущую головку ([→ Рис. 5-3](#))!! Ослабьте винт ([→ Рис. 5-1](#)) с помощью входящего в комплект поставки ключа под шестигранник SW 8 и снимите основание.



Рис. 6

- Возьмитесь за прибор сбоку ([→ Рис. 6](#)) обеими руками и осторожно поставьте на лабораторный стол.

**Указание**

Сравните комплектность поставки с упаковочным перечнем.

**Указание**

Сохраните транспортировочную упаковку и сопутствующие элементы крепления на случай возможного возврата.  
Для возврата прибора выполните указания по распаковке в обратной последовательности.

### Монтаж сливного шланга

- Нижняя сторона прибора ([Рис. 7](#))
- Подсоедините сливной шланг ([Рис. 7](#)) к нижней стороне прибора ([Рис. 7-1](#)).
- Следите за тем, чтобы свободный конец сливного шланга был надежно закрыт соответствующей заглушкой.
- Закрепите свободный конец сливного шланга в креплении на задней панели прибора ([Рис. 7-2](#)).

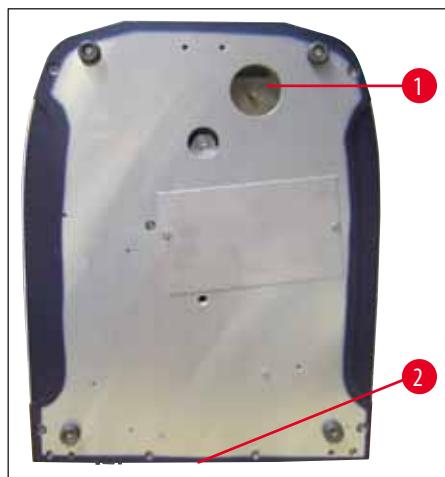


Рис. 7

### Монтаж держателя лупы и ножного переключателя (опция)

- Держатель лупы ([Рис. 8-1](#)) упакован отдельно.
- Установите на прибор, как показано на рис ([Рис. 8](#)).
- Выполните подключение ножного переключателя (опция).
- Соедините ножной переключатель с 9-полюсным разъемом ([Рис. 8-2](#)).

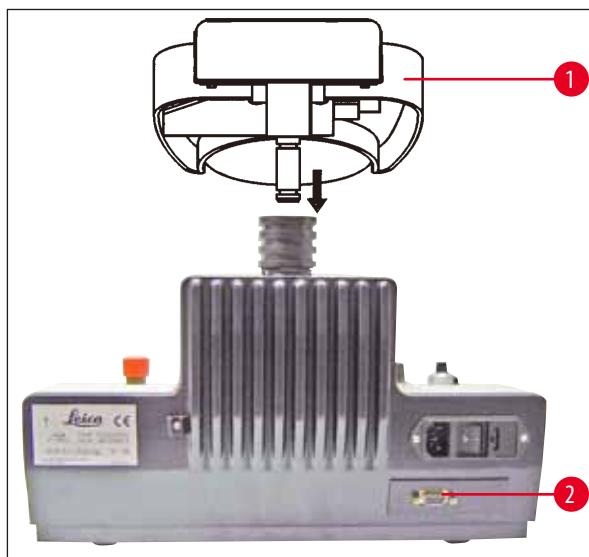


Рис. 8



#### Указание

Транспортировка прибора должна ВСЕГДА осуществляться со снятым держателем лупы!

## 5. Управление

### 5.1 Требования к месту установки

Место установки прибора должно удовлетворять следующим условиям:

- Прибор предназначен только для использования в помещениях.
- Должен быть обеспечен свободный и удобный доступ к сетевой вилке.
- Розетка в пределах длины сетевого кабеля (3 м) – запрещается использовать удлинители.
- Необходимо предусмотреть ровное место установки.
- Требуется максимально стабильное основание.
- Относительная влажность воздуха должна быть не более 80 %,
- Температура воздуха в помещении от +5 °C до +40 °C,
- Необходимо избегать тряски, прямых солнечных лучей и сильных колебаний температуры!



#### Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям

Запрещается эксплуатация во взрывоопасной среде!



#### Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям

Прибор ДОЛЖЕН подключаться к заземленной розетке. Можно использовать только прилагаемый сетевой кабель, предназначенный для питания от местной электросети.

### 5.2 Перед вводом прибора в эксплуатацию



#### Указание

Прибор ДОЛЖЕН подключаться к заземленной розетке. Можно использовать только прилагаемый сетевой кабель, предназначенный для питания от местной электросети.



#### Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям

Прибор ДОЛЖЕН быть установлен таким образом, чтобы к сетевой вилке/устройству отсоединения от сети в любое время мог быть обеспечен свободный и удобный доступ!



#### Указание

Прибор VT1000 S оснащен сетевым блоком питания с широким диапазоном входного напряжения (100–240 В).

После включения главного выключания выполняется инициализация прибора: после короткого движения вперед нож перемещается обратно в заднее исходное положение.

1. Установите сетевой выключатель на задней стороне прибора в положение **ВЫКЛ.**
2. Проверьте правильность подключения сетевого кабеля прибора.
3. Установите держатель лупы.
4. Установите буферный поддон.
5. Установите держатель ножа.
6. Установите нож в держатель ножа.
7. Подсоедините держатель увеличителя с модулем высокомощных светодиодных спотов с 2 ножками, как показано на ([→ Рис. 9](#)). Установите заглушку ([→ Рис. 9-1](#)) модуля высокомощных светодиодных спотов с 2 ножками в гнездо ([→ Рис. 9-2](#)) на модуле высокомощного светодиодного спота 1000.

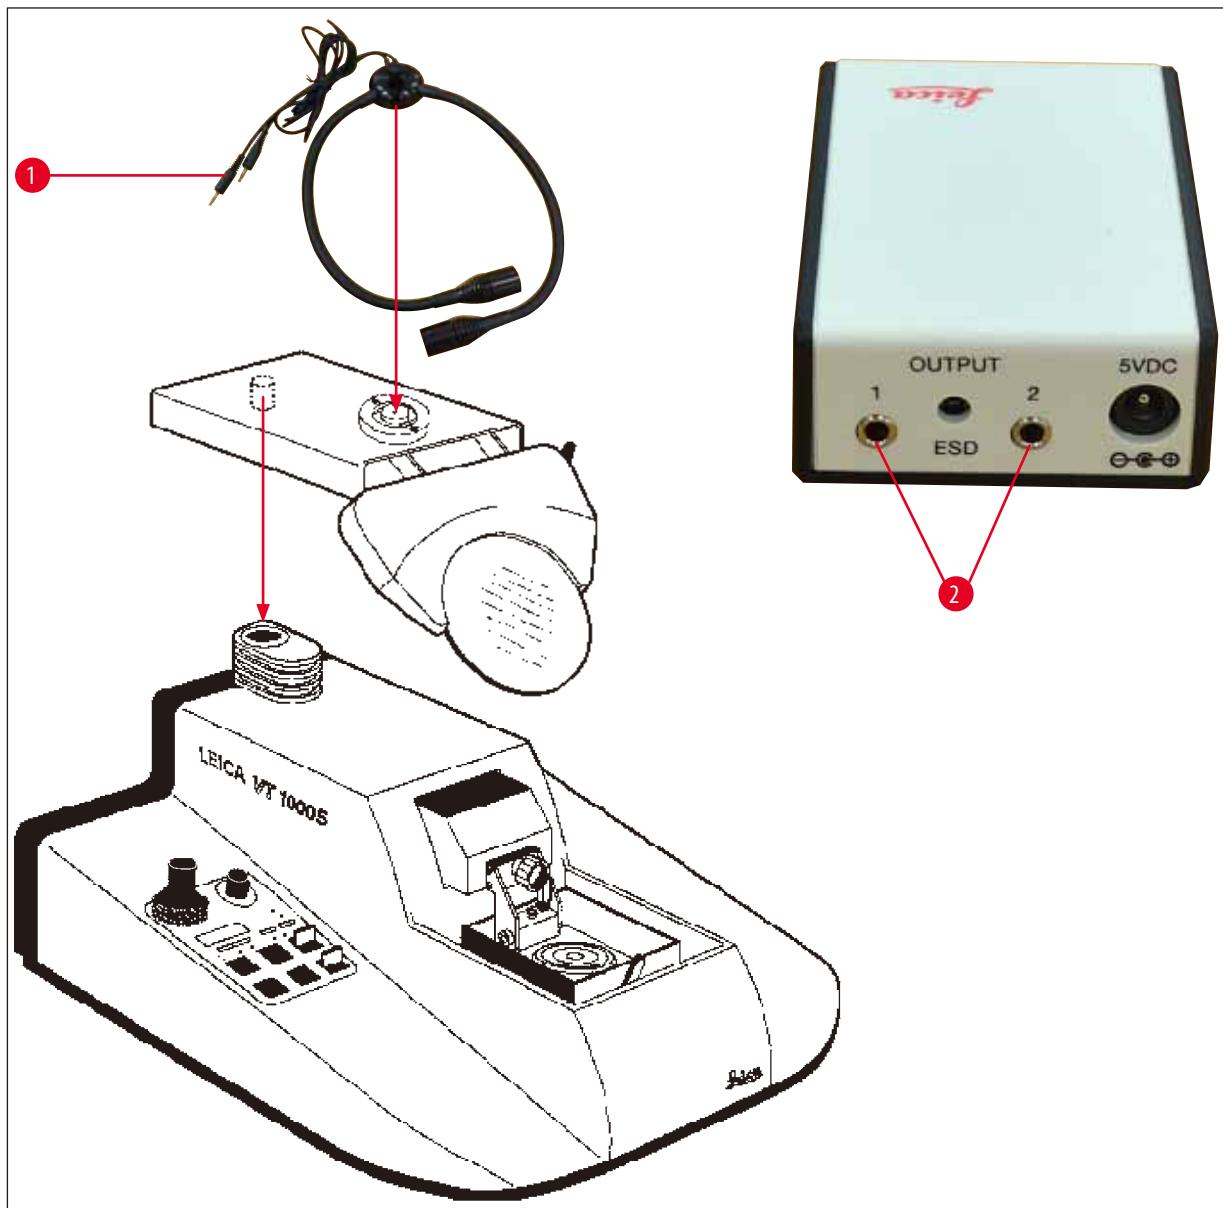


Рис. 9

8. Подсоедините ножной переключатель (опция) с задней стороны прибора.
9. Вставьте сетевой кабель в розетку.
10. Включите прибор с помощью сетевого выключателя.

### 5.3 Органы управления и принципы их функционирования – VT1000 S



#### Важно

ознакомление с функциями клавиш должно выполняться без держателя ножа. Используйте держатель ножа только после того как полностью ознакомитесь со всеми функциями клавиш.



Рис. 10

#### SPEED

##### Установка шкалы мм/с

0	0.00	Непрерывная регулировка подачи ножа от 0,05 до 2,5 мм/с:
0,5	0,025	
1	0,050	Скорость обратного хода ножа постоянно составляет 5 мм/с.
2	0,075	
3	0,125	Дополнительный стопорный рычаг предотвращает нежелательное смещение (→ Рис. 10-1) (рычаг в положении "12 часов") подачи ножа в процессе резания
4	0,175	
5	0,225	
6	0,40	
7	0,65	
8	0,90	
9	1,30	
10	2,50	



Рис. 11

#### FREQ

##### Установка шкалы Гц

0	0	Поворотная кнопка со шкалой 0–10
0,5	8	Назначение:
1	10	Непрерывная настройка частоты резания (вибрация)
2	20	ножа от 8 Гц до 100 Гц.
3	30	
4	40	
5	50	
6	60	
7	70	
8	80	
9	90	
10	100	



**Клавиша со светодиодной индикацией**

#### Назначение:

- При задействовании клавиши **V-Max** в ручном режиме (светодиод горит красным) и клавиши **REV/FORW** осуществляется подача ножа к образцу с максимальной скоростью.
- При задействовании клавиши **START** светодиод клавиши **V-Max** гаснет. Процесс резания начинается с установленной ранее скоростью.

#### Регулировка окна резки:



**Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям**

Если случайно установлено лишь ограничение для окна резки, нож проходит весь диапазон резки!



**Клавиша со светодиодной индикацией**

- Активируйте клавишу **V-Max**. выполните быстрое перемещение к образцу с помощью клавиши **REV/FORW**. выполните дальнейшее быстрое перемещение от образца и установите вторую границу окна резки нажатием клавиши
- Повторным нажатием клавиши **REV/FORW** выполните дальнейшее быстрое перемещение от образца и установите вторую границу окна резки нажатием клавиши
- После нажатия клавиши **START** клавиша **V-Max** деактивизируется. Нож возвращается к первой границе окна резки и медленно выполняет дальнейшее резание с предварительно установленной скоростью (10-ступенчатый поворотный потенциометр).



#### Назначение:

- Запуск выполнения одиночного среза или непрерывного резания в зависимости от предварительной настройки (см. описание функционирования **SINGLE/CONT**) (→ С. 22 – Светодиодная индикация с клавишами регулировки **-/+**, функциональные клавиши **CLR** и **DISP**).
- Подача (толщина среза) осуществляется перед образцом.
- Подача при ретракции (опускание образца) осуществляется при достижении ножом задней точки возврата.
- При выборе **ОДИНОЧНОГО** среза нож автоматически останавливается в конечном заднем положении.
- При **НЕПРЕРЫВНОМ** резании клавиша **START/STOP** активизирует завершение режима резания. Нож останавливается в конечном заднем положении.
- Начатый процесс резания осуществляется до конца.



#### Назначение:

немедленное прерывание движения ножа.

- Возобновление работы нажатием клавиши **PAUSE**.



Рис. 12

**Перекидной переключатель/кнопка****Назначение:**

для подвода ножа к образцу.

Также может использоваться для ручного управления резанием.

Движение **FORW** в целях безопасности осуществляется при задействовании клавиш; Движение **REV** является фиксируемым.

Для остановки движения **REV** до достижения конечного заднего положения вручную переведите переключатель в среднее положение.

Клавиша **REV/FORW** может также служить для прерывания начатого после задействования клавиши **START/STOP** процесса резания.



Рис. 13

**Светодиодная индикация с клавишами регулировки **-/+**, функциональные клавиши CLR и DISP****Назначение светодиодной индикации:**

отображение установленной толщины среза или дополнительной толщины среза.

**Назначение клавиши **-/+**:**

регулировка толщины среза шагом 1  $\mu\text{м}$  от 0  $\mu\text{м}$  до 999  $\mu\text{м}$ .

Подача образца (с предварительно установленной толщиной среза) осуществляется в начале процесса резания.

**Назначение клавиши DISP:**

выбор одного из двух режимов нажатием клавиши:

" $\Sigma\mu\text{м}$ " = дополнительная толщина среза

" $\mu\text{м}$ " = толщина среза

**Назначение клавиши CLR в режиме дополнительной толщины среза:**

обнуление значения дополнительной толщины среза ( $\Sigma\mu\text{м}$ ) нажатием клавиши.



**Клавиша со светодиодной индикацией**

#### Назначение:

Переключение между:

- одиночным ходом (1 подача ножа/1 обратный ход ножа) и непрерывным ходом(непрерывное резание вплоть до задействования клавиши **START/STOP**).
- Для остановки ножа в конечном заднем положении в режиме **CONT** требуется нажатие клавиши **START/STOP**.
- Начатый процесс резания выполняется до конца, после чего нож останавливается в установленном конечном положении в диапазоне резки.



Рис. 14

#### Перекидной переключатель/кнопка

##### Назначение:

- регулировка высота буферного поддона с помощью электропривода. Максимальная высота: 15 мм (= общий вертикальный подъем).

Оповещение о верхнем и нижнем конечных положениях осуществляется с помощью красного светодиода и звукового сигнала.

При выполняемом движении ножа функция **ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ** заблокирована.

Движение **DOWN** выполняется с помощью кулисного переключателя и является фиксируемым; движение **UP** осуществляется при нажатии и удерживании переключателя в положении **UP**.

Если при фиксируемом кулисном переключателе достигается нижнее конечное положение **DOWN**, это сопровождается визуальным и звуковым сигналом.

После разблокировки клавиши буферный поддон автоматически поднимается вплоть до исчезновения сигнала.

- Настройка значения ретракции или деактивизации ретракции, а также регулировка громкости звукового сигнала VT1000 S осуществляются с помощью следующих комбинаций клавиш:



Рис. 15

#### Регулировка громкости:

- Выберите режим толщины среза (" $\mu\text{m}$ ") клавишой **DISP**.
- Одновременно нажмите клавиши **CLR** и **+**. Индикация на дисплее: "BE 15". Значение можно изменить клавишой **-/+**.
- При выборе значения "0" звуковой сигнал выключается.
- Покиньте режим программирования, нажав клавишу **CLR**.



Рис. 16

### Регулировка обратного хода

- Нажмите клавишу **DISP** в режиме программирования и вызовите меню ретракции образца.
- Индикация на дисплее: "LO".
- Клавишей **-/+** установите значение ретракции образца в диапазоне от 1 мкм до 999 мкм или выберите "0" для деактивизации.
- Выбранное значение отображается в окне FEED.
- Нажмите клавишу **CLR** чтобы покинуть функцию меню.

#### 5.4 Регулировка амплитуды

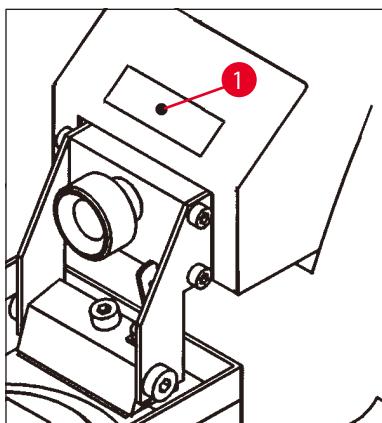


Рис. 17

- Для достижения оптимального результата резания выберите соответствующую образцу амплитуду.

Для этого:

- Ослабьте установочный винт ([→ Рис. 17-1](#)) для текущей выбранной амплитуды с помощью ключа под внутренний шестигранник 2,5 мм и вручную зафиксируйте на нижней стороне эксцентрик.  
Положения амплитуды слева направо:  
0,2 мм; 0,4 мм; 0,6 мм; 0,8 мм; 1 мм.
- Переместите винт к требуемому положению амплитуды и затяните.



#### Указание

Ослабьте установочный винт, но не выворачивайте его полностью.

В состоянии поставки амплитуда настроена на 0,6 мм.

#### 5.5 Ежедневная работа с VT1000 S

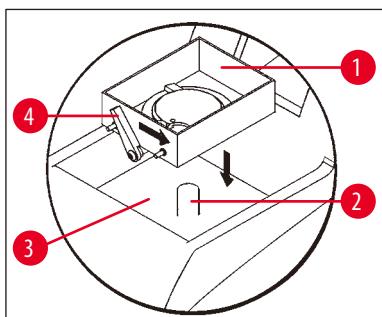


Рис. 18

- Установите буферный поддон ([→ Рис. 18-1](#)) на цапфу ([→ Рис. 18-2](#)) в емкости ([→ Рис. 18-3](#)).
- Зажмите буферный поддон, отведя зажимной рычаг ([→ Рис. 18-4](#)) вправо (в направлении стрелки).
- Клавишей **UP/DOWN** опустите буферный поддон до крайнего нижнего положения (раздается звуковой сигнал и загорается красный светодиод).
- Установите выключатель в среднее положение, звуковой сигнал прекращается.
- При необходимости наполните емкость ([→ Рис. 18-3](#)) кусочками льда.
- Наполните буферный поддон ([→ Рис. 18-1](#)) охлажденным буферным раствором.

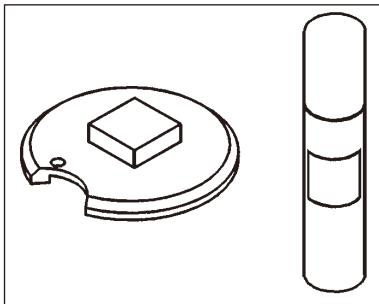


Рис. 19

- Закрепите образец с помощью цианакрилатного клея на диске для образцов ([→ Рис. 19](#)).

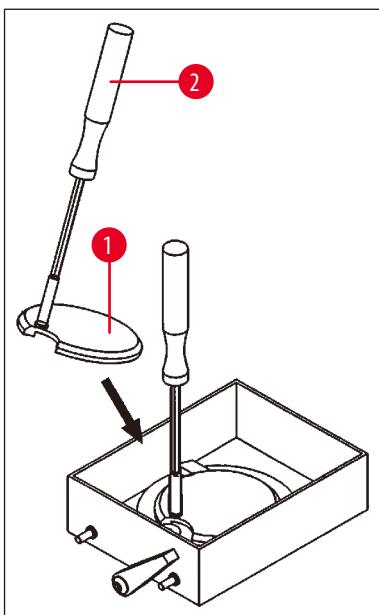


Рис. 20

- Установите диск для образцов ([→ Рис. 20-1](#)) с образцом с помощью манипулятора ([→ Рис. 20-2](#)) в буферный поддон.

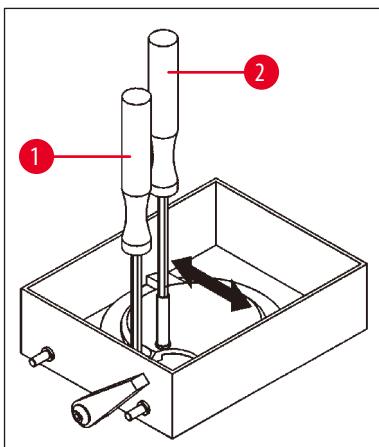


Рис. 21

- Поверните диск для образцов с помощью манипулятора ([→ Рис. 21-2](#))  
Закрутите, используя ключ под внутренний шестигранник, SW 3 ([→ Рис. 21-1](#)).
- Зажимной винт или зажимные элементы не должны находиться над выемкой на диске для образцов, поскольку в данном положении зажим невозможен.
- Удалите манипулятор ([→ Рис. 21-2](#)).

### Регулировка угла наклона ножа

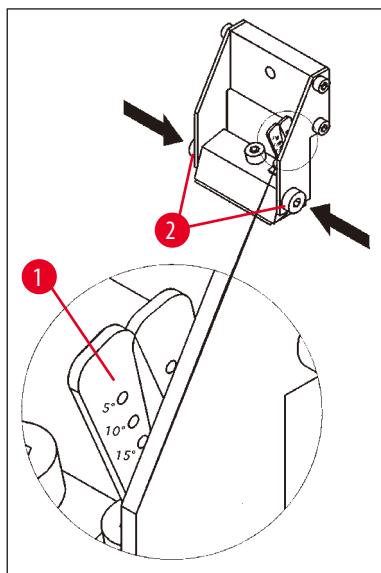


Рис. 22

- Выполните регулировку (→ Рис. 22-1) на держателе ножа.

Для этого:

- Ослабьте оба винта (→ Рис. 22-2) (ключ под внутренний шестигранник, SW 3).
- Отрегулируйте требуемый угол наклона с помощью регулировочного рычага (→ Рис. 17-1).
- Задокументируйте отрегулированный угол наклона винтом (→ Рис. 22-2).



### Указание

При использовании прибора VT1000 S регулировка угла наклона ножа после каждой замены ножа не требуется.  
Регулировка требуется только при изменении цели использования (например, другой вид ткани).

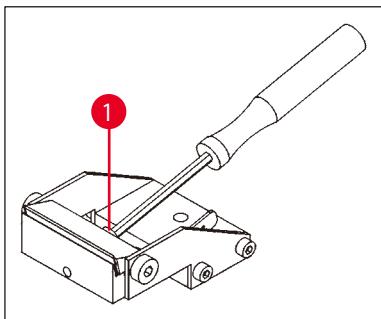


Рис. 23

- Для установки лезвия ослабьте зажимной винт (→ Рис. 23-1) на держателе ножа.
- Очистите лезвие.

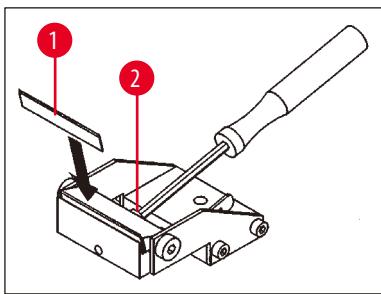


Рис. 24

- Установите лезвие в держатель ножа (→ Рис. 24-1).
- Зажмите лезвие с помощью зажимного винта (→ Рис. 24-2).



### Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям

Лезвие должно по всей длине прилегать к внутреннему упору держателя ножа.

Оно должно быть зажато параллельно передней кромке обеих зажимных колодок держателя ножа.

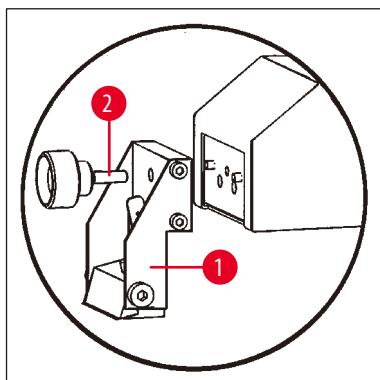


Рис. 25

- Зафиксируйте держатель ножа ([→ Рис. 25-1](#)) с помощью зажимного винта ([→ Рис. 25-2](#)) на держателе ножа.
- С помощью кулисного переключателя **REV/FORW** переместите лезвие к заднему краю образца (если смотреть со стороны пользователя).
- Задействуйте кулисный переключатель **UP/DOWN** в направлении UP, и удерживайте его нажатым до тех пор, пока поверхность образца не будет находиться точно под режущей кромкой лезвия (см. стрелку ([→ Рис. 26-1](#))).

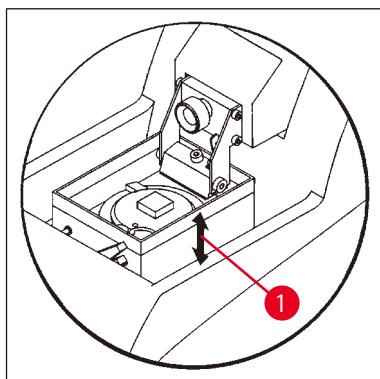


Рис. 26

- Предварительно выберите скорость и частоту резки с помощью поворотных рукояток **SPEED** или **FREQ**.
- Клавишами **+-** предварительно выберите толщину среза для процесса надрезания (тримминга).
- Предварительно выберите соответствующий размеру образца диапазон резки с помощью клавиши **SECTIONING WINDOW** (окно резки).
- Установите селекционный переключатель **SINGLE/CONT** на **CONT**.  
Задействуйте клавишу **START/STOP**.  
Вплоть до повторного нажатия клавиши **START/STOP** прибор непрерывно выполняет срезы с образца с учетом предварительно выбранной толщины среза.
- После достижения требуемого уровня резания клавишой **+-** установите требуемую толщину среза для снятия среза.

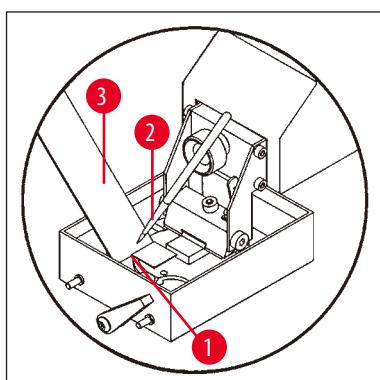


Рис. 27

- Выполнение среза:
- Установите требуемую толщину среза **+-**.
- Установите клавишу **SINGLE/CONT** на **SINGLE**.
- Задействуйте клавишу **START/STOP**.  
Прибор выполняет срез ([→ Рис. 27-1](#)). Нож по умолчанию остается в конечном положении за образцом (если смотреть со стороны пользователя).
- Препарируйте срез, как показано на рисунке, с помощью кисточки ([→ Рис. 27-2](#)) на предметном стекле ([→ Рис. 27-3](#)).

### 5.6 Ежедневное текущее обслуживание и выключение прибора – VT1000 S

После завершения работы выполните следующие действия:

- Отключите главный выключатель на задней стороне прибора.
- Установите крышку на лупу.
- Снимите держатель ножа.
- Удалите лезвие из держателя ножа и надлежащим образом утилизируйте.
- Снимите диск для образцов и положите на стол плоской стороной.
- Снимите образец с одностороннего лезвия и удалите остатки цианакрилатного клея с диска для образцов.
- Снимите и опорожните буферный поддон. Надлежащим образом утилизируйте содержимое буферного поддона.
- Опорожните емкость со льдом.  
Для этого выньте шланг из крепления на задней стороне прибора и переместите содержимое емкости со льдом в подходящий сосуд. Затем вытрите емкость насухо полотенцем.



#### Важно

Содержимое емкости со льдом может быть засорено вследствие расплескивания буферного раствора.

## 6. Неисправности: значение и устранение



### Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям

При использовании ориентируемого диска для образцов переместите буферный поддон в самое нижнее положение сразу после включения прибора!

Сообщения о неисправностях/ характерные признаки	Причина неисправности	Способ устранения
Столкновение ножа и диска для образцов.	<b>Регулировка угла наклона ножа:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>При угле наклона больше 5° возможно столкновение режущей кромки с диском для образцов.</li> <li>При использовании ориентируемого диска для образцов возможно столкновение режущей кромки с диском для образцов.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переместите диск для образцов соответствующим образом вниз.</li> <li>Переместите диск для образцов соответствующим образом вниз.</li> </ul>
Звучит предупреждающий сигнал. Обратное движение не завершается.	<b>Нарушение функций клавиш - в связи с функцией фиксации переключателя REV/FORW:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>При зафиксированном переключателе <b>REV/FORW</b> прибор выключается с помощью сетевого выключателя на задней стороне прибора и снова включается с помощью сетевого выключателя без разблокировки переключателя <b>REV/FORW</b>.</li> <li>При зафиксированном переключателе <b>REV/FORW</b> прибор остановился после воздействия на аварийный выключатель, затем аварийный переключатель снова разблокировался без соответствующей разблокировки переключателя <b>REV/FORW</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разблокируйте переключатель <b>REV/FORW</b> (установите в среднее положение).</li> <li>Чтобы снова активизировать выполнение обратного движения, повторно задействуйте клавишу <b>REV/FORW</b>.</li> <li>Разблокируйте переключатель <b>REV/FORW</b> (установите в среднее положение).</li> <li>Чтобы снова активизировать выполнение обратного движения, повторно задействуйте клавишу <b>REV/FORW</b> (установите на REV).</li> </ul>

"Сообщения о неисправностях/ характерные признаки"	Причина неисправности	Способ устранения
Звучит предупреждающий сигнал.  Движение вниз не завершается.	<b>Нарушение функций клавиш в связи с функцией фиксации переключателя <u>UP/DOWN</u>:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>При зафиксированном переключателе <u>UP/DOWN</u> прибор выключился с помощью сетевого выключателя на задней стороне прибора, а затем снова включился с помощью сетевого выключателя без разблокировки переключателя <u>UP/DOWN</u>.</li> <li>При зафиксированном переключателе <u>UP/DOWN</u> прибор остановился после воздействия на аварийный выключатель <u>EMERGENCY STOP</u> (ножной или аварийный переключатель), затем аварийный переключатель <u>EMERGENCY STOP</u> снова разблокировался без соответствующей разблокировки переключателя <u>UP/DOWN</u>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разблокируйте переключатель <u>UP/DOWN</u> (установите в среднее положение).</li> <li>Чтобы снова активизировать выполнение движения вниз, повторно задействуйте клавишу <u>UP/DOWN</u> (установите на DOWN).</li> </ul>
Двигатель подачи останавливается.  Уже начатый процесс (движение в процессе резания и др.) немедленно прекращается.	<b>Активирована функция аварийного выключения <u>EMERGENCY STOP</u>.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разблокируйте переключатель <u>UP/DOWN</u> (установите в среднее положение).</li> <li>Чтобы снова активизировать выполнение движения вниз, повторно задействуйте клавишу <u>UP/DOWN</u> (установите на DOWN).</li> </ul>
Выполнение движения буферного поддона вверх или вниз немедленно прекращается.		
О зафиксированном положении переключателя сообщается с помощью звукового предупреждающего сигнала.		
При воздействии любой клавиши прибор реагирует звуковым предупреждающим сигналом.		
В случае срабатывания функции аварийного выключения <u>EMERGENCY STOP</u> прибор не реагирует на воздействие ножного переключателя.		
На дисплее появляется индикация "SP".		

"Сообщения о неисправностях/ характерные признаки"	Причина неисправности	Способ устранения
Звучит предупреждающий сигнал. На дисплее появляется сообщение о неисправности E0.1xx.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заклинивание или неисправность клавиши/клавиш.</li> <li>Неисправность клавиши <u>REV/FORW</u>/функции фиксации <u>/REV</u>.</li> <li>Неисправность клавиши <u>UP/DOWN</u>/функции фиксации <u>DOWN</u>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разблокируйте соответствующую клавишу путем многократного нажатия; при необходимости обратитесь в сервисную службу для устранения неисправности.</li> </ul>
xx – имеют место несколько сообщений о неисправностях, 00 – имеет место только 1 сообщение о неисправности		
На дисплее появляется сообщение о неисправности E0.200.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ошибка подачи.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите прибор; вызовите специалистов сервисной службы.</li> </ul>
На дисплее появляется сообщение о неисправности E0.300	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправность важного электронного компонента.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите прибор; вызовите специалистов сервисной службы.</li> </ul>
На дисплее появляется сообщение о неисправности E0.400.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправен двигатель подачи.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите прибор; вызовите специалистов сервисной службы.</li> </ul>
На дисплее появляется сообщение о неисправности E.05xx.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправны фотоячейки (подача)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите прибор; вызовите специалистов сервисной службы.</li> </ul>
Звучит предупреждающий сигнал. На дисплее появляется сообщение о неисправности E0.600.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправны фотоячейки (подача толщины среза)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите прибор; вызовите специалистов сервисной службы.</li> </ul>
Звучит предупреждающий сигнал. На дисплее появляется сообщение о неисправности E0.700. Данное сообщение отображается в течение прим. 2 секунд.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Программное обеспечение распознает ошибку аппаратуры.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите прибор; вызовите специалистов сервисной службы.</li> </ul>
Звучит предупреждающий сигнал. На дисплее появляется сообщение о неисправности E0.9xx.	<ul style="list-style-type: none"> <li>STM32 Сброс параметров контроллера.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>После перезагрузки прибор можно использовать в стандартном режиме.</li> <li>При возникновении дальнейших проблем звоните в техническую поддержку.</li> </ul>

"Сообщения о неисправностях/ характерные признаки"	Причина неисправности	Способ устранения
Звучит предупреждающий сигнал.  Визуальный сигнал: красный светодиод.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Достигнуто самое верхнее положение подачи образца.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Покиньте верхнее положение (<u>UP</u>/<u>DOWN</u> в направлении <u>DOWN</u>).</li> <li>Установите новый образец на диск для образцов и начните работу сначала.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Достигнуто самое нижнее положение высоты регулировки образца (регулировка высоты образца над буферным поддоном).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>После разблокировки положения <u>DOWN</u> буферный поддон автоматически поднимается до тех пор, пока визуальный или звуковой сигнал не прекратится.</li> </ul>
Звучит предупреждающий сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> <li>С помощью клавиши <u>DOWN</u> предпринята попытка установить значение подачи ниже минимального значения (0 <math>\mu\text{m}</math>) или выше максимального значения (999 <math>\mu\text{m}</math>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отпустите клавишу <u>+</u>/<u>-</u>.</li> </ul>
Звучит предупреждающий сигнал.  (при первом вводе прибора в эксплуатацию или после замены EEPROM)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Предупреждающий сигнал самостоятельно перестает звучать после этапа инициализации.</li> </ul>
Слышны щелчки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Видимые зажимные винты были ослаблены.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Затяните зажимные винты.</li> </ul>



#### Указание

Данные характерные для неисправностей признаки могут возникать время от времени и являются неизбежными, поскольку используемые пользователем зажимные винты не могут быть загерметизированы.



#### Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям

Если после затягивания зажимных винтов щелчки не исчезли, немедленно вызовите специалистов сервисной службы!  
Запрещено использовать прибор в данном состоянии!

## 7. Очистка и техническое обслуживание

### 7.1 Чистка прибора



#### Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям

Перед снятием держателя ножа сначала снимайте нож/лезвие! Неиспользуемые ножи/лезвия всегда храните в ящике для ножей/диспенсеров!

При обращении с чистящими веществами соблюдайте предписания изготовителя по технике безопасности и действующие в вашей стране лабораторные предписания!

Для очистки внешних поверхностей не используйте ксилол или содержащие ацетон или ксилол растворители. Окрашенные поверхности не являются стойкими к ацетону и ксилолу!

При чистке не допускайте попадания жидкости внутрь прибора!

**Перед каждой чисткой выполняйте следующие операции:**

- Выключите прибор и отсоедините сетевой кабель.
- Извлеките лезвие из держателя ножа и вставьте в отсек в нижней части диспенсера.
- Снимите держатель ножа, чтобы выполнить очистку.
- Выньте диск для образцов из буферного поддона и положите на стол плоской стороной. Осторожно снимите образец односторонним лезвием.
- Удалите обрезки пинцетом/кисточкой.
- Извлеките буферный поддон, опорожните и отдельно промойте водой (→ C. 28 – 5.6 Ежедневное текущее обслуживание и выключение прибора – VT1000 S).

#### Прибор и наружные поверхности

При необходимости окрашенные внешние поверхности органов управления можно почистить мягким бытовым чистящим средством или мыльным раствором и протереть тряпкой.

Перед использованием прибор должен полностью высохнуть.

#### Очистка ножа



#### Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям

Всегда вытирайте нож по направлению от задней части к режущей кромке. НИКОГДА не вытирайте нож в обратном направлении – опасность травмирования!

Очистка при использовании растворителя на основе спирта или ацетона.

## 7.2 Замена предохранителя



### Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям

Перед заменой предохранителя всегда выключайте прибор и полностью удаляйте все кабели. Прибор должен быть охлажден, а бак для парафина должен быть опорожнен.

Для замены используйте ТОЛЬКО прилагаемые запасные предохранители.

В случае полного выхода прибора из строя сначала проверьте питание от розетки.

Затем следует проверить предохранители на задней стороне прибора.

Для этого:

- Отверткой (→ Рис. 28-1) осторожно вытолкните гнездо предохранителя (→ Рис. 28-2) (на рис.33 сверху).
- Извлеките гнездо предохранителя: здесь установлено два предохранителя (→ Рис. 28-3).
- Проверьте целостность тонкого провода (→ Рис. 28-4) в стеклянной трубке предохранителя. Если он поврежден, предохранитель следует заменить (в стандартный комплект поставки входят запасные предохранители).



### Не прикасайтесь непосредственно к токопроводящим деталям

Перед подсоединением сетевого кабеля и включением прибора следует определить причину перегорания предохранителя и устранить ее.

- Установите гнездо с обоими предохранителями и подготовьте прибор к использованию.

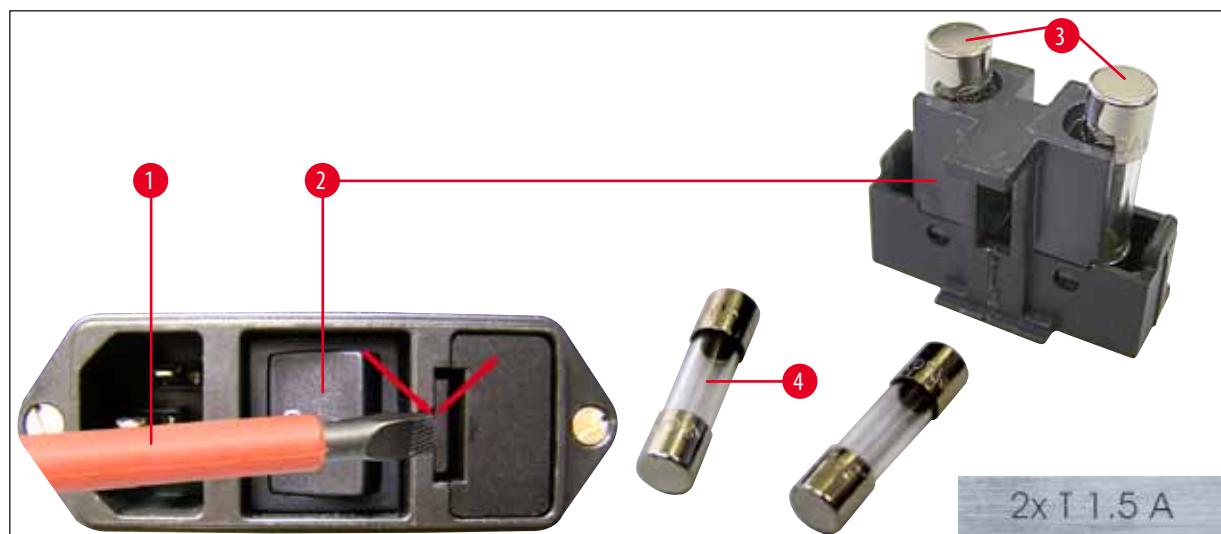


Рис. 28

## 8. Информация для заказа: запасные детали, принадлежности, расходные материалы

### 8.1 Информация для заказа

Название	№ для заказа
Держатель ножа S	14 0462 30131
Буферный поддон S	14 0462 30132
Буферный поддон S, с двойной стенкой	14 0463 46423
Диск для образцов S, Ø 50 мм, не ориентируемый*	14 0463 27404
Держатель образца с магнитом, ориентируемый	14 0462 32060
Ножной переключатель с защитой	14 0463 27415
Лупа, в сборе	14 0462 31191
"Модуль высокомощных светодиодных спотов, с 2 ножками"	14 6000 04826
Модуль высокомощного светодиодного спота 1000	14 6000 04825
Сапфировый нож	14 0216 39372
Цианакрилатный клей	14 0371 27414
<b>Julabo FL300, циркуляционный охладитель</b>	
100 В/50/60 Гц	14 0481 48439
115 В/50 Гц	14 0481 48437
230 В/50-60 Гц	14 0481 48436
230 В/60 Гц	14 0481 48438
Теплоноситель Antifrogen	14 0481 45443

### 8.2 Ножной переключатель



Рис. 29

#### Ножной переключатель

Ножной переключатель является дополнительной принадлежностью. Он предназначен для осуществления функции START/STOP.

№ для заказа:

**14 0463 27415**

### 8.3 Буферный поддон

#### 8.3.1 Буферный поддон S с двойной стенкой



##### Указание

При использовании буферного поддона с двойной стенкой ПЕРЕД началом работ следует установить проточный охладитель в соответствии с инструкцией по монтажу.



Рис. 30



Рис. 31

Буферный поддон с двойной стенкой может быть оснащен зажимом, удерживающим шланг в целях фумигации буферного элемента в нужном положении.

Сначала подсоедините шланги ((→ Рис. 31-1), входят в комплект поставки буферного поддона с двойной стенкой) с задней стороны циркуляционного охладителя Julabo FL300, другой конец подсоедините к пустому буферному поддону. Чтобы обеспечить лучший доступ, сначала выполните подсоединение к левому разъему. Для этого потяните самоуплотняющуюся муфту назад, подсоедините шланг и отпустите муфту, чтобы она зафиксировалась со слышимым щелчком.

- Предусмотрен комплект шлангов для подключения циркуляционного охладителя.

№ для заказа:

14 0463 46423

## 8.4 Увеличитель, светодиодная подсветка

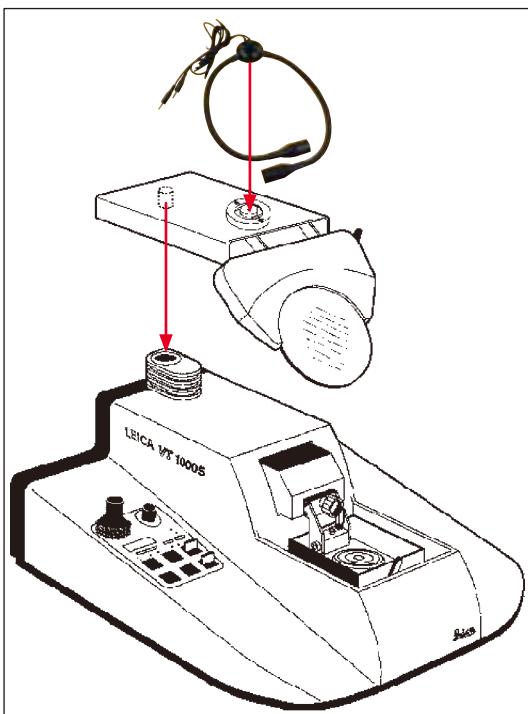


Рис. 32

## Лупа

- Лупа вставляется в держатель.

№ для заказа:

14 0462 31191

**"Модуль высокомощных светодиодных спотов, с 2 ножками"**

- Для установки на увеличитель после установки увеличителя в крепление. Затем подсоедините модуль высокомощных светодиодных спотов с 2 ножками к модулю высокомощного светодиодного спота 1000.

№ для заказа:

14 6000 04826



Рис. 33

**Модуль высокомощного светодиодного спота 1000**

- Служит источником света для модуля высокомощных светодиодных спотов с 2 ножками.

№ для заказа:

14 6000 04825

## 8.5 Циркуляционный охладитель Julabo FL300



Рис. 34

Циркуляционный охладитель для подключения к буферному поддону с двойной стенкой для приборов VT1000 S и VT1200/VT1200 S.

Диапазон температуры с возможностью выбора: от -20°C до +40°C.

### Рекомендуемый охлаждающий агент:

Теплоноситель Antifrogen 14 0481 45443

Смешивание с водой (50 %/50 %)

### Пример использования:

При достижении температуры 4°C (температура окружающей среды от 20°C до 22°C) в буферном поддоне следует выбрать установочное значение от 0,5°C до 2°C.



### Указание

Более подробную информацию о данном приборе можно найти в прилагаемом руководстве пользователя.

## 9. Гарантия и обслуживание

### Гарантия

Leica Biosystems Nussloch GmbH заверяет, что данное изделие прошло комплексную проверку качества по внутренним критериям компании Leica, не имеет дефектов и обладает всеми заявленными техническими характеристиками и/или соответствующими договору свойствами.

Объем гарантии зависит от содержания заключенного договора. Обязывающими являются только условия гарантии вашего дилера Leica или компании, в которой вы приобрели изделие.

### Сервисная информация

Если вам потребуются техническая поддержка или запчасти, то обращайтесь в свое представительство Leica или к дилеру Leica, у которого вы купили прибор.

Необходимо сообщить следующее:

- название модели и серийный номер прибора,
- Местонахождение прибора и контактное лицо.
- причина обращения в сервисную службу,
- Дату поставки.

### Вывод из эксплуатации и утилизация

Прибор и его части должны утилизироваться с соблюдением действующих предписаний.

**10. Подтверждение обеззараживания**

Каждое изделие, возвращаемое в Leica Biosystems, или нуждающееся в техническом обслуживании по месту эксплуатации, должно быть надлежащим образом очищено и обеззаражено. Специальный шаблон о подтверждении прохождения санитарной обработки можно найти на нашем сайте [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com) в меню продукта. Этот шаблон должен использоваться для сбора всех необходимых данных.

При возврате изделия необходимо приложить копию заполненного и подписанного подтверждения к изделию или передать ее специалисту сервисной службы. Ответственность за изделия, отправленные без этого подтверждения или с не полностью заполненным подтверждением, лежит на отправителе. Возвращаемые изделия, которые с точки зрения компании являются потенциальным источником опасности, будут отправляться назад за счет и под ответственность отправителя.



[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)

