

HistoCore MULTICUT

Айналмалы микротом

Пайдалану нұсқаулығы

Қазақ

Тапсырыс №: 14 0518 80138 - F редакциясы

Бұл нұсқаулықты әрқашан құралмен бірге сақтаңыз.

Құралмен жұмыс жасамас бұрын оны мұқият оқып шығыңыз.

CE



Бұл нұсқаулықта қамтылған ақпарат, сандық деректер, жазбалар мен пайымдаулар заманауи ғылыми білім мен технологияның қазіргі жағдайын, осы саладағы мүқият зерттеу нәтижесіндегі түсінігіміз ретінде берілген.

Компания осы нұсқаулықты соғы техникалық әзірлемелерге сәйкес жүйелі түрде жаңарту немесе тұтынушыларға осы нұсқаулықтың қосымша көшірмелерін, жаңартуларын және т.б. ұсыну міндеттемесінен босатылады.

Әрбір жеке жағдайда қолданылатын үлттық құқықтық жүйеге сәйкес рұқсат етілген дәрежеде біз осы нұсқаулықта қамтылған қате мәлімдемелер, сызбалар, техникалық суреттер және т.б. үшін жауп бермейміз. Атап айтқанда, осы нұсқаулықтағы мәлімдемелердің немесе басқа ақпараттың сәйкестігіне байланысты туындаған немесе оған қатысты қаржылық шығын немесе салдарлы залал үшін ешқандай жаупкершілік қабылданбайды.

Осы Пайдалану нұсқаулығының мазмұны мен техникалық мәліметтеріне қатысты мәлімдемелер, сызбалар, иллюстрациялар және басқа ақпарат өнімдеріміздің кепілдік сипаттамалары болып саналмайды.

Бұл тек біздің клиенттермен келісілген келісім шарттармен анықталады.

Leica компаниясы техникалық сипаттамаларды, сондай-ақ өндірістік процестерді алдың ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Тек осылай ғана біздің өнімдерде қолданылатын технология мен өндіріс техникасын үздіксіз жетілдіруге болады.

Бұл құжат авторлық құқық туралы заңмен қорғалған. Бұл құжаттама үшін барлық авторлық құқықтар Leica Biosystems Nussloch GmbH компаниясына тиесілі.

Басып алу, ксерокөшірме, микрофише, веб-камера немесе басқа әдістермен кез келген мәтін мен иллюстрацияларды (немесе олардың кез келген бөліктерін) көшіру Leica Biosystems Nussloch GmbH компаниясының жазбаша алдың ала жазбаша рұқсатын қажет етеді.

Құралдың сериялық нөмірі мен шығарылған жылын білу үшін құралдың артқы жағындағы белгіні қараңыз.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
D-69226 Nussloch
Германия

Тел.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Факс: +49 - (0) 6224 - 143 268
Веб: www.LeicaBiosystems.com

Құрастыру Leica Microsystems Ltd. Shanghai тарапынан орындалды

Мазмұны

1.	Маңызды ақпарат	7
1.1	Мәтінде қолданылатын таңбалар және олардың мағынасы	7
1.2	Құралдың түрі	9
1.3	Мақсатты тағайындалуы	9
1.4	Қызметкерлердің біліктілігі	9
2.	Қауіпсіздік	10
2.1	Қауіпсіздік ескертпелері	10
2.2	Ескертпелер	10
2.2.1	Құралдың өзіндегі белгілер	11
2.2.2	Тасымалдау және орнату	11
2.2.3	Құралды пайдалану	13
2.2.4	Тазалау және техникалық қызмет көрсету	20
2.3	Кірістірілген қорғаныс құралдары	21
2.3.1	Қолмен басқару құралын құлыштау	22
2.3.2	Пышақ/жұз ұстағышындағы сақтандырыш	23
3.	Құралдың құрамдастары мен сипаттамалары	24
3.1	Шолу – құралдың құрамдастары	24
3.2	Құралдың техникалық сипаттамасы	25
3.3	Техникалық мәліметтер	26
4.	Құралды баптау	29
4.1	Орнату алаңына қойылатын талаптар	29
4.2	Стандартты жеткізу - қаптама тізімі	29
4.3	Қаптамадан шығару және орнату	31
4.4	Қолмен басқару құралын жинау	33
4.5	Электр қосылыстары	34
4.5.1	Кернеуді тексеру	34
4.5.2	Қуат көзіне қосу	35
4.5.3	Басқару тақтасын қосу	36
4.6	Құралды қосу	36
5.	Басқару	38
5.1	Басқару элементтері және олардың функциялары	38
5.1.1	Құралдың басқару тақтасы	38
5.1.2	Бөлек басқару құралы	39
5.1.3	Дисплей және басқару элементтері	40
5.1.4	Электронды үлкен беріліс дөңгелегі	46
5.1.5	Үлгіге арналған ұсақ бағыттағыш қондырыш	47
5.1.6	Күш тәпеп-тендігін дәл реттеу	48
5.2	Екі функциясы бар "E" жұз ұстағышын енгізу	49

5.2.1 Жүз ұстағышының негізін орнату	49
5.2.2 Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышын енгізу	50
5.3 Саңылау бұрышын реттеу	50
5.4 Әмбебап кассета қысқышын салу	51
5.5 Үлгіні қысу	52
5.6 Пышақты/бір реттік жүзді қысу	52
5.7 Үлгіні кесу	55
5.8 Бөлу	56
5.9 Үлгіні өзгерту немесе бөлуді үзу	58
5.10 Күнделікті режимді аяқтау.....	59
6. Қосымша керек-жарақтар	61
6.1 Үлгі қысқышына арналған бекіту жинағы	61
6.1.1 Үлгі қысқыштары үшін қатаң бекітпе	61
6.1.2 Үлгі қысқыштарына арналған бағыттауыш бекітпе	62
6.1.3 Үлгі қысқыштарына арналған дәл бағыттағыш қондырғы	62
6.1.4 Жылдам қысқыш жүйесі	63
6.2 Үлгі қысқыштары мен ұстағыштары	63
6.2.1 Стандартты үлгі қысқышы	64
6.2.2 Әмбебап кассета қысқышы.....	64
6.2.3 Супер кассеталы қысқышы.....	66
6.3 Пышақ ұстағыш негізі мен пышақ ұстағыш	67
6.3.1 Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышы	67
6.3.2 Пышақ ұстағышының негізі, бүйірлік жылжу функциясы жоқ	68
6.3.3 “Е” пышақ ұстағышы төмен профильді пышақтарға арналған су шұнқыры бар	69
6.3.4 Пышақ ұстағышы N	69
6.4 Бөліктің қалдықтар науасы	71
6.5 Артқы жарық	72
6.6 Жоғарғы науа	72
6.7 Әмбебап микроскоп тасымалдаушысы	73
6.8 Үлкейткіш линза, ЖД жарықтандыруы.....	75
6.9 Қосымша керек-жарақтар	77
6.10 Тапсырыс беру ақпараты.....	86
7. Ақаулықтарды шешу	88
7.1 Қате кодтары	88
7.2 Мүмкін ақаулар.....	89
7.3 Құралдың дұрыс жұмыс істемеуі.....	91
7.4 екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышының ақаулары.....	92
7.4.1 Қысым тақтасын ауыстыру	92
7.4.2 Қысқыштың жоғарғы бөлігін сегмент доғасына бекіту.....	93

Мазмұны

7.5	Қысқыш қондырғының қысқыш жүйесінің негіздік тақтаға орнатылуы.....	93
8.	Тазалау және техникалық қызмет көрсету.....	94
8.1	Құралды тазалау.....	94
8.2	Техникалық қызмет көрсету.....	98
8.2.1	Сақтандырғыштарды ауыстыру	98
8.3	Техникалық қызмет көрсету нұсқаулары	98
8.4	Құралды майлау	99
9.	Кепілдік және қызмет көрсету	101
9.1	Кепілдік.....	101
9.2	Қызмет көрсету туралы ақпарат	101
9.3	Пайдаланудан шығару және жою	101
10.	Залалсыздандыруды растау.....	102

1. Маңызды ақпарат

1.1 Мәтінде қолданылатын таңбалар және олардың мағынасы



Қауіп:

Қауіпті жағдайды көрсетеді, егер ол болдырылмаса, өлімге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.



Сақ болыңыз:

Егер бұл қауіпті болдырmasаңыз, бұл өлімге немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.



Абайлаңыз:

Болдырmasа өлімге немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін қауіпті жағдайды көрсетеді.



Ескертпе:

Мүліктің зақымдану ықтималдығы бар жағдайды көрсетеді, егер ол болдырылмаса, машинаның немесе оның қасындағы заттың бұзылуына әкелуі мүмкін.



Кеңес:

Жұмыс процесін жеңілдету бойынша кеңестер береді.

Иллюстрацияларды нөмірлеуге арналған элементтердің нөмірлері.


→ "7-сур. - 1"



Өндіруші



Тапсырыс нөмірі



Сериялық нөмір



Өндірілген күні



Пайдалану нұсқаулығын қараңыз.



Абайлаңыз, мүқият болуға шақыратын ақпаратты алу үшін пайдалану нұсқауларын қараңыз.



In vitro диагностикалық (IVD) медициналық құрылғы




СЕ белгісі - бұл медициналық өнімнің ағымдағы ЕС директивалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес келетіні туралы өндірушінің мәлімдемесі.

Country of Origin: China

Шығарылған елдің қорапшасы өнімнің соңғы түр трансформациясы орындалған елді анықтайды.


UK
CA

Transport temperature range:




Буманы тасымалдауға рұқсат етілген температура диапазонын көрсетеді.
 Ең төменгі -29°C
 Ең жоғары +50°C

Storage temperature range:



Буманы сақтауға рұқсат етілген температура диапазонын көрсетеді.
 Ең төменгі +5 °C
 Ең жоғары +50°C



Буманы сақтау және тасымалдауға рұқсат етілген ылғалдылық диапазонын көрсетеді.
минималды 10% сал.ылғ.
максималды 85 % сал.ылғ.



Shockwatch жүйесінде соққы нүктесі қызыл түспен көрсетілген қарқындылықтан жоғары әсерлерді немесе соққыларды көрсетеді. Анықталған үдеуден (g мәні) асып кету индикатор түтігі түсінің өзгеруіне әкеледі.



Дұрыс қондырғылар көмегімен затты қайта өңдеуге болатынын көрсетеді.

1.2 Құралдың түрі

Пайдалану нұсқаулығында берілген барлық ақпарат бірінші бетте көрсетілген құралдың түріне ғана қатысты. Құралдың артқы жағында құралдың сериялық нөмірін көрсететін тақта бекітілген.

1.3 Мақсатты тағайындалуы

HistoCore MULTICUT - жартылай жетекті (ұлғіні жетек арқылы беру), қолмен басқарылатын айналмалы микротом, арнайы бекітілген формалиннің жұқа бөліктерін жасауға арналған, патолог дәрігердің гистологиялық медициналық диагностикасы, мысалы, қатерлі ісік диагностикасы үшін қолданылатын әр түрлі қаттылықтағы адам тіндеріне кіріктірілген парафин ұлғілері. Ол қолмен кесу үшін жарайтын адамның жұмсақ және қатты ұлғілерін бөлуге арналған. HistoCore MULTICUT *in vitro* диагностикасында қолдануға арналған.



Сақ болыңыз

Мақсатты қолданудан басқа кез келген қолдану.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе ұлғінің зақымдалуы.

- Пайдалану нұсқаулығында сипатталған мақсатты қолдануды ұстаныңыз. Құралдың кез келген басқа қолданылуы дұрыс пайдаланылмау болып саналады.

1.4 Қызметкерлердің біліктілігі

- HistoCore MULTICUT тек білікті зертхана қызметкерлері тарапынан басқарылуы керек. Құрал тек кәсіби қолдануға арналған.
- Бұл құралмен жұмыс істеуге тағайындалған барлық зертхана қызметкерлері осы Пайдалану нұсқаулығын мүқият оқып шығуы керек және оны қолданар алдында құралдың барлық техникалық ерекшеліктерімен таныс болуы керек.

2. Қауіпсіздік

2.1 Қауіпсіздік ескертпелері

Пайдалану нұсқаулығында құралдың жұмыс қауіпсіздігі мен техникалық қызмет көрсетуге қатысты маңызды ақпарат бар.

Пайдалану нұсқаулығы өнімнің маңызды бөлігі болып табылады және оны іске қосар алдында және қолданар алдында мүқият оқып шығу керек және оны әрқашан құралдың жанында ұстau керек.

Бұл құрал электрлік өлшеу, бақылау, реттеу және зертханалық құралдардың қауіпсіздік ережелеріне сәйкес құрастырылған және сыналған.

Бұл шартты сақтау және қауіпсіз жұмыстың қамтамасыз ету үшін пайдаланушы Пайдалану нұсқаулығындағы барлық ескертулер мен жазбаларды сақтауы тиіс.

Бұл тараудағы қауіпсіздік пен сақтық шаралары үнемі сақталуы керек.

Егер сіз басқа Leica Biosystems өнімдерінің жұмысымен және қолданылу ретімен таныс болсаңыз да, бұл жазбаларды міндettі түрде оқыңыз.

Пайдалану нұсқаулығы пайдаланушының елінде апattардың алдын алу және экологиялық қауіпсіздік бойынша қолданыстағы ережелерге сәйкес тиісінше толықтырылуы тиіс.



Сақ болыңыз

Өндіруші ұсынған қорғаныс құрылғылары немесе қауіпсіздік керек-жарақтары алынып тасталды немесе өзгертулді.

Үлгілердің зақымдалуын қоса, адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралдың қорғаныс құралдарын немесе керек-жарақтарын ешқашан алып тастамаңыз немесе өзгертулғанда қорғаныс құралдарын көрсетуши қызметкерлер құралды жөндей алады және құралдың ішкі құрамдастарына қол жеткізе алады.
- Құралмен жұмыс жасамас бұрын, барлық қорғаныс құралдары мен қауіпсіздік керек-жарақтарының бар екеніне сенімді болыңыз және олардың мақсатына сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.



Кеңес

Қолданыстағы стандарттар туралы ағымдағы ақпаратты сайтымыздың CE сәйкестік декларациясы мен UKCA сертификаттарынан қараңыз:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

Электромагниттік ортаны құралмен жұмыс жасамас бұрын бағалау керек. Бұл құралды күшті электромагниттік сәулелену көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз (мысалы, қорғалмаған РЖ көздері), себебі бұл олардың дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіруі мүмкін.

Құрал IEC 61326-2-6 сипатталған эмиссия мен одан қорғау талаптарына сәйкес келеді.

2.2 Ескертпелер

Бұл құралға өндіруші таралынан орнатылған қорғаныс құрылғылары апattyқ жағдайдың алдын алуға негіз болып табылады. Құралды қауіпсіз пайдалану - ең алдымен, иесінің, сондай-ақ құралды басқаратын, қызмет көрсететін немесе тазартатын тағайындалған қызметкерлердің жауапкершілігі.

Құралдың ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін келесі нұсқаулар мен ескертулерді орындауды ұмытпаңыз.

2.2.1 Құралдың өзіндегі белгілер



Сақ болыңыз

Құралдағы сәйкес белгілер мен ескерту үшбұрыштарының дұрыс пайдалану нұсқауларын (Пайдалану нұсқаулығында анықталғандай) орындаама.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе құралдың, керек-жарақтардың немесе үлгінің зақымдалуы.

- Құралдағы таңбалалауға назар аударыңыз және таңбаланған затты пайдалану немесе ауыстыру кезінде пайдалану нұсқаулығында сипатталған пайдалану нұсқауларын қатаң сақтаңыз.

2.2.2 Тасымалдау және орнату



Сақ болыңыз

Қаптамадан шығару кезінде керек-жарақтар/құрал бумадан түсіп қалу қаупи.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралды қаптамадан шығарғанда абай болыңыз.
- Қаптамадан шығарылғаннан кейін құралды тек тік күйде ғана жылжыту керек.
- Қаптаманың сыртына салынған қаптамадан шығару нұсқаулығында берілген нұсқауларды немесе Пайдалану нұсқаулығында сипатталған әрекеттерді мүқият орындаңыз.



Сақ болыңыз

Құрал тиісінше көтерілмеген.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралды көтергенде оны пайдалану нұсқаулығында және қаптамадан шығару нұсқаулығында сипатталған көтеру нұқтелерінде ғана ұстаңыз (құралдың алдыңғы және артқы жағындағы негізгі белгі).
- Құралды ешқашан доңғалақ тұтқасынан, электрлік үлкен беріліс дөңгелегінен немесе нысан басынан көтерменіз.
- Құралды тасымалдау алдында әрқашан қоқыс жәшігін алып тастаңыз.



Сақ болыңыз

Құралдың абайсызда қозғалуы.

Қол және/немесе саусақтардың құрал және жұмыс бетінің арасында қысылып қалуы салдарынан туындаитын ауыр жарақат.

- Құралды көтергенде оны пайдалану нұсқаулығында және қаптамадан шығару нұсқаулығында сипатталған көтеру нұқтелерінде ғана ұстаңыз (құралдың алдыңғы және артқы жағындағы негізгі белгі).
- Құрал мен жұмыс бетінің арасында қолдың қалып қалмайтынына көз жеткізіңіз.



Сақ болыңыз

Құрал барлық 4 аяғымен қауіпсіз түрде лабораториялық үстелге тиісінше қойылмауы.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралды көлденең, беті тегіс болатын тұрақты, дірілсіз лабораториялық үстелге қойыңыз. Еден мүмкіндігінше дірілсіз болуы керек.
- Әр 4 аяқтың зертханалық үстелге толық қойылғанына әрқашан көз жеткізіңіз.
- Егер құралды басқа адамдар қозғаған болса (мысалы, қызмет көрсету үшін), оның дұрыс орналасуын әрқашан қайталап тексеріңіз.

**Сақ болыңыз**

Құрал ішіндегі конденсация температураның және ауаның жоғары ылғалдылығының айтарлықтай айырмашылығына байланысты болады.

Құралдың зақымдалуы.

- Әрқашан сақтау үшін де, пайдалану үшін де климаттық шарттардың тиісті екеніне көз жеткізіңіз. Техникалық мәліметтер бөлімін ([—26-б. – 3.3 Техникалық мәліметтер](#)) қараңыз.
- Құралды жеткізгеннен кейін оны қосар алдында қоршаған орта температурасына бейімделуіне мүмкіндік беру үшін кемінде екі сағат күтіңіз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жұз ұстағышы құралдан құлап түсу қаупі.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Егер пышақ/жұз ұстағыш бекітілмеген болса, мысалы, орнату немесе тазалау кезінде, пышақ/жұз ұстағышының құлап кетпеудің қадағалаңызы.
- Мүмкіндігінше, пышақ/жұз ұстағышы құлап кетпеудің үшін оны бекітіңіз.
- Кездейсоқ құлап кетпес үшін орнату немесе техникалық қызмет көрсету үшін пышақ ұстағыш негізінен пышақ/жұз ұстағышын алыңыз.

**Сақ болыңыз**

Бөлімдегі қалдықтар науасының ажыратылғаннан кейін құлап түсу қаупі.

Адамдар жарақатталуы мүмкін.

- Қалдықтарды шығаратын науаны алып тастау кезінде әсіресе мұқият жұмыс жасаңыз.

**Сақ болыңыз**

Май төгілді және бірден тазартылмады.

Адамдардың ауыр жарақаттары, мысалы, сырғып кету және құралдың пышағы/жұзі сияқты қауіпті бөліктеге тиіп кету.

- Әрқашан май төгілмегеніне көз жеткізіңіз.
- Егер май төгілген болса, оны дереу, мұқият және толық тазалаңыз.

**Сақ болыңыз**

Парафин қалдықтары еденге түсу және тазартыла алмау қаупі.

Адамдардың ауыр жарақат алу қаупі, мысалы, пышаққа/жұзге сырғып түсіп кету салдарынан.

- Парафин қалдықтары таралмай, тайғақ болмай, қауіпке айналмайынша, оны үнемі тазалаңыз.
- Сәйкес аяқ киімді киіңіз.

**Сақ болыңыз**

Кернеу селекторында таңдалған қуат көзінің кернеуі қате.

Құралдың зақымдалуы, үлгіні өңдеудегі кідіріс.

- Құралды қоспас бұрын, оны желіге қоспас бұрын желіге сәйкес кернеуді таңдап алыңыз.
- Кернеу селекторының параметрін өзгерту кезінде құралды желіден ажырату қажет.

**Сақ болыңыз**

Құралды жерге түйікталмаған розеткаға қосу немесе ұзартқыш сымды қолдану.

Адамдардың жарақат алуына немесе диагноздың кідірісіне әкелетін электр тогымен соғу қаупі.

- Құрал жерге түйікталған розеткаға қосылуы керек.
- Ұзартқышты қолданбаңыз.

**Абайлаңыз**

Керек-жарақтар/бөлшектер тасымалдау кезінде босап қалған/бүлінген.

Мүліктің бүлінуі немесе диагностика кідірісі.

- Қаптамада ShockDot әсерінің индикаторы бар, бұл тасымалдаудың дұрыс еместігін көрсетеді. Құрал жеткізілген кезде алдымен келесін тексеріңіз. Егер индикатор қосылған болса, бума көрсетілгендей тасымалданбаған. Бұл жағдайда жөнелту құжаттарын тиісті түрде белгілеп, жөнелтілімге зақым келгенін тексеріңіз.

2.2.3 Құралды пайдалану**Қауіп**

Жарылыс қаупі.

Адамдардың өлімі немесе ауыр жарақаты және/немесе заттардың бүлінуі.

- Құралды жарылу қаупі бар бөлмелерде ешқашан қолданбаңыз.

**Сақ болыңыз**

Құралмен жұмыс істейтін біліктілігі жеткіліксіз қызметкерлер.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе үлгінің зақымдалуы, мысалы, оператордың дұрыс емес әрекеті себебінен пышақ/жұзге жақындағанда, мысалы, дөңгелектің құлпы ашылған кезде заттың басы пышақ ұстағышына түсіп кетуі мүмкін.

- Құралды тек арнайы және жеткілікті дайындық пен біліктілігі бар зертханалық персонал басқаратынына көз жеткізіңіз.
- Бұл құралмен жұмыс істеуге тағайындалған барлық зертхана қызметкерлері осы Пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шықсанына және оны қолданар алдында құралдың барлық техникалық ерекшеліктерімен танысқанына әрқашан көз жеткізіңіз.

**Сақ болыңыз**

Өндіруші ұсынған қорғаныс құрылғылары немесе қауіпсіздік керек-жарақтары алынып тасталды немесе өзгертилді.

Үлгілердің зақымдалуын қоса, адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралдың қорғаныс құралдарын немесе керек-жарақтарын ешқашан алып тастамаңыз немесе өзгертеңіз. Тек Leica Biosystems біліктілігі бар қызмет көрсетуші қызметкерлер құралды жөндей алады және құралдың ішкі құрамдастарына қол жеткізе алады.
- Құралмен жұмыс жасамас бұрын, барлық қорғаныс құралдары мен қауіпсіздік керек-жарақтарының бар екенине сенімді болыңыз және олардың мақсатына сәйкес екенине көз жеткізіңіз.

**Сақ болыңыз**

Жеке қорғаныс құралдары қолданылмаған.

Адамдар жарақатталуы мүмкін.

- Микротомдармен жұмыс жасағанда жеке қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Жұмыс кезінде қауіпсіздік аяқ киімін, қолғапты, бетперде мен қорғаныс көзілдірігін киу міндettі.

**Сақ болыңыз**

Пышақтар немесе жүздер қолайсыз түрде пайдаланылған және/немесе кәдеге жаратылған.

Өте өткір пышақпен/жүзбен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақпен/жүзбен жұмыс жасағанда, әсіреле абай болыңыз және мұқият жұмыс жасаңыз.
- Пышақпен/жүзбен жұмыс жасау кезінде әрқашан арнайы киімдерді (оның ішінде кесілмейтін қолғаптарды) киіңіз.
- Пышақтар мен жүздерді әрқашан қауіпсіз жерге тастаңыз (мысалы, арнайы пышақ қорапшасы) және адамдардың жарақат алмауын қамтамасыз етіңіз.
- Ешқашан пышақты кесу жиегін жоғары қаратып қоймаңыз және құлап жатқан пышақты ұстауға тырыспаңыз.
- Улгіні қыспас бұрын әрқашан пышақтың/жүздің шетін сақтандырғышпен жабыңыз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жүз ұстағышы микротомнан шығарылған кезде пышақ/жүз алынбады.

Өте өткір пышақпен/жүзбен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ/жүз ұстағышын микротомнан алмас бұрын, пышақты/жүзді кесуге төзімді қолғап кигенде ажыратыңыз және пышақты/жүзді қауіпсіз жерде сақтаңыз.

**Сақ болыңыз**

Оператор дұрыс емес жұмыс тәртібіне байланысты пышақты/жүзді ұстап қалды.

Егер пышақ/жүз бұрын орнатылған болса, үлгіні орнына қою кезінде адамдардың ауыр жарақат алу қаупі.

- Үлгіні микротомға жүктемес бұрын, кесу жиегінің сақтандырғышпен жабылғанына және қол дөңгелегінің құлыптау механизмінің іске қосылғанына көз жеткізіңіз. Оператор үлгіні, сондай-ақ пышақты/жүзді салуды жоспарлағаннан кейін, үлгі блогын пышақты/жүзді орнатпас бұрын және қыспастан бұрын жүктеңіз.

**Сақ болыңыз**

Оператор пышақ/жүз ұстағышқа екі пышақ/жүзді орнатады.

Өте өткір пышақтармен және/немесе жүздермен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ ұстағышына/жүз ұстағышына екі пышақты/жүзді қыспаңыз. Пышақты/жүзді пышақ/жүз ұстағышының ортасына орнатыңыз. Пышақтар/жүздер пышақ/жүз ұстағышының шетінен аспауы керек.

**Сақ болыңыз**

Жұздер қысым тақтасының жоғарғы шетіне толық параллель орнатылмаған.

Бүйірлік қозғалыс функциясын қолданғанда, пышақты қысым тақтасына параллель орнатпау кесу нәтижесінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Мысалы, егер бөлім тым қалың, немесе тым жіңішке болса, ең нашар сценариіде бөлімнің ішінде сейлесу үлгіні зақымдауы мүмкін.

- Бөлімнің қанағаттанарлықсыз нәтижелерін алған кезде бөлуді жалғастырмаңыз.
- Жұздерді қайта орнатыңыз және оның қысым тақтасының жоғарғы шетіне параллель екеніне көз жеткізіңіз.
- Жұздерді көлденең жылжыту функциясы арқылы жылжытқаннан кейін әрқашан жұз бен қысым тақтасы арасындағы параллельдікті тексеріңіз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жұздер пышақ/жұз ұстағышы мен пышақ/жұз ұстағыш негізі құралға орнатылmas бұрын орнатылады.

Өте өткір пышақтармен және/немесе жұздермен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақты/жұзді салмас бұрын микротомға пышақ/жұз ұстағышы мен пышақ/жұз ұстағыш негізін орнату қажет.

**Сақ болыңыз**

Улгіні кесу кезінде пышақ/жұз тиісті қорғаныспен қапталмаған.

Адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ/жұз немесе үлгі қысқышымен қандай да бір манипуляция жасамас бұрын, улгін ауыстырап алдында және барлық жұмыс үзілістерінде әрқашан пышақтың/жұздің жиегін тиісті қорғаныспен жабыңыз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жұз дұрыс сақталмаған.

Адамдардың ауыр жарақаттары, мысалы, күтпеген жерден құлау.

- Пышақты/жұзді әрқашан пайдаланбайтын кезде тиісті жерде сақтаңыз, мысалы, оны арнайы пышақ қорабында сақтаңыз.
- Ешқашан пышақты кесу жиегін жоғары қаратып қоймаңыз және құлап жатқан пышақты ұстаяға тырыспаңыз.

**Сақ болыңыз**

Улгіні микротомға тиісті киімсіз және сәйкес емес түрде жүктеу немесе түсіру.

Оператор жаралануы мүмкін, бұл ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін.

- Улгіні микротоммен өңдеу кезінде әрқашан кесуге төзімді қауіпсіздік қолғаптарын қолданыңыз.
- Улгінің қысқышын пайдаланбас бұрын және үлгін алмастырмас бұрын, дөңгелекті құлыштап, пышақ жиегін сақтандырышпен жабыңыз.

**Сақ болыңыз**

Үлгі кері тартылу кезеңінде бағытталған.

Үлгінің кері қысқару кезеңінде қайта бағдарлануына байланысты үлгінің бүлінуі.

- Үлгі блоктары кері тартылу кезеңінде бағытталмауы керек. Егер блок қысқару кезінде бағытталған болса, ол келесі бөлімге дейін қысқару мәнімен плюс таңдалған қиманың қалыңдығымен алға жылжиды. Бұл үлгінің де, пышақтың/жүздің де закымдалуына әкелуі мүмкін.

**Сақ болыңыз**

Тиісті қорғаныс киімінсіз құралмен және сынғыш үлгімен жұмыс істеу.

Сынғыш үлгінің кесу кезеңінде адамдардың сыннықтан ауыр жарақат алу қаупі.

- Әрқашан тиісті қорғаныс киімін киіңіз (қауіпсіздік көзілдірігін қоса) және сынғыш үлгінің кесу кезеңінде әсіресе мұқият жұмыс жасаңыз.

**Сақ болыңыз**

Күш тепе-теңдігі дұрыс теңшелмеген.

Пышақпен және/немесе үлгінің зақымдалуынан оператордың ауыр жарақат алу қаупі.

- Құралмен жұмыс жасамас бұрын, күш тепе-теңдігінің дәл теңшелуінің дұрыс орнатылғанын әрқашан қайталап тексеріңіз.
- Егер дәл реттеу дұрыс орнатылмаған болса, құралмен жұмыс жасамаңыз, оның қайта теңшеу қажет. Толық ақпарат алу үшін “Күш тепе-теңдігін дәл теңшеу” тарауын қараңыз.
- Әсіресе, заттың басындағы керек-жарақтарды ауыстырғаннан кейін, дереу күш тепе-теңдігін дәл реттеуді орындаңыз.

**Сақ болыңыз**

Бөлу үшін типтік жағдайлар жеткіліксіз.

Үлгінің зақымдалуы немесе кесудің нашар нәтижесі, мысалы, қалыңдығы бойынша ауыспалы, қысылған, бүктелген немесе жолақты кесінділер.

- Бөлімдердің жеткіліксіз нәтижелері анықталса, бөлуді жалғастырмайды.
- Тиісті бөлу үшін барлық алғышарттардың орындалғанына көз жеткізіңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін осы пайдалану нұсқаулығының ақауларды жою бөлімін қараңыз.
- Егер бөлу бойынша ақаулықтарды жою туралы жеткілікті біліміңіз болмаса, мұндай салада білімі бар адамдармен, мысалы, Leica Biosystems қосымшасының сарапшыларымен кеңесіңіз.

**Сақ болыңыз**

Дөңгелектің бұрылу бағыты қате таңдалды.

Үлгінің зақымдалуы.

- Дөңгелекті айналдырmas бұрын, үлкен беріліс дөңгелегінің бұрылу бағытын дұрыс таңдағаныңызға әрқашан көз жеткізіңіз.



Сақ болыңыз

Қолмен басқару құралын сағат тіліне қарсы бұры.

Адамдардың жарақаты/ұлгінің зақымдалуы.

- Қолмен басқару құралын сағат тілінің бағытына қарсы бұрмаңыз, бұл дөңгелекті бекіту механизмінің дұрыс жұмыс істемеүіне әкелуі мүмкін.



Сақ болыңыз

Қолмен басқару құралының құлпы ашылады және заттың басы пышақ/жұз ұстағышына түседі.

Адамдардың жарақаты/ұлгінің зақымдалуы.

- Бөлу кезеңінен басқа, қолмен басқару құралы әрқашан құлыштаулы болуы керек.



Сақ болыңыз

Қолмен басқару құралының айналу жылдамдығы ұлгінің қаттылығына сәйкес келмейді.

Құрал зақымдалуы және ұлгінің зақымдалуы мүмкін.

- Қолмен басқару құралының айналу жылдамдығы ұлгінің қаттылығына сәйкес келуі керек. Күрделі ұлгілер үшін баяу жылдамдықты қолданыңыз.



Сақ болыңыз

Қолмен бөлу режимінде пайдаланушы қолмен басқару құралын өте жоғары жылдамдықпен айналдыру арқылы ұлғі блогын кеседі.

Бұл кесу сапасының нашарлауына және тіпті ұлгінің бұзылуына әкелуі мүмкін.

- Қолмен бөлу режимінде қолмен басқару құралының айналу жылдамдығы 60 айн/мин жылдамдығынан аспауы керек.



Сақ болыңыз

Қолмен басқару құралының тежегіші дұрыс пайдаланылмайды және қолмен басқару құралын т жеуеге болмайды.

Құралдың/адамдардың ауыр жарақаты немесе ұлгінің зақымдалуы.

- Қолмен басқару құралының тежегіш тұтқасы дәл бекітілген күйде болуы керек. Егер қолмен басқару құралы тежегішінің тұтқасы осы нүктеден асып кетсе, онда қолмен басқару құралы енді тежелмеуі мүмкін.



Сақ болыңыз

Қолмен тез кесу кезінде қолмен басқару құралының босатылғаннан кейін ұлғі мен пышақ/жұздің арасына саусақтар қойылады.

Оператор қолмен басқару құралының құлпы ашылған кезде оның бұрылуына байланысты кесілуі немесе жаралануы мүмкін.

- Кесу мен бөлу кезінде ұлғі мен пышақ/жұздің арасына саусақтарды қоймаңыз.

**Сақ болыңыз**

Бағдарламалық жасақтаманы қате түзету.

Улгінің зақымдалуы және/немесе диагностиканың кідірісі.

- Бағдарламалық қамтым тұрып қалған жағдайда Ақаулықтарды жою және пайдалану тарауларында берілген нұсқауларды орындаңыз.
- Егер құрал бірден іске қосыла алмаса, оған зақым келтірмеу үшін үлгінің дұрыс сақталғанына көз жеткізіңіз.
- Қажет болса, Leica Biosystems қызмет өкіліне хабарласыңыз.

**Абайлаңыз**

Пышақ/жұз ұстағыш бүйірден жылжытылғаннан кейін, үлгі кері тартылмайды және қайта кесілмейді.

Улгінің зақымдалуы.

- Пышақ/жұз ұстағышын бүйірінен жылжытқаннан кейін, заттың басын артқа тартып, үлгі блогын қайта қысыңыз.

**Абайлаңыз**

Қолмен басқару құралы мен үлкен беріліс дөңгелегін бір уақытта айналдыру.

Улгінің зақымдалуы.

- Қолмен басқару құралын айналдыру кезінде үлкен беріліс дөңгелегін айналдырмаңыз.

**Абайлаңыз**

Қолмен басқару құралын орнатқанда сына жоғалады.

Құралды қолдануға болмайды, бұл диагностиканы кідіртуі мүмкін.

- Қолмен басқару құралын жинамас бұрын, сынаны тексеріп, оның дөңгелектің білігінде еkenіне көз жеткізіңіз.

**Абайлаңыз**

Жад күйін орнатқаннан кейін пышақ/жұз ұстағышының және/немесе зат басының қолмен жылжытылуы.

Улгінің зақымдалуы.

- Пышақ/жұз ұстағышын, ұстағыш негізін және/немесе заттың басын жылжытпаңыз және жадының орнын өзгерпестен бағдарын қайта реттеменіз.

**Абайлаңыз**

Электронды үлкен беріліс дөңгелегінің көмегімен кесуден кейін пайдаланушы бөлу режиміне ауыспайды.

Улгінің зақымдалуы немесе құралдың күтпеген жұмысы.

- Электронды үлкен беріліс дөңгелегімен кесу аяқталғаннан кейін, бөлу режиміне ауысады үмітпаңыз.
- Бөлуді бастамас бұрын, әрқашан тиісті бөлу қалыңдығының таңдалғанына көз жеткізіңіз.



Абайлаңыз

Электронды үлкен беріліс дөңгелегінің тез итеру немесе жады күйіне жылжыту кезіндегі бұрылуы.

Улгі зақымдалған.

- Жедел күйге келтіру немесе жад күйіне жылжу кезінде электронды үлкен беріліс дөңгелегін ұстамаңыз.



Абайлаңыз

Қолмен дөңгелекті айналдыру немесе бөлек басқару тақтасындағы немесе құралдарды басқару панеліндегі түймелерді басу, жылдам қосылу немесе жад күйіне өту.

Улгі зақымдалған.

- Жылдам қосылу кезінде немесе жад күйіне жылжу кезінде дөңгелекті айналдырмаңыз немесе бөлек басқару панеліндегі немесе құралдың басқару панеліндегі еш түймені баспаңыз.



Абайлаңыз

Жад күйі пышаққа/жұзге тым жақын орнатылған.

Улгі зақымдалған.

- Жадтың күйін орнатқанда, үлгінің пышақ/жұздің кесу жиегіне тимейтініне көз жеткізіңіз. Егер кесу жиегі үлгіге тиіп кетсе немесе жад күйін орнатқанда үлгі бетіне өте жақын орналасса, объектінің басын сәл артқа жылжытыңыз.
- Әр түрлі қалыңдықтағы үлгіні бір жады күйіне жүктеменіз.



Абайлаңыз

Құрал өшірілгеннен кейін немесе электр қуаты өшкеннен кейін жадтың орнын қалпына келтіре алмау.

Үлгінің зақымдалуы.

- Құрал өшірілгенде немесе электр қуаты өшкенде, бұрын сақталған жад орны туралы деректер өшеді. Құралды қосқаннан кейін жад күйін қайтадан орнатыңыз.



Ескертпе

Керек-жарақтар мен құрамдастар коррозиялық/қатты қышқыл/сілтілі реагентті немесе еріткішті, мысалы құрамында қышқылы бар кальцийленбеген ерітінді, құрамында сілті бар аммоний гидроксиді және т.б. құралмен немесе керек-жарақпен қолдану нәтижесінде коррозияға ұшырайды.

Керек-жарақтар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

- Құрал бетінде немесе керек-жарақтарға агрессивті/қатты қышқыл/сілтілі реагент немесе еріткіш тамшыламаңыз.
- Егер мұндай реагент немесе еріткіш құралдың бетінде немесе керек-жарақтарына тисе, оның қалдықтарды сұртіп, керек-жарақтарды мүмкіндігінше тез кептіріңіз.
- Егер мұндай реагент немесе еріткіш жиі қолданылса, жұз ұстағышты, әмбебап кассета қысқышын (UCC) және қажет болған жағдайда басқа керек-жарақтарды күнделікті мүқият тазалаңыз.

2.2.4 Тазалау және техникалық қызмет көрсету



Сақ болыңыз

Құралды электр ашасын ажыратпай тазалау.

Адамдардың жарақат алуына әкелетін электр тогының соғуы.

- Эр тазалау алдында құралды өшіріп, ашаны желіден ажыратыңыз.



Сақ болыңыз

Сұйықтықтардың құралдың ішкі бөлігіне ену қаупі.

Құрал/адамдардың ауыр зақымдалуы/жарақаты.

- Жұмыс кезінде және техникалық қызмет көрсету кезінде сұйықтықтың құралдың ішкі жағына түспеуін қадағалаңыз. Тиісті еріткіштерді немесе тазартқыштарды сұйықтықтың енуіне жол бермеу үшін құралға тікелей емес, тазартқыш алаңға шашыңыз. Егер сұйықтық құралдың ішіне түссе, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.



Сақ болыңыз

Тазалау кезінде жүзді дұрыс емес бағытта сұрту.

Адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақты әрқашан жүздің артқы жағынан кесу жиегіне дейін сұртіңіз.



Сақ болыңыз

Пышақ/жұз ұстағышты тазалау кезінде кептіру камерасынан бөлшектерді алу (65°C).

Күйіп қалу қаупі.

- Бөлшектерді кептіру камерасынан алу кезінде жылу оқшаулағыш қолғап киініз (65°C).



Сақ болыңыз

Сақтандырғыштарды құралды өшірмей ауыстыру және қуат ашасын ажырату.

Адамдардың жарақат алуына әкелетін электр тогының соғуы.

- Сақтандырғыштарды ауыстырмас бұрын құралды қуат қосқышының көмегімен өшіріп, ашаны желіден ажыратыңыз.



Абайлаңыз

Пайдалану нұсқаулығындағы Техникалық мәліметтер бөлімінде анықталған сипаттамасы жоқ сақтандырғыштарды қолдану.

Диагностика кідірісі, себебі құрал қате сақтандырғыштармен жұмыс істемейді.

- Пайдалану нұсқаулығындағы Техникалық мәліметтер бөлімінде анықталған сипаттамадағы сақтандырғыштарды ғана қолданыңыз.



Абайлаңыз

Құралды немесе керек-жарақтарды тазалау үшін дұрыс емес еріткіштерді немесе тазартқыштарды немесе өткір/қатты құралдарды қолдану.

Құралдың мүмкін дұрыс жұмыс істемеуі немесе диагностика кідірісі.

- Құралды тазалау үшін құрамында ацетон немесе ксилол бар еріткіштерді қолданбаңыз.
- Тазартқышты қолданған кезде өндірушінің қауіпсіздік нұсқауларын және зертханалық қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.
- Құралдың бетін тырнау үшін ешқашан өткір немесе қатты құралды қолданбаңыз.
- Керек-жарақтарды ешқашан тазалағыш ерітіндіге немесе суға батырмаңыз.
- Болат пышақтарды спирт негізіндегі ерітінді немесе ацетонмен тазалаңыз.
- Парафинді тазалау және шығару үшін құрамында ксилолды немесе құрамында спирті бар сұйықтықтарды (мысалы, шыны тазалағыш) қолданбаңыз.



Абайлаңыз

Тазалау кезінде жұз ұстағыштардың бөліктегі ауысы мүмкін.

Кескін сапасы нашар.

- Тазалау кезінде жұз ұстағыштарын өзара ауыстырмаңыз.

2.3 Кірістірілген қорғаныс құралдары



Сақ болыңыз


Өндіруші ұсынған қорғаныс құрылғылары немесе қауіпсіздік керек-жарақтары алынып тасталды немесе өзгертилді.

Үлгілердің зақымдалуын қоса, адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Құралдың қорғаныс құралдарын немесе керек-жарақтарын ешқашан алып тастамаңыз немесе өзгертпеніз. Тек Leica Biosystems біліктілігі бар қызмет көрсетуші қызметкерлер құралды жөндей алады және құралдың ішкі құрамдастарына қол жеткізе алады.
- Құралмен жұмыс жасамас бұрын, барлық қорғаныс құралдары мен қауіпсіздік керек-жарақтарының бар екеніне сенімді болыңыз және олардың мақсатына сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.

2 Қауіпсіздік

2.3.1 Қолмен басқару құралын құлыштау

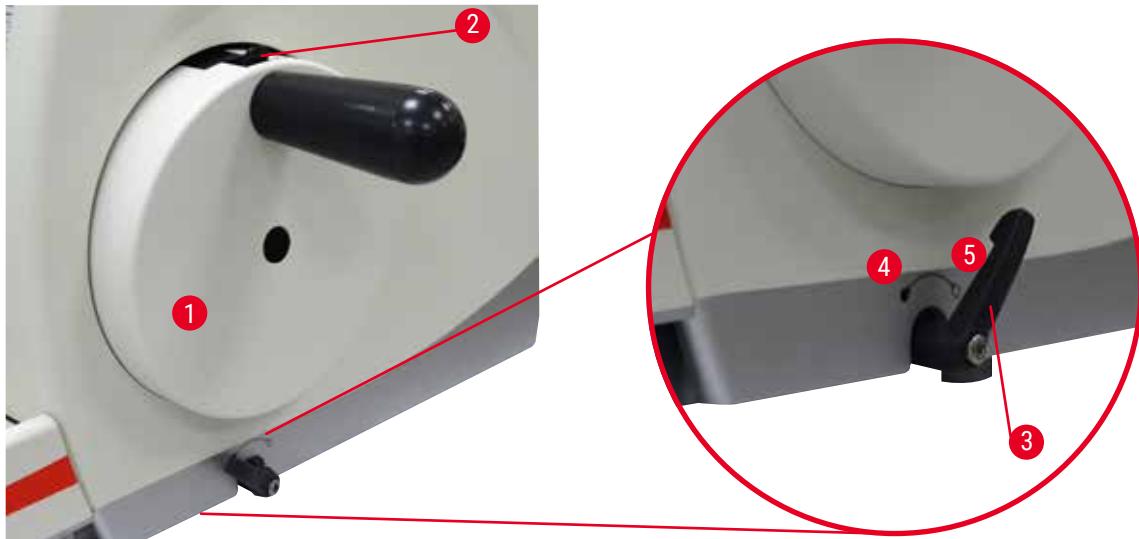

1-сур.

Қолмен басқару құралын ([→ "1-сур. - 1"](#)) құлыштаудың екі әдісі бар:

- Микротомдық негізгі тақтасының оң жағындағы доңғалақ тежегішінің тетігін ([→ "1-сур. - 3"](#)) қолдана отырып, қолмен басқару құралын кез келген қалыпта тежеуге болады.
 - Тежеу үшін, доңғалақ тежегішінің тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта бұрыңыз ([→ "1-сур. - 4"](#)).



Сақ болыңыз

Қолмен басқару құралының тежегіші дұрыс пайдаланылмайды және қолмен басқару құралын тежеуге болмайды.

Құралдың/адамдардың ауыр жарақаты немесе үлгінің зақымдалуы.

- Қолмен басқару құралының тежегіш тұтқасы дәл бекітілген күйде болуы керек. Егер қолмен басқару құралы тежегішінің тұтқасы осы нүктеден асып кетсе, онда қолмен басқару құралы енді тежелмеуі мүмкін.

- Қолмен басқару құралының құлпын ашу үшін, басқару құралының тежегіш тұтқасын ([→ "1-сур. - 3"](#)) бастапқы орнына бұраңыз ([→ "1-сур. - 5"](#)).
- Дөңгелектің жоғарғы жағындағы қолмен басқару құралын ([→ "1-сур. - 2"](#)) қолдана отырып, Қолмен басқару құралын 12 сафаттық күйде тежеуге болады.
 - Руль дөңгелегін құлыштау үшін, доңғалақты бекіту механизмін ([→ "1-сур. - 2"](#)) сыртқа қарай басыңыз және доңғалақты сағат тілімен сағат 12 бағытымен баяу бұруды жалғастырыңыз, ол дәл сағат 12 күйінде бекітілгенше.
 - Қолмен басқару құралының құлпын ашу үшін, доңғалақты бекіту механизмін ([→ "1-сур. - 2"](#)) ішке қарай бұраңыз.



2-сур.

Екі жағдайда да (қолмен басқару құралының тежегіш тұтқасы мен қолмен басқару құралының құлыштау механизмі), **LOCK** сары ЖД ([→ "2-сур. - 1"](#)) жанады.




Кеңес

Екі тежегіш жүйені бір уақытта қолданғанда, қолмен басқару құралының тежегіш тұтқасын (\rightarrow “1-сур. - 3”) әрқашан бірінші күйге (\rightarrow “1-сур. - 5”) жылжытыңыз. Әйтпесе, қолмен басқару құралының бекіту механизмін (\rightarrow “1-сур. - 2”) босату мүмкін болмауы мүмкін.

2.3.2 Пышақ/жұз ұстағышындағы сақтандырғыш

Әрбір жұз ұстағыш тығыз бекітілген сақтандырғышпен жабдықталған (\rightarrow “3-сур. - 1”) (\rightarrow “4-сур. - 1”). Бұл пышақтың немесе жүздің әр позициясында кесу жиегін толығымен жабуға мүмкіндік береді.

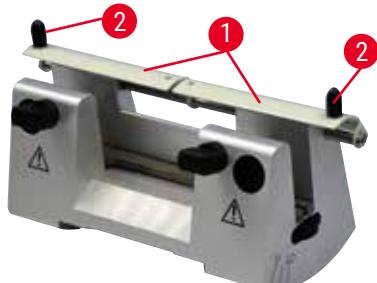


3-сур.

Пышақ ұстағышы N

Пышақ ұстағышының N сақтандырғышын (\rightarrow “3-сур. - 1”) екі тұтқаның (\rightarrow “3-сур. - 2”) көмегімен оңай орналастыруға болады.

Пышақ жиегін жабу үшін сақтандырғыштың екі қапсырмалық жолағын ортаға қарай итеріңіз.

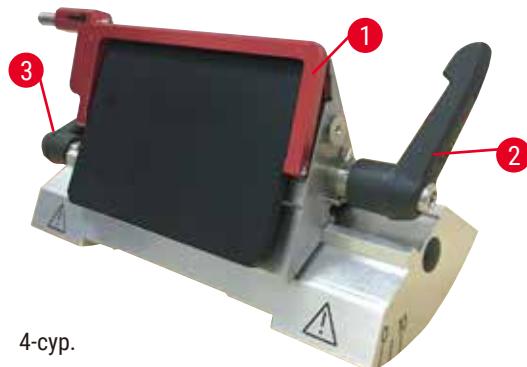

4-сур.

Жоғары және төмен профильді жүздерге арналған екі функциялы “E” пышақ ұстағышы
Екі функциялы “E” пышақ ұстағышындағы сақтандырғыш қызыл бүктелетін тұтқадан (\rightarrow “4-сур. - 1”) тұрады. Кескіш жиекті жабу үшін, (\rightarrow “4-сур.”) суретте көрсетілгендей, сақтандырғыш тұтқасын жоғары қарай бүктеңіз.



Кеңес

Екі функциялы “E” пышақ ұстағышындағы қысқыш тұтқалар бір-бірін алмастыраймыды.
Қысқыштың екі тұтқасы (\rightarrow “4-сур. - 2”) (\rightarrow “4-сур. - 3”) әрқашан көрсетілген қалыпта қалуы керек, әйтпесе екі функциялы “E” ұстағышында оқшауланған ақаулары орын алуы мүмкін.
Жүздің (\rightarrow “4-сур. - 2”) қысқыш тұтқасы оң жақта, бүйірлік ығысуға арналған қысқыш тұтқасы (\rightarrow “4-сур. - 3”) сол жақта.

3 Құралдың құрамдастары мен сипаттамалары

3. Құралдың құрамдастары мен сипаттамалары

3.1 Шолу – құралдың құрамдастары



5-сур.

- | | |
|--|--|
| 1 Жоғарғы науа | 8 Антистатикалық қалдықтар науасы |
| 2 Үлкен беріліс дөңгелегі | 9 Қолмен басқару құралының иінтирегі |
| 3 Бөлек басқару құралы | 10 Бағдарлау және UCC бар заттың басы |
| 4 Микротом негізі | 11 Қолмен басқару құралы |
| 5 Жүз ұстағышының негізі | 12 Қолмен басқару құралын бекіту механизмі |
| 6 Екі функциясы бар "Е" жүз ұстағышы | 13 Құралдың басқару тақтасы |
| 7 Пышақ/жүз ұстағыш негізінің қысқыш тұтқасы | |

Артқы көрініс



6-сур.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Магнит | 4 Қуат көзі |
| 2 Сақтандырғышпен кернеуді таңдау қосқышы | 5 Қалақтар |
| 3 Негізгі қосқыш | 6 Қызметтік қызмет көрсету байланысы |

3.2 Құралдың техникалық сипаттамасы

Бөлек басқару тақтасы бар негізгі құрал, ҚОСУ/ӨШІРУ параметрі арқылы бағдарламаланатын қысқару, үлгіні бағыттаусыз немесе қосымша керек-жарақтарсыз, пайдаланушы таңдай алатын бұрылу бағыттары бар бірегей әргеномикалық орналастырылған электронды бүйірлік ірі беріліс дөңгелегі бар. 100/120/230/240В айнымалы ток, 50/60Гц.

- Жартылай жетекті айналмалы микротом, қадамдық жетегі бар техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейтін және бос жүрісі жоқ дәлдеудің микрометрді беру жүйесі.
- Қөлденең беру және тік соққылардың механизмдері айқас роликті мойынтректерге негізделген.
- Біркелкі жұмыс істейтін қолмен басқару құралы екі қолмен бөлу режимімен қамтамасыз етеді: тербеліс режимі және қолмен басқару құралының көмегімен айналдыру арқылы қолмен бөлу.
- Қолмен басқару құралының екі тәуелсіз құлышптау жүйесі.
- Серіппелі күш реттеуі бар бірегей оператор теңшайтін күш теңестіру жүйесі екі артықшылықты береді:
 1. Жұзге зат басының түсіп кету қаупін болдырмайтын, серіппелі құшті әр түрлі үлгілерге/ қысқыштарға бейімдеу икемділігі.
 2. Қолмен басқару құралына ауыр теңгеру салмақ қажет емес.
- Барлық маңызды басқару элементтері әргеномикалық жұмыс үшін көлбейу бұрышы реттелетін пайдаланушыға ыңғайлы бөлек басқару тақтасында орналасқан.
- Кесуге және бөлуге арналған кесінді қалыңдығының параметрлері бір-біріне тәуелсіз таңдалуы және сақталуы мүмкін.
- Құрылғының алдыңғы жағында жұмыс туралы маңызды ақпарат көрсетілген:
 1. кесу немесе бөлу қалыңдығы,
 2. үлгін кері қайтару (Retract),
 3. Қолмен басқару құралы/үлгі басын құлышптау функциясы (Lock),
 4. қалпына келтіру функциясы бар бөлу есептегіші мен бөлу қалыңдығының жалпы санауышы.
- ҚОСУ/ӨШІРУ функциясы бар бағдарламаланатын үлгіні алу жүйесі.

- Басқару тақтасында біркелкі тербелу режимі функциясы жылдам кесуге арналған. Кері қайтару функциясын өшіруді қажет етпей, қысқа қашықтықта қолмен басқару құралын алға-артқа бұруға мүмкіндік береді. Айналуды анықтаудағы әрбір өзгеріс электронды түрде анықталады және автоматты түрде үлгінің ілгерілеуіне немесе кері тартылуына айналады, бұл кезде кесінділердің таспасы бұзылмайды.
- Мотор арқылы көлденең үлгі басының қозғалысы екі жолмен жүзеге асырылады:
 - Басқару панеліндегі үлкен бери түймелерін әр бағытта үздіксіз немесе сатылы бери режимінде екі жылдамдықпен қолдану.
 - Эргономикалық түрде орналастырылған және пайдаланушы таңдаған бұрылу бағытымен жекелендірілетін бірегей үлкен беріліс дөңгелегні қолдану.
- Көрнекі/акустикалық сигналдар қалған беруді және алдыңғы және артқы жүру шектерін көрсетеді.
- Үлгілерді тиімді және жылдам алмастыру
 - пайдаланушының бағдарламаланатын Жады күйін қолдану арқылы
 - 13 +/- 2 секунд ішінде заттың басын жылдам орналастыру функциясы алдыңғыдан артқа қарай.
- Үстіңгі бетінің үлкен ауданы тегін бетті қажет ететін заттарды орналастыруға мүмкіндік береді.
- Алынбалы табақша кесу құралдарын сақтауға мүмкіндік береді және заттардың құлап кетуіне жол бермейді.

3.3 Техникалық мәліметтер

Жалпы

Номиналды қуат кернеулері	100/120/230/240 В айнымалы ток
Номиналды жиілік	50/60 Гц
Максималды қуат тұтынылуы	40 ВА
Қорғаныс класы	I
Қуат сақтандырғыштары	2 x T 1,0 AL, 250В
Ластау дәрежесі (IEC-1010, UL 3101, EN 61010 бойынша)	2
Кернеудің асып кету санаты (IEC-1010, UL 3101, EN 61010 бойынша)	II
IP қорғау класы	IP20
Жұмыс температурасының диапазоны	+18 °С және +30 °С аралығында
Жұмыс ортасының салыстырмалы ылғалдылығы	20% және 80% аралығында, конденсатсыз
Жұмыс биіктігі	Теңіз деңгейінен 2000 м биіктікке дейін
Тасымалдау температурасының диапазоны	-29 °С және +50 °С аралығында
Сақтау температурасының диапазоны	+5 °С және +50 °С аралығында
Салыстырмалы ылғалдылықта тасымалдау және сақтау	10% және 85% аралығында, конденсатсыз

Өлшемдері мен салмақтары**Негізгі құрал**

Ені (қол дөңгелегі мен үлкен беріліс дөңгелегін қоса)	477 мм
Тереңдігі (қоқыс жәшігін қосқанда)	620 мм
Биіктігі (жоғарғы науасын қоспағанда)	295 мм
Биіктігі (жоғарғы науамен)	303 мм
Салмағы (керек-жарақсыз)	Шамамен 31 кг
Қалдықтар науасының көлемі	1400 мл

Басқару тақтасы

Ені	94 мм
Тереңдігі	193 мм
Биіктігі	50 мм
Биіктік (көлбей күйде)	81 мм
Салмағы (таза)	Шамамен 0,5 кг

Микротом**Бөлу қалыңдығының параметрі**

Бөлу қалыңдығының диапазоны	0,50 - 100 мкм
-----------------------------	----------------

Параметр мәндері	<ul style="list-style-type: none"> 0,5 - 5,0 мкм аралығы, 0,5 мкм қадамымен 5,0 - 20,0 мкм аралығы, 1,0 мкм қадамымен 20,0 - 60,0 мкм аралығы, 5,0 мкм қадамымен 60,0 - 100,0 мкм аралығы, 10,0 мкм қадамымен
------------------	---

Қалыңдықты реттеу диапазоны

Параметр мәндері	<ul style="list-style-type: none"> 1,0 - 10,0 мкм аралығы, 1,0 мкм қадамымен 10,0 - 20,0 мкм аралығы, 2,0 мкм қадамымен 20,0 - 50,0 мкм аралығы, 5,0 мкм қадамымен 50,0 - 100,0 мкм аралығы, 10,0 мкм қадамымен 100,0 - 600,0 мкм аралығы, 50,0 мкм қадамымен
------------------	--

Көлденең беріліс диапазоны

Тік соққы ұзындығы	24 мм ±1 мм
--------------------	-------------

Кері қайтарусыз максималды кесу диапазоны	70 ± 1 мм
---	-----------

Кері қайтарумен максималды кесу диапазоны	65 мм
---	-------

Улғи блогының максималды өлшемі	55 x 50 x 30 мм
---------------------------------	-----------------

Улғи блогының максималды өлшемі	68 x 48 x 15 мм
---------------------------------	-----------------

Колмен кесу режимінде үлгіні кері қайтару	5 - 100 мкм, 5 мкм қадаммен; өшіріле алады
---	--

Микротом

Электрлік үлкен беріліс

- баяу алға және артқа түймелері
- 300 мкм/с
- жылдам алға
- 800 мкм/с
- жылдам артқа (жылдам орналастыру)
- 1800 мкм/с

Есте сақтау күйі

1

Үлкен беріліс дөңгелегінің бұрылу бағыты
сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы

Қолданушы тараудынан таңдала алады

Қосымша керек-жарақтар

Үлгі бағдары, нөлдік күйде

- Көлденең айналу: $\pm 8^\circ$
- Тік айналу: $\pm 8^\circ$

Екі функциялы жұз ұстағышы

- Бүйірлік жылжу функциясы
- 3 күй
- Шығыс-батыс қозғалысы
- Пышақ ұстағыш негізінің жылжуы:
- Солтүстік-оңтүстік: ± 24 мм

4. Құралды баптау

4.1 Орнату алаңына қойылатын талаптар

- Тұрақты, дірілсіз зертханалық үстел көлденен, тегіс үстелмен, мүмкіндігінше дірілсіз жерге.
- Жақын жерде діріл тудыруы мүмкін басқа құралдар жоқ.
- Бөлме температурасы + 18°C пен + 30°C аралығында.
- Қолмен басқару құралына кедергісіз қол жеткізу.
- Құралдың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оны қабырғалар мен жиһаздан кемінде 10 см қашықтықта ұстау керек.
- Құралды ток көзінен оңай ажыратуды қамтамасыз ететін жерге орнату керек. Қуат кабелі оңай қол жететін жерде болуы керек.



Қауіп

Жарылыш қаупі.

Адамдардың өлімі немесе ауыр жарақаты және/немесе заттардың бүлінуі.

- Құралды жарылу қаупі бар бөлмелерде ешқашан қолданбаңыз.

4.2 Стандартты жеткізу - қаптама тізімі

HistoCore MULTICUT конфигурациясы: 14 9MULTI0C1

Саны	Бөлшек сипаттамасы	Тапсырыс №
1	HistoCore MULTICUT негізгі құрал	14 0518 56372
1	Үлгі қысқышына арналған дәл бағыттағыш қондырығы	14 0502 37717
1	Жылдам қысқыш жүйесі	14 0502 37718
1	Әмбебап кассета қысқышы	14 0502 37999
1	Жұз ұстағышының негізі	14 0502 55546
1	2 функциясы бар "Е" жұз ұстағышы	14 0502 54497

HistoCore MULTICUT негізгі құрал келесі жеткізу тізімін қамтиды.

Саны	Бөлшек сипаттамасы	Тапсырыс №
	HistoCore MULTICUT негізгі құрал	14 0518 56372
1	Қолмен басқару құралы, жинақ	14 0501 38181
1	Бөлек басқару тақтасы, HistoCore MULTICUT	14 0518 56384
1	Антистатикалық қалдықтар наусы	14 0517 56237
1	Жоғарғы науа	14 0517 56261
1	Қызметтік бума	14 0503 43948
2	Сақтандырыш ток өткізгіштігі T1,0AL, 250В	14 6000 04804
1	Schnorr қауіпсіздік шайбасы 10x6,4x0,7	14 3017 00073
1	Алтыбұрыш бұрандалар M6x16 DIN7984	14 2101 23130
1	Қақпақ дискіci	14 3025 00008
1	Қолдану жөніндегі нұсқаулық (басылған ағылшын басқа тілдердегі ықшам дискімен 14 0518 80200)	14 0518 80001

Қолданбаңызға сәйкес келетін негізгі құралдарды төменде көрсетілген керек-жарақтармен конфигурациялауға болады. Жұмыс істейтін конфигурацияға ие болу үшін төменде көрсетілген санаттардың кем дегенде бір элементіне тапсырыс беру керек.

Негізгі құрал HistoCore MULTICUT	14051856372	Төмендегілердің барлығы жоқ HistoCore MULTICUT негізгі құралы: бағдарлау, жылдам қысу жүйесі, үлгі қысқыш, пышақ немесе пышақ ұстағышын орнату
---	-------------	--

Біреуін таңдаңыз

Үлгінің бағдары	14050237717	Үлгі қысқышына арналған дәл бағыттағыш қондырғы (*)
	14050238949	Үлгі қысқышына арналған бағыттағыш қондырғы (*)
	14050238160	Үлгі қысқышына арналған қатаң бекітпе

(*) көмегімен бекітпені бағдарлауға қосымша тапсырыс беру керек

Жылдам қысу жүйесі (*)	14050237718	Жылдам қысу жүйесі (*)
-------------------------------	-------------	------------------------

Кем дегенде бір үлгі қысқышына тапсырыс беріңіз

Үлгі қысқыштары	14050237999	Әмбебап кассета қысқышы
	14050238005	Стандартты үлгі қысқышы 50x55 мм
	14050237998	Стандартты үлгі қысқышы 40x40 мм
	14050238967	Супер кассеталы қысқышы
	14050246573	RM CoolClamp

Кем дегенде бір пышақ немесе жұз ұстағыш негізіне және бір пышақ немесе жұз ұстағышқа тапсырыс беріңіз

Жұз ұстағышының негізі және жұз ұстағышы	14050255546	Жұз ұстағышының негізі
	14050254497	2 функциясы бар "Е" жұз ұстағышы
Пышақ ұстағыш негізі және пышақ ұстағыштары	14050237962	Пышақ ұстағыш негізі
	14050237993	Пышақ ұстағышы N
	14050238961	Төмен профильді "Е" пышақ ұстағышы

Қосымша қосалқы керек-жарақтар мен пышақтарды/жұздерді 6 тарауда ([→61-6. – 6. Қосымша керек-жарақтар](#)) табуға болады.

Елге сәйкес қуат сымына бөлек тапсырыс беру қажет. Өнім бөлімінде www.LeicaBiosystems.com веб-сайтынан құрылғының үшін қолжетімді барлық қуат сымдарының тізімін таба аласыз.



Кеңес

Тапсырыс берілген керек-жарақтар бөлек қорапқа салынған.

Жеткізудің аяқталғанын тексеру үшін барлық жеткізілген бөлшектерді қаптама тізімімен және тапсырысыңызben тексеріңіз. Егер сәйкесіздіктер табылса, Leica Biosystems сату кеңесесіне дереу хабарласыңыз.

4.3 Қаптамадан шығару және орнату



Сақ болыңыз

Қаптамадан шығару кезінде керек-жарақтар/құрал бумадан түсіп қалу қаупі.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мұліктік зақым.

- Құралды қаптамадан шығарғанда абай болыңыз.
- Қаптамадан шығарылғаннан кейін құралды тек тік күйде ғана жылжыту керек.
- Қаптаманың сыртына салынған қаптамадан шығару нұсқаулығында берілген нұсқауларды немесе Пайдалану нұсқаулығында сипатталған әрекеттерді мұқият орындаңыз.



Сақ болыңыз

Құрал тиісінше көтерілмеген.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мұліктік зақым.

- Құралды көтергенде оны пайдалану нұсқаулығында және қаптамадан шығару нұсқаулығында сипатталған көтеру нұктелерінде ғана ұстаңыз (құралдың алдыңғы және артқы жағындағы негізгі белгі).
- Құралды ешқашан доңғалақ тұтқасынан, электрлік үлкен беріліс дөңгелегінен немесе нысан басынан көтермеңіз.
- Құралды тасымалдау алдында әрқашан қоқыс жәшігін алып тастаңыз.



Сақ болыңыз

Құралдың абайсызда қозғалуы.

Қол және/немесе саусақтардың құрал және жұмыс бетінің арасында қысылып қалуы салдарынан туындастын ауыр жарақат.

- Құралды көтергенде оны пайдалану нұсқаулығында және қаптамадан шығару нұсқаулығында сипатталған көтеру нұктелерінде ғана ұстаңыз (құралдың алдыңғы және артқы жағындағы негізгі белгі).
- Құрал мен жұмыс бетінің арасында қолдың қалып қалмайтынына көз жеткізіңіз.



Сақ болыңыз

Құрал барлық 4 аяғымен қауіпсіз түрде лабораториялық үстелге тиісінше қойылмауы.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мұліктік зақым.

- Құралды көлденең, беті тегіс болатын тұрақты, дірілсіз лабораториялық үстелге қойыңыз. Еден мүмкіндігінше дірілсіз болуы керек.
- Әр 4 аяқтың зертханалық үстелге толық қойылғанына әрқашан көз жеткізіңіз.
- Егер құралды басқа адамдар қозғаған болса (мысалы, қызмет көрсету үшін), оның дұрыс орналасуын әрқашан қайталап тексеріңіз.

**Абайлаңыз**

Керек-жарақтар/бөлшектер тасымалдау кезінде босап қалған/булінген.

Мүліктің бүлінуі немесе диагностика кідірісі.

- Қаптамада ShockDot әсерінің индикаторы бар, бұл тасымалдаудың дұрыс еместігін көрсетеді. Құрал жеткізілген кезде алдымен келесіні тексеріңіз. Егер индикатор қосылған болса, бума көрсетілгендей тасымалданбаған. Бұл жағдайда жөнелту құжаттарын тиісті түрде белгілеп, жөнелтілімге зақым келгенін тексеріңіз.

**Кеңес**

Кейінірек қайтару қажет болған жағдайда тасымалдау картоны мен бекіту элементтері сақталуы керек. Құралды қайтару үшін төмендегі нұсқауларды көрі ретпен орындаңыз.



7-сур.

- Қаптама таспасы мен жабысқақ таспаны алыңыз (→ "7-сур. - 1").
- Картон қақпағын алыңыз (→ "7-сур. - 2").



- Жеткізудің стандартты көлеміне арналған қосымша картонды (қосымша керек-жарақтар) (→ "8-сур. - 3") және қораптарды (→ "8-сур. - 4") алыңыз.




8-сур.

- Бекіту модулін ([→ "9-сур. - 5"](#)) алыңыз. Мұны істеу үшін оны модульдің жоғарғы шетінен және ойық тұтқасынан ([→ "9-сур. - 6"](#)) ұстап, жоғары қарай тартып шығарыңыз.
- Сыртқы картон қабырғасын ([→ "9-сур. - 7"](#)) алыңыз.
- Құралды ([→ "9-сур. - 8"](#)) алдыңғы ([→ "10-сур. - 11"](#)) және артқы ([→ "10-сур. - 12"](#)) жағындағы негізгі тақтайшадан ұстап көтеріп, қалыптан ([→ "9-сур. - 9"](#)) шығарыңыз. (Құралдың суреті тек мысал ретінде берілген.)



9-сур.

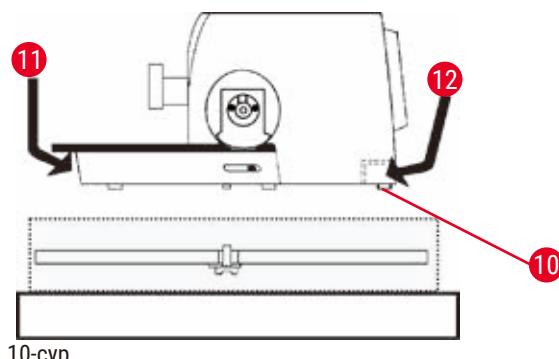

10-сур.


- Құралды тұрақты зертханалық үстелге қойыңыз. Негізгі тақтаның артқы жағында орналасқан екі жылжымалы элемент ([→ "10-сур. - 24"](#)) құралды үстелге жылжытуды жеңілдетеді.
- Құралды жылжыту үшін оны негізгі тақтаның ([→ "10-сур. - 11"](#)) алдыңғы жағынан ұстап тұрып, ақырын көтеріп, сырғытпаларында сырғытыңыз.

4.4 Қолмен басқару құралын жинау



Кеңес

Қолмен жұмыс жасамас бұрын дөңгелекті жинау керек. Қажетті бөлшектер мен құралдарды жеткізілімде берілген құралдар жиынтығынан табуға болады.

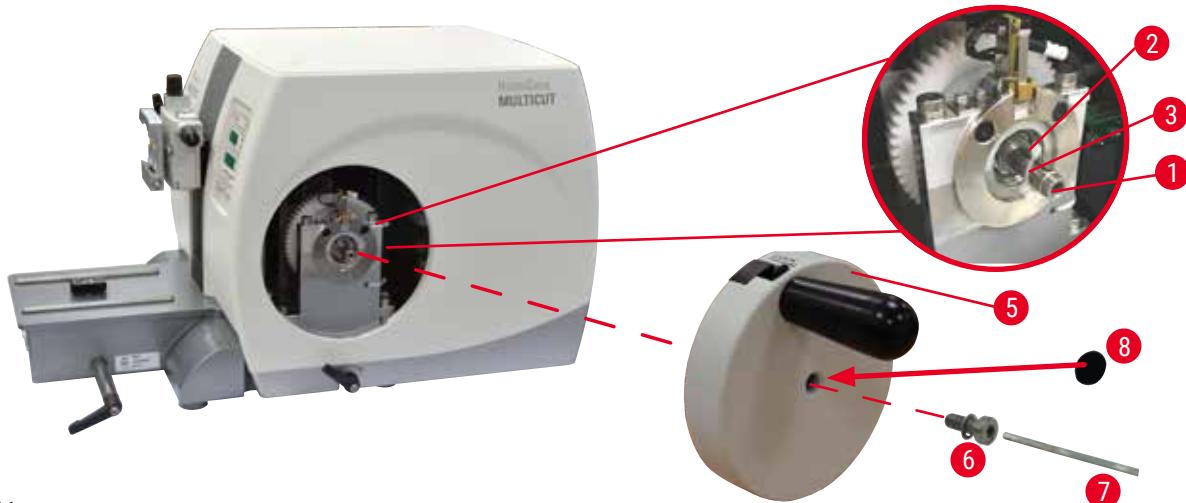

11-сүр.

Сына (\rightarrow "11-сүр. - 2") қолмен басқару құралының білігіне (\rightarrow "11-сүр. - 1") еркін орналастырылады және тасымалдау кезінде кабель байланымен орнына бекітіледі.

1. Кабель байланысын (\rightarrow "11-сүр. - 3") алыңыз.



Абайлаңыз

Қолмен басқару құралын орнатқанда сына жоғалады.

Құралды қолдануға болмайды, бұл диагностиканы кідіртуі мүмкін.

- Қолмен басқару құралын жинамас бұрын, сынаны тексеріп, оның дөңгелектің білігінде екеніне көз жеткізіңіз.

2. Қолмен басқару құралын (\rightarrow "11-сүр. - 5") суретте көрсетілгендей қолмен басқару құралының білігіне (\rightarrow "11-сүр. - 1") қойыңыз.
3. Қолмен басқару құралының ортаңғы тесігінде орналасқан бұранданы (\rightarrow "11-сүр. - 6") №4 алтыбұрыш кілтімен қатайтыңыз (\rightarrow "11-сүр. - 7").
4. Өздігінен жабысатын қақпақ дискісінен (\rightarrow "11-сүр. - 8") қақпақ фольганы алып тастаңыз және қолмен басқару құралындағы қақпақ дискісін бекітіңіз.

4.5 Электр қосылыстары

Сақ болыңыз

Құралды жерге түйікталмаған розеткаға қосу немесе ұзартқыш сымды қолдану.

Адамдардың жарақат алуына немесе диагноздың кідірісіне әкелетін электр тогымен соғу қаупі.

- Құрал жерге түйікталған розеткаға қосылуы керек.
- Ұзартқышты қолданбаңыз.

4.5.1 Кернеуді тексеру

HistoCore MULTICUT әр түрлі электр желілеріне қосуға болады (кернеу мен жиілікке байланысты). Жаңа құралдар зауытта 230 вольтке орнатылған. Бұл құралдың артқы жағында қуат қосқышы мен розетканы жабатын сары жапсырмамен (230 ВОЛЬТ) құжатталған.




Сақ болыңыз

Кернеу селекторында таңдалған қуат көзінің кернеуі қате.

Құралдың зақымдалуы, үлгіні өңдеудегі кідіріс.

- Құралды қоспас бұрын, оны желіге қоспас бұрын желіге сәйкес кернеуді таңдап алыңыз.
- Кернеу селекторының параметрін өзгерту кезінде құралды желіден ажырату қажет.

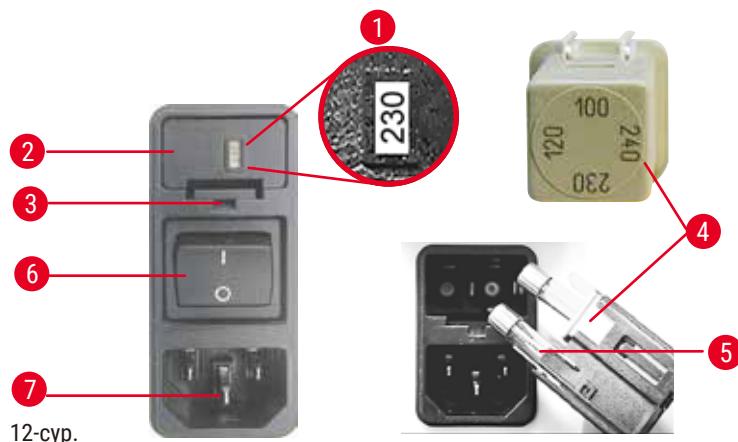


Кернеу селекторы негізгі қуат қосқышының үстінде, құралдың сол жақ артқы жағында орналасқан. Кернеу параметрі қараша терезесінде ([→ "12-сур. - 1"](#)) көрсетіледі.

1. Кішкене бұрағышты ұяшықа ([→ "12-сур. - 3"](#)) салыңыз да, кірістіруді абайлап шығарыңыз.
2. Сақтандырғыштармен ([→ "12-сур. - 5"](#)) бірге кернеу селекторының корпусын ([→ "12-сур. - 2"](#)) алыңыз. Кернеу селекторының блогын ([→ "12-сур. - 4"](#)) (ак) алғып тастаңыз және оны қараша терезесінде ([→ "12-сур. - 1"](#)) дұрыс жергілікті кернеу көрсетілетін етіп қайта салыңыз.
3. Кернеу таңдағыш корпусын блок пен сақтандырғыштармен қайта салыңыз және ол кіргенше итеріңіз (дыбыстық шерту).

4.5.2 Қуат көзіне қосу

- Қуат кабелін қоспас бұрын, құралдың артқы жағындағы қуат қосқышының ([→ "12-сур. - 6"](#)) "0" = OFF (ӨШІРУЛІ) күйіне қосылғанын тексеріңіз.
- Қолданылатын қуат кабелінің розетка үшін дұрыс ашасы бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуат кабелінің қосқышын розеткаға ([→ "12-сур. - 7"](#)) қосыңыз және ашаны розеткаға қосыңыз.

4.5.3 Басқару тақтасын қосу

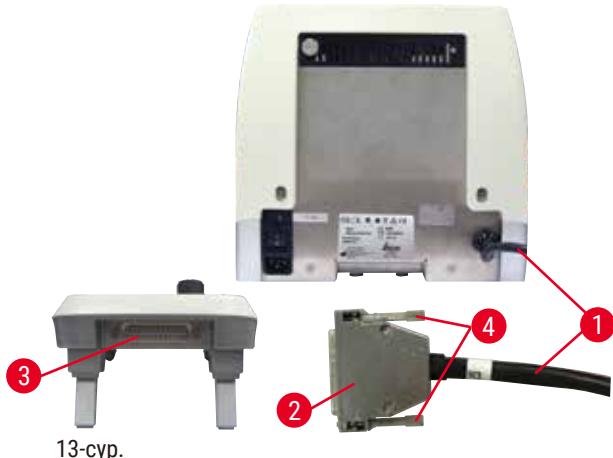

Басқару панелінің қосқыш кабелі (\rightarrow "13-сүр. - 1") микротомға бекітілген. Оны ажыратуға болмайды.

1. Байланыс кабелінің ашасын (\rightarrow "13-сүр. - 2") басқару тақтасының артындағы жалғағыш үяға (\rightarrow "13-сүр. - 3") салыңыз.
2. Тығынды бекіту үшін екі бұранданы қатайтыңыз (\rightarrow "13-сүр. - 4").

4.6 Құралды қосу



Сақ болыңыз

Құрал ішіндегі конденсация температуралың және ауаның жоғары ылғалдылығының айтарлықтай айырмашылығына байланысты болады.


Құралдың зақымдалуы.

- Әрқашан сақтау үшін де, пайдалану үшін де климаттық шарттардың тиісті екеніне көз жеткізіңіз. Техникалық мәліметтер бөлімін (\rightarrow 26-б. – 3.3 Техникалық мәліметтер) қараңыз.
- Құралды жеткізгеннен кейін оны қосар алдында қоршаған орта температурасына бейімделуіне мүмкіндік беру үшін кемінде екі сағат күтіңіз.



Кеңес

Құралды қуат қосқышымен қосқан кезде, белгілі бір функцияларды орнатудан басқа, басқару тақтасының ешбір түймесін баспаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін қараңыз: (\rightarrow 40-б. – Түймелер тіркесімі).

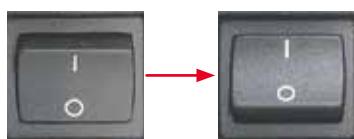

Құралды артқы жағындағы қуат қосқышымен қосыңыз.

I = ҚОСУЛЫ; O = ӨШІРУЛІ

Осыдан кейін дыбыстық сигнал беріледі.

Құрал іске қосылады.

00.00

Бағдарламалық жасақтама нұсқасының дисплейі (тек мысал ретінде) төрт таңбалы диодты дисплейде болады. Бұл дисплей 2 секундтан кейін жоғалады және “00.00” көрсетіледі. Микротомды қосқаннан кейін құралдың басқару тақтасында және дисплей өрісінде барлық қосылған функциялардың дисплей өрістері мен ЖД жанады.

03.0

TRIM

SECT

Үш таңбалы ЖД дисплейі қай параметр соғы рет қосылғанына байланысты бөлімнің қалыңдығына немесе кесу қалыңдығына орнатылған соғы мәнді көрсетеді. Бұл бір уақытта басқару панелінде және микротомада көрсетіледі. Белсенді режимнің ЖД (мұнда қиманың қалыңдығы) жасыл түспен жанады.

LOCK

Егер басқару панелінің **LOCK** өрісіндегі сары ЖД жанса, онда қолмен басқару құралының құлыштау механизмі немесе қолмен басқару құралының тежегіш тұтқасы қосылады. Құрылғыны ЖД жанбайынша пайдалануға болмайды.

5. Басқару

5.1 Басқару элементтері және олардың функциялары

Микротомның жұмыс функциялары басқару панелі мен микротомдағы дисплей блогы арасында бөлінеді. Құралдың басқару тақтасы ағымдағы жұмыс режимін, сондай-ақ әр түрлі параметрлерді көрсетеді. Барлық жұмыс функциялары орталықтан бөлек басқару тақтасында орналасқан. Барлық түймелер мен дисплейлер логикалық түрде функционалды топтарға бөлінген және оларды оңай анықтауға болады.




Сақ болыңыз

Бағдарламалық жасақтаманы қате түзету.

Үлгінің зақымдалуы және/немесе диагностиканың кідірісі.

- Бағдарламалық қамтым тұрып қалған жағдайда Ақаулықтарды жою және пайдалану тарауларында берілген нұсқауларды орындаңыз.
- Егер құрал бірден іске қосыла алмаса, оған зақым келтірмеу үшін үлгінің дұрыс сақталғанына көз жеткізіңіз.
- Қажет болса, Leica Biosystems қызмет өкіліне хабарласыңыз.

5.1.1 Құралдың басқару тақтасы

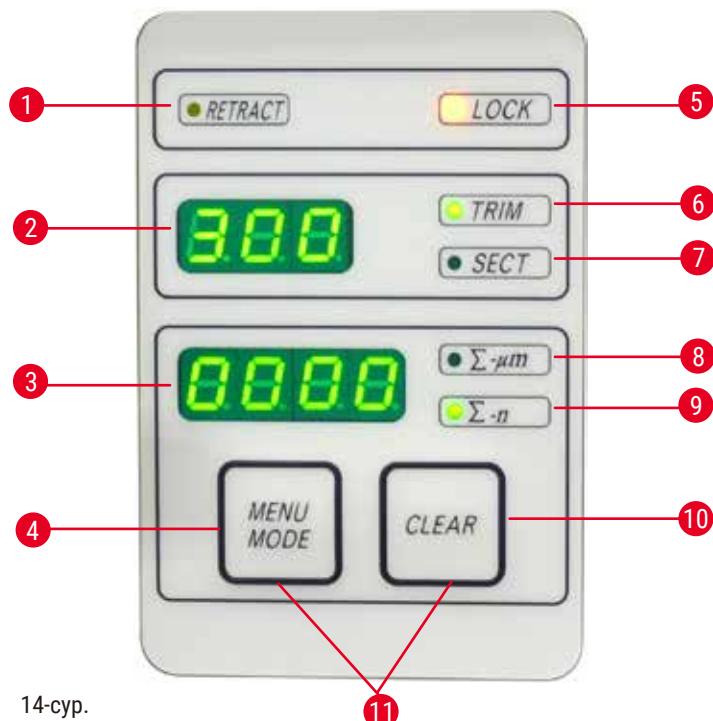


14-сур.

- | | |
|------------------------|--|
| 1 ЖД - RETRACT | Үлгіні кері қайтару кезінде жанады. |
| 2 Уш таңбалы дисплей | Бөлік қалыңдығын/кесу қалыңдығын және басқа параметрлерді көрсетеді. |
| 3 Төрт таңбалы дисплей | Бөлімнің есептегіш нөмірін көрсетеді. |
| 4 MENU MODE түймесі | Бөлік қалыңдығының қосындысы мен бөлік есептегіші арасындағы өзгерістер. |

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 5 | ЖД - LOCK | Қолмен басқару құралының құлпы белсенді болған кезде жанады. |
| 6 | Жасыл ЖД - TRIM | Кесу режимі қосылған кезде жанады. |
| 7 | Жасыл ЖД - SECT | Бөлу режимі қосылған кезде жанады. |
| 8 | Жасыл ЖД | Бөлік қалыңдығының қосындысы - барлық бөліктердің қосындысын көрсетеді. |
| 9 | Жасыл ЖД | Бөлім санағышы - барлық бөлімдердің санын көрсетеді. |
| 10 | CLEAR түймесі | Бөлім есептегіші мен бөлім қалыңдығының қосындысын қалпына келтіреді (0-ге дейін). |
| 11 | MENU MODE + CLEAR | Бір уақытта екі түймені басу қайтару мәнін орнатуға ауысады. |

5.1.2 Бөлек басқару құралы

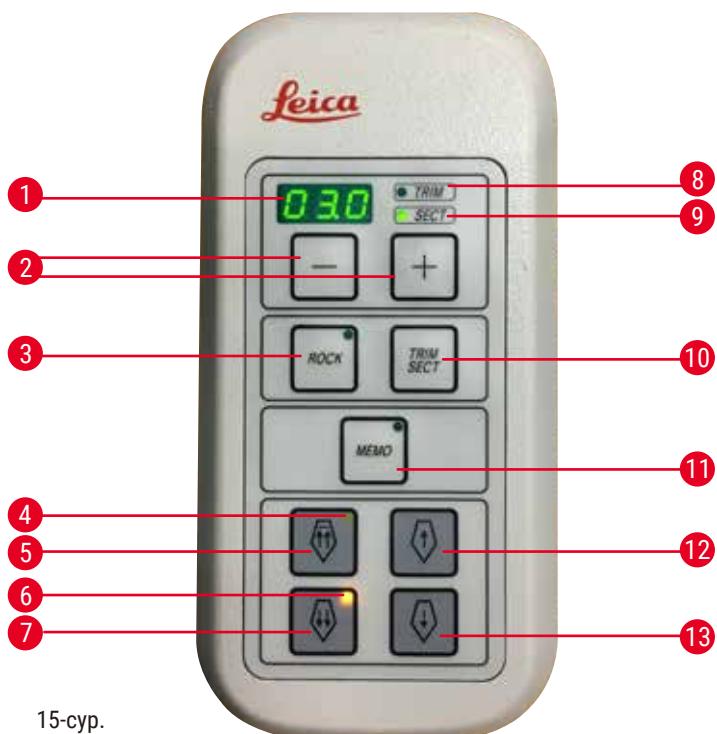

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Үш таңбалы дисплей | Бөлік қалыңдығын/кесу қалыңдығын және басқа параметрлерді көрсетеді. |
| 2 | Түймелер | Бөлім қалыңдығын/кесу қалыңдығын орнатады. |
| 3 | ROCK түймесі | Тербелу режимін қосады/өшіреді. |
| 4 | Сары ЖД | <ul style="list-style-type: none"> Үлкен беріліс кезінде кері жыптылықтайды; Артқы позицияға жеткенде жанады. |
| 5 | Үлкен беріліс түймесі - жылдам артқа | <ul style="list-style-type: none"> Кесу/бөлу режимінде: артқа қарай жылдам беру; Бөлу режимінде (Қадамдық режим қосулы): бірнеше қадам артқа. |
| 6 | Сары ЖД | <ul style="list-style-type: none"> Үлкен беріліс кезінде жыптылықтайды; Қалған беріліс аймағына жеткенде жанады. |

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 7 Улken беріліс түймесі - жылдам алға | • Кесу/бөлу режимінде: жылдам алға қарай жылдам беру; |
| | • Бөлу режимінде (Қадамдық режим қосулы): алға бірнеше қадам. |
| 8 Жасыл ЖД - TRIM | Кесу режимі қосылған кезде жанады. |
| 9 Жасыл ЖД - SECT | Бөлу режимі қосылған кезде жанады. |
| 10 TRIM/SECT түймесі | Бөлу режимі мен кесу режимі арасында ауысады. |
| 11 MEMO түймесі | Бір жады позициясын орнатады. |
| 12 Улken беріліс түймесі - баяу артқа | • Кесу/бөлу режимінде: үлken беріліс артқа баяу; |
| | • Бөлу режимінде (Қадамдық режим қосулы): бір қадам артқа. |
| 13 Улken беріліс түймесі - баяу алға | • Кесу/бөлу режимінде: үлken беріліс баяу; |
| | • Кесу режимінде (Қадамдық режим қосулы): бір қадам алға. |

Түймелер тіркесімі

Түймелер тіркесімі	Функция
MENU MODE + CLEAR түймесі	Қайтару мәнін орнатыңыз.
Құралды қосу + “минус” түймесі	STEP (ҚАДАМ) режимін өшіріңіз.
Құралды қосу + “плюс” түймесі	STEP (ҚАДАМ) режимін іске қосыңыз.
Құралды қосу + Баяу артқа түймесі	Улken беріліс дөңгелегінің бағытын сағат тіліне қарсы бағытта қойыңыз.
Құралды қосу + Баяу алға түймесі	Улken беріліс дөңгелегінің бағытын сағат тілінің бағытымен алға айналдырыңыз.


5.1.3 Дисплей және басқару элементтері

Үш таңбалы дисплей



Бұл дисплей құралдың басқару тақтасында да, бөлек басқару тақтасында да орналасқан. Егер **SECT** ЖД жанса, дисплейде бөлім қалыңдығы параметрі мкм мәнінде көрсетіледі. Егер **TRIM** ЖД жанса, дисплейде кесу қалыңдығының параметрі мкм мәнінде көрсетіледі.

Бөлу және кесу режимін таңдау



Бөлу режимі мен кесу режимі арасында ауысу үшін бөлек басқару тақтасындағы **TRIM/SECT** түймесін басыңыз. Түйме басылған сайын, дисплей **SECT** және **TRIM** арасында ауысады. **SECT** дисплейінде 0,50 ден 100,0 мкм дейінгі бөлімнің қалыңдығы, ал **TRIM** дисплейінде 1,0 мен 600 мкм арасындағы кесу қалыңдығы көрсетіледі.

Бөлім қалыңдығын/кесу қалыңдығын орнату



Бөлек басқару тақтасындағы осы екі түймені пайдаланып параметрлерді реттеңіз.

Бөлу қалыңдығының диапазоны: 0,50 мкм - 100 мкм

Параметр мәндері:

0,5 мкм - 5,0 мкм аралығы, 0,5 мкм қадамымен

5,0 мкм - 20,0 мкм аралығы, 1,0 мкм қадамымен

20,0 мкм - 60,0 мкм аралығы, 5,0 мкм қадамымен

60,0 мкм - 100,0 мкм аралығы, 10,0 мкм қадамымен

Қалыңдықты реттеу диапазоны: 1 - 600 мкм

Параметр мәндері:

1,0 мкм - 10,0 мкм аралығы, 1,0 мкм қадамымен

10,0 мкм - 20,0 мкм аралығы, 2,0 мкм қадамымен

20,0 мкм - 50,0 мкм аралығы, 5,0 мкм қадамымен

50,0 мкм - 100,0 мкм аралығы, 10,0 мкм қадамымен

100,0 мкм - 600,0 мкм аралығы, 50,0 мкм қадамымен

Улken беріліс функциялары



16-сур.

Үлгіні пышаққа қарай және одан кері тез жылжыту үшін екі жылдамдықтағы электрлік үлкен беріліс қолданылады.

Қос көрсеткі түймелерінің көмегімен өрескел беру алға қарай жылжу кезінде 800 мкм/с жылдамдықта жұмыс істейді; бір көрсеткі түймелерінің көмегімен ол алға және артқа жылжу кезінде 300 мкм/с жылдамдықта жұмыс істейді.

Бөлу режимінде үлкен жетекті STEP режимінде немесе үздіксіз беру кезінде қолдануға болады. Құрал үздіксіз берілумен жеткізіледі (стандартты конфигурация).

Жылдам орналастыру

Жылдам артқа үлкен беріліс түймесін басыңыз ([→ "16-сур. - 1"](#)), объектінің басы алдыңғы шеткі күйден бастапқы күйге 1800 мкм/с жылдамдықпен жылжиды.



Абайлаңыз

Электронды үлкен беріліс дөңгелегінің тез итеру немесе жады күйіне жылжыту кезіндегі бұрылуы.

Үлгі зақымдалған.

- Жедел күйге келтіру немесе жад күйіне жылжу кезінде электронды үлкен беріліс дөңгелегін ұстамаңыз.




Абайлаңыз

Қолмен дөңгелекті айналдыру немесе бөлек басқару тақтасындағы немесе құралдарды басқару панеліндегі түймелерді басу, жылдам қосылу немесе жад күйіне өту.

Үлгі зақымдалған.

- Жылдам қосылу кезінде немесе жад күйіне жылжу кезінде дөңгелекті айналдырмаңыз немесе бөлек басқару панеліндегі немесе құралдың басқару панеліндегі еш түймені баспаңыз.

Бөлу режимі

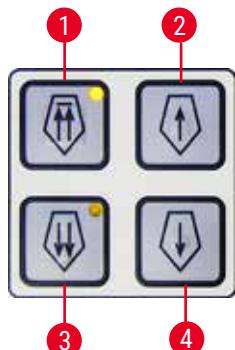

17-сур.


Бөлу режимінде пайдаланушы STEP функциясын (үлгіні кезең-кезеңмен беру) және үздіксіз үлгіні беруді таңдай алады.

Үздіксіз беру таңдалған кезде, үлкен беріліс түймелері кесу режиміндегі функцияларды орындаиды. STEP функциясы үлгіні пышақта қарай біртіндеп мұқият жақындану үшін ыңғайлы.

STEP функциясын қалай қосуға болады:

- Басқару тақтасындағы + түймесін басып тұрып, құралды қосыңыз. (Дәл осылай - түймесін басу кезінде құралдың қосқышын өшіру үшін.) Құрал іске қосылған кезде, бағдарламалық жасақтама нұсқасының нөмірі көрсетілмейінше + түймесін басып тұрыңыз.
- **TRIM/SECT** түймесін басып, секция режимін таңдаңыз (**SECT** ЖД жанады).
- Баяу үлкен беріліс түймесін (→ “17-сур. - 2”) немесе (→ “17-сур. - 4”) басқанда баяу жылдамдықта үлкен берілісте, дисплейде сәйкес бағытта (бір сатылы) анықталған, қадамдық беру жүзеге асады (STEP (ҚАДАМ)).
- Жылдам үлкен беріліс түймелерін қысқа қосу арқылы бір қадам да тиісті бағытта орындалады.
- Үлкен беріліс батырмасын (→ “17-сур. - 1”) немесе (→ “17-сур. - 3”) неғұрлым ұзақ қосу қайталауды беріліс қозғалысына әсер етеді.

Кесу режимі

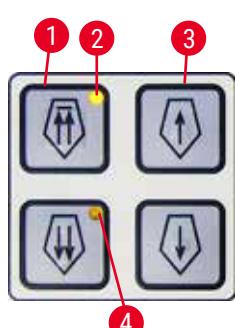


18-сур.

Кесу алу режимінде, түймені ұстап тұру кезінде үлкен беріліс түймелері үздіксіз қозғалысты орындаиды. Артқа кері жылдам қозғалыстарға арналған қос көрсеткі түймесі құлыптау функциясына ие.

Саусақтарыңыз қысылмауы үшін оларды қысқыш және микротомның арасына қоймаңыз.

- Жылдам артқа қозғалысты бастау үшін (пышақтан алыс) батырманы (→ “18-сур. - 1”) басыңыз. Түйме басылғаннан кейін үлгінің басы артқы соңғы күйге жылжиды.
- Қозғалысты тоқтату үшін төрт үлкен беріліс түймесінің кез келгенін басыңыз.
- Үлгі басы қозғалыста болған кезде түймедегі сары ЖД (→ “18-сур. - 2”) жыптылықтайды және артқы шеткі жағдайға жеткенде үздіксіз жанып тұрады.
- Баяу артқа қозғалысты бастау үшін түймені (→ “18-сур. - 3”) басыңыз. Қозғалыс түйме басылғанша жалғасады.
- Жылдам немесе баяу алға қозғалысты бастау үшін сәйкес түймені басыңыз. Қозғалыс түйме басылғанша жалғасады.
- Алға жылжу кезінде түймедегі сары ЖД (→ “18-сур. - 4”) жыптылықтайды. Алдыңғы позицияға жеткенде дыбыстық сигнал естіледі және ЖД жыптылықтауын тоқтатады және жанып тұрады.

Бір жады күйі

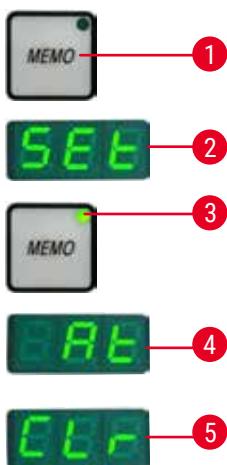

19-сур.

Бөлек басқару тақтасындағы **MEMO** түймесін (\rightarrow "19-сур. - 1") пайдаланып жадының бір орнын орнатыңыз.

Жадтың бір орнын орнату үшін объектінің басын қажетті орынға жылжытыңыз және **MEMO** түймесін басыңыз. Қысқа дыбыс естіледі; үш таңбалы дисплей **SEt** (\rightarrow "19-сур. - 2") белгісін көрсетеді; **MEMO** түймесінің жарық диоды (\rightarrow "19-сур. - 3") жасыл түспен жанады.

Егер жадының бір позициясы сақталса, **MEMO** түймесін басқаннан кейін объект басы жады орнына аудысады; қысқа дыбыстық сигнал естіледі және үш таңбалы дисплей объектінің басы жад орнына жеткенде **At** (\rightarrow "19-сур. - 4") белгісін береді.

Сақталған жад орнын өзгерту үшін объектінің басын жаңа орынға жылжытыңыз және **MEMO** түймесін шамамен 1 секунд басыңыз. Қысқа дыбыс естіледі; үш таңбалы дисплей **SEt** көрсетеді; **MEMO** түймесінің жасыл жарық диоды үнемі жаңып тұрады.

Жады орнын тазарту үшін **MEMO** түймесін 3 секундтан артық басыңыз. Екі қысқа дыбыстық сигнал естіледі; үш таңбалы дисплей **CLr** (\rightarrow "19-сур. - 5") жазуы көрсетіледі; **MEMO** түймесінің жасыл ЖД сұр түспен жанады.



Кеңес

Заттың басы жады күйіне жылжып жатқанда, қозғалысты **MEMO** түймесін немесе кез келген басқа түймелерді басу арқылы немесе электронды үлкен беріліс дөңгелегін бұру арқылы тоқтатуға болады.

MEMO түймесі алдыңғы шектік позиция (қосылмаған) мен бастапқы позиция (қосылмаған) арасында қосылады.



Абайлаңыз

Жад күйін орнатқаннан кейін пышақ/жұз ұстағышының және/немесе зат басының қолмен жылжытылуы.

Үлгінің зақымдалуы.

- Пышақ/жұз ұстағышын, ұстағыш негізін және/немесе заттың басын жылжытпаңыз және жадының орнын өзгерпестен бағдарын қайта реттеменіз.



Абайлаңыз

Электронды үлкен беріліс дөңгелегінің тез итеру немесе жады күйіне жылжыту кезіндегі бұрылуы.

Үлгі зақымдалған.

- Жедел күгіге келтіру немесе жад күйіне жылжу кезінде электронды үлкен беріліс дөңгелегін ұстамаңыз.



Абайлаңыз

Қолмен дөңгелекті айналдыру немесе бөлек басқару тақтасындағы немесе құралдарды басқару панеліндегі түймелерді басу, жылдам қосылу немесе жад күйіне өту.

Үлгі зақымдалған.

- Жылдам қосылу кезінде немесе жад күйіне жылжу кезінде дөңгелекті айналдырмашыз немесе бөлек басқару панеліндегі немесе құралдың басқару панеліндегі еш түймені баспаңыз.

**Абайлаңыз**

Жад күйі пышаққа/жұзге тым жақын орнатылған.

Улгі зақымдалған.


- Жадтың күйін орнатқанда, үлгінің пышақ/жұздің кесу жиегіне тимейтініне көз жеткізіңіз. Егер кесу жиегі үлгіге тиіп кетсе немесе жад күйін орнатқанда үлгі бетіне өте жақын орналасса, объектінің басын сәл артқа жылжытыныз.
- Әр түрлі қалыңдықтағы үлгінің бір жады күйіне жүктеменіз.

**Абайлаңыз**

Құрал өшірілгеннен кейін немесе электр қуаты өшкеннен кейін жадтың орнын қалпына келтіре алмау.

Үлгінің зақымдалуы.

- Құрал өшірілгенде немесе электр қуаты өшкенде, бұрын сақталған жад орны туралы деректер өshedі. Құралды қосқаннан кейін жад күйін қайтадан орнатыңыз.

Құралдың басқару панеліндегі төрт таңбалы дисплей

Төрт таңбалы дисплейде көрсетілетін мәнді реттеуге болады.

Σ-мт ЖД ([→ "20-сур. - 1"](#)) жаңған кезде, дисплейде құрал қосылғаннан кейін аяқталған барлық секциялар үшін кесінді қалыңдығының мкм қосындысы көрсетіледі.

Σ-п ЖД ([→ "20-сур. - 2"](#)) жаңғанда, дисплейде бұрын аяқталған барлық бөлімдердің саны көрсетіледі.

- Дисплей режимін өзгерту үшін қалаған режимнің ЖД жаңғанша **MENU MODE** түймесін ([→ "20-сур. - 3"](#)) басыңыз.
- Бөлім қалыңдығының қосындысын немесе бөлім нөмірін қалпына келтіру үшін **CLEAR** түймесін ([→ "20-сур. - 4"](#)) басыңыз.
- Бұл тек ағымдағы мәнді қалпына келтіреді.

**Кеңес**

Құрылғы негізгі қуат қосқышының көмегімен өшірілгенде, екі мән де (қиманың қалыңдығының қосындысы мен қиманың нөмірі) жадтан өшіріледі.

Үлгінің кері тартылуы


Пышақ пен үлгінің зақымдалуын болдырмау үшін, заттың басының жоғарғы бастапқы орнына қайтару кезінде үлгі пышақтан алыстатастылады.

Қысқарту мәні 5 мкм қадамымен 5 және 100 мкм аралығында таңдалуы мүмкін. Үлгіні алу зауытта 10 мкм-ге орнатылған.


Қажет болса, үлгі қысқартылуын өшіруге болады.

Таңдалған параметр құрал өшірілген кезде сақталады.

Керу қайтару параметрлерін конфигурациялау

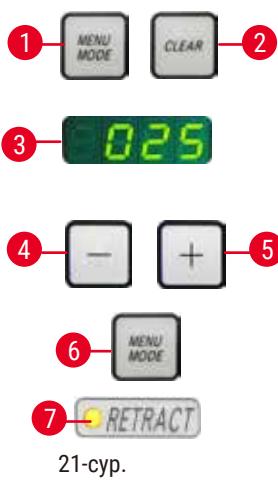


- Қысқарту параметрлерін ашу үшін **MENU MODE** (\rightarrow "21-сүр. - 1") және **CLEAR** (\rightarrow "21-сүр. - 2") түймелерін бір уақытта басыңыз.
- Ағымдағы орнатылған мән төрт таңбалы дисплейде үш таңбалы сан ретінде көрсетіледі, мысалы, 025 = 25 мкм (\rightarrow "21-сүр. - 3").
- Қажетті кері қайтару мәнін таңдаңыз. Қайтару мәні түймелердің көмегімен (\rightarrow "21-сүр. - 4") немесе (\rightarrow "21-сүр. - 5") жеке басқару тақтасында 5 мкм-ден ең көбі 100 мкм-ге дейін реттелуі мүмкін. Бұл параметрді де өшіруге болады.
- Қысқарту параметрлерінен шығу үшін **MENU MODE** (\rightarrow "21-сүр. - 6") түймесін басыңыз. Кері қайтару қозғалысы әр бөлімнен кейін жаңадан таңдалған мән бойынша орын алады.
- Үлгі кері тартылған кезде, **RETRACT** дисплейіндегі сары ЖД (\rightarrow "21-сүр. - 7") жанады.



- Қайтаруды өшіру үшін дисплейде **OFF** (\rightarrow "22-сүр. - 2") белгісі шыққанша бөлек басқару тақтасындағы түймені (\rightarrow "22-сүр. - 1") басыңыз.
- Қысқарту параметрлерінен шығу үшін **MENU MODE** (\rightarrow "22-сүр. - 3") түймесін басыңыз. Қайтару өшірілген кезде үлгі кері тартылмайды. **RETRACT** дисплейінің сары ЖД (\rightarrow "22-сүр. - 4") жанбайды.

Қалған көлденең берілістің көрсеткіші

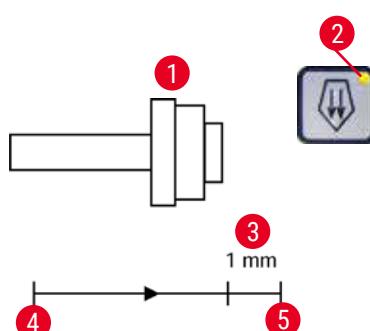

Көрінетін және естілетін қалған беру көрсеткіші пайдаланушыға алдыңғы шегіне жеткенге дейін шамамен 1 мм (\rightarrow "23-сүр. - 3") қалған бергіш болған кезде кесу мен бөлу кезінде пайдаланушыға хабарлайды.

Үлкен беру түймесіндегі сары ЖД (\rightarrow "23-сүр. - 2") қалған берудің басынан бастап жанады.

Оған қоса шам. 2 секунд бойы дыбыстық сигнал естіледі.

Осы сәттен бастап қалған беріліс шам. 1 мм ішінде қолжетімді.

Қалған беру аймағында пышаққа заттарды беру мүмкін емес, үлкен берілістүймелері мен электронды үлкен беріліс дөңгелегі.

- Сіз жұмыс процедурасын жалғастыра аласыз.
- Улken беріліс түймесіндегі сары ЖД ([“23-сур. - 2”](#)) жанады.
- Алдыңғы шеткі күйге ([“23-сур. - 5”](#)) жеткенде, қосымша беріліс болмайды; бұл сонымен қатар бөлудің болмайтынын білдіреді.
- Улгі бойынша жұмысты жалғастыру үшін артқы позициядағы ([“23-сур. - 4”](#)) тиісті үлken беріліс түймесін ([“24-сур.”](#)) басып, бөлуді жалғастыра аласыз.



24-сур.



24-сур.

Кеңес

Жұмысты жалғастыру үшін кесу режиміне көшу үшін TRIM/SECT түймесін басу керек, әйтпесе Улken берілісті пайдалану мүмкін емес.

Егер құрылғы қосылған кезде үлгі басы қалған беріліс диапазонында болса, бағдарламалық жасақтама нұсқасы көрсетілгеннен кейін қосымша дыбыстық сигнал естіледі.

- Үлken беріліс түймелерін қолдана отырып (кесу режимін орнатып), үлгіні қысқа қашықтыққа жылжыту арқылы жұмысты жалғастыра аласыз.
- Қалған беру диапазонында STEP функциясы ажыратылады.

5.1.4 Электронды үлken беріліс дөңгелегі



25-сур.

Үлken қозғалыс үлгінің пышақтан қашықта -
пышаққа қарай - көлденең жылдам алға
жылжуын қамтамасыз етеді.

Заттың басын алға жылжыту үшін электронды
үлken беріліс дөңгелегінің ([“25-сур. - 1”](#))
айналуын сағат тілінің бағытымен немесе
сағат тіліне қарсы орнатуға болады.

- Нысандың басын алға жылжыту үшін сағат тілімен айналуды орнату үшін, бөлек басқару тақтасындағы баяу алға жылжытатын беріліс түймесін ([“26-сур. - 1”](#)) басып тұрып, құралды қосыңыз; үш таңбалы дисплей С тілін сағат тілінің бағытымен ([“26-сур. - 2”](#)) көрсетеді.
- Объектінің басын ілгері жылжыту үшін сағат тіліне қарсы бұруды орнату үшін, құралды қосыңыз және баяу артқа үлken беріліс түймесін ([“26-сур. - 3”](#)) басыңыз; үш таңбалы дисплей СС тілін сағат тіліне қарсы бағытта ([“26-сур. - 4”](#)) көрсетеді.



26-сур.


Құрылғы қосылған кезде электронды үлken
беріліс дөңгелегінің айналу параметрлері үш
таңбалы дисплейде шамамен 4 секунд бойы
көрсетіледі. Зауытта орнатылған айналу
бағыты электронды үлken беріліс дөңгелек
сағат тілімен.

5.1.5 Үлгіге арналған ұсақ бағыттағыш қондырығы



Кеңес

Бағыттаушы үлгі ұстағыш қондырығысының жылдам қысу жүйесінде қосымша керек-жарақтар ретінде қолжетімді барлық үлгі қысқыштарын қолдануға болады.

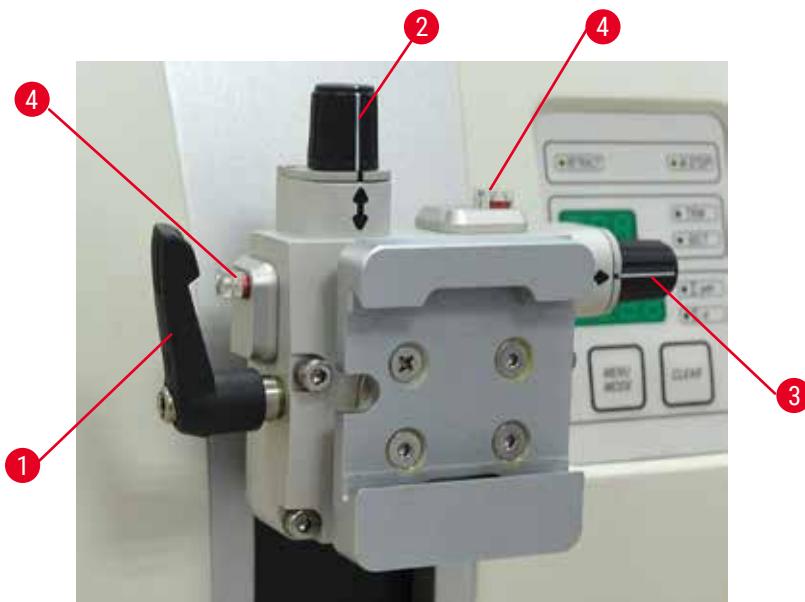

27-сур.

Үлгінің бағдарлануы үлгі бекітілген кезде үлгі бетінің жай күйін түзетуге мүмкіндік береді. Бағыттаушы үлгі ұстағыш қондырығы бағытталмаған қондырығыға аудыстырылуы мүмкін (қосымша керек-жарақ).

Нөлдік күйді көрсету

Нөлдік күйді жақсы көрсету үшін бағдар екі қызыл көрсеткішке ие ([→ "27-сур. - 4"](#)).

Егер екі индикатор да толық көрінетін болса және екі бұранда бұрандастырылғанда бір уақытта нөлдік күйде болса (ақ таңбалар көрсеткілермен сәйкес келеді), үлгі нөлдік күйде болады.

Үлгіні бағыттау



Сақ болыныз

Үлгі кері тартылу кезеңінде бағытталған.

Үлгінің кері қысқару кезеңінде қайта бағдарлануына байланысты үлгінің бүлінуі.

- Үлгі блоктары кері тартылу кезеңінде бағытталмауы керек. Егер блок қысқару кезінде бағытталған болса, ол келесі бөлімге дейін қысқару мәнімен плюс таңдалған қиманың қалыңдығымен алға жылжиғы. Бұл үлгінің де, пышақтың/жұздің де зақымдалуына әкелуі мүмкін.

1. Заттың басын жоғарғы шеткі орынға көтеріп, қолмен басқару құралының механизмін іске қосыңыз.
2. Қысқышты босату үшін эксцентрик түтқаны ([→ "27-сур. - 1"](#)) сағат тілімен бұраңыз.

3. Үлгіні тік бағытта бағыттау үшін бұранданы ([→ "27-сур. - 2"](#)) бұраңыз. Үлгіні көлденен бағытта бағыттау үшін бұранданы ([→ "27-сур. - 3"](#)) бұраңыз. Бұранданың әр толық бұрылуы үлгіні 2° қисайтады. Барлығы 4 бағытта = 8° толық бұрылу мүмкін. Дәлдік шамамен ± 0,5° құрайды. Бағалаудың қаралайымдылығы үшін тұтқасында ақ белгі және бұру кезінде байқалатын шертпе тоқтауы бар.
4. Ағымдағы бағдарды құлыптау үшін эксцентрик тұтқаны ([→ "27-сур. - 1"](#)) сағат тіліне қарсы бұраңыз.



Кеңес

Үлкен стандартты қысқыш (50 x 55 мм) немесе супер кассеталы қысқыш қолданылғанда, үлгіні солтүстік-оңтүстік бағытта ± 8° бағыттау мүмкін болмайды. Үлкен стандартты қысқыш (50x55мм) үшін қолдануға болатын бұрыш бұл жағдайда шамамен ± 4° құрайды.

5.1.6 Күш тере-тендігін дәл реттеу



28-сур.

Егер заттың басына ([→ "28-сур. - 1"](#)) басқа салмақтағы басқа керек-жарақ орнатылған болса, онда күш тере-тендігін қайта реттеу қажет/қажет еместігін тексеру керек.

- Жаңа керек-жарақты бекітіп, үлгіні қысыңыз.
- Қолмен басқару құралы ([→ "28-сур."](#)) арқылы обьектінің басын тік жүру диапазонының биіктігінің жартысына қойыңыз.

Егер заттың басы дәл осы күнде қалса, онда параметр дұрыс.

Егер заттың басы қозғалса, яғни көтерілсе немесе төмен түсірілсе, дәл реттеу қажет.



Сақ болыңыз

Күш тере-тендігі дұрыс теңшелмеген.

Пыشاқпен және/немесе үлгінің зақымдалуынан оператордың ауыр жарақат алу қаупі.

- Құралмен жұмыс жасамас бұрын, күш тере-тендігінің дәл теңшелуінің дұрыс орнатылғанын әрқашан қайталап тексеріңіз.
- Егер дәл реттеу дұрыс орнатылмаған болса, құралмен жұмыс жасамаңыз, оның қайта теңшеу қажет.
- Әсіресе, заттың басындағы керек-жарақтарды ауыстырғаннан кейін, дереу күш тере-тендігін дәл реттеуді орындаңыз.



Күш тәпеп-төндігі бұранданың (\rightarrow “29-сүр. - 1”)
көмегімен реттеледі, оған микротомның
тақтасының астыңғы жағындағы қоқыс
жәшігін алу арқылы қол жеткізуге болады.
Реттеу үшін №5 алтыбұрыш кілтін (тұтқасы
бар) қолданыңыз.

- Егер заттың басы төмен қарай жылжитын болса, бұранданы (\rightarrow “29-сүр. - 1”)
әр уақытта сағат тілімен шамамен 1/2 айналымға
бұраңыз.
- Егер заттың басы жоғары қарай жылжитын болса, бұранданы (\rightarrow “29-сүр. - 1”)
әр уақытта сағат тіліне қарсы шамамен 1/2 айналымға
бұраңыз.
- Бұл процедуралы заттың басы
босатылғаннан кейін қозғалмайтындағы
жалғастырыңыз.




Кеңес

Заттың басы қозғалмайтынша реттеу процедурасын бірнеше рет қайталаңыз.

5.2 Екі функциясы бар “Е” жүз ұстағышын енгізу


5.2.1 Жүз ұстағышының негізін орнату

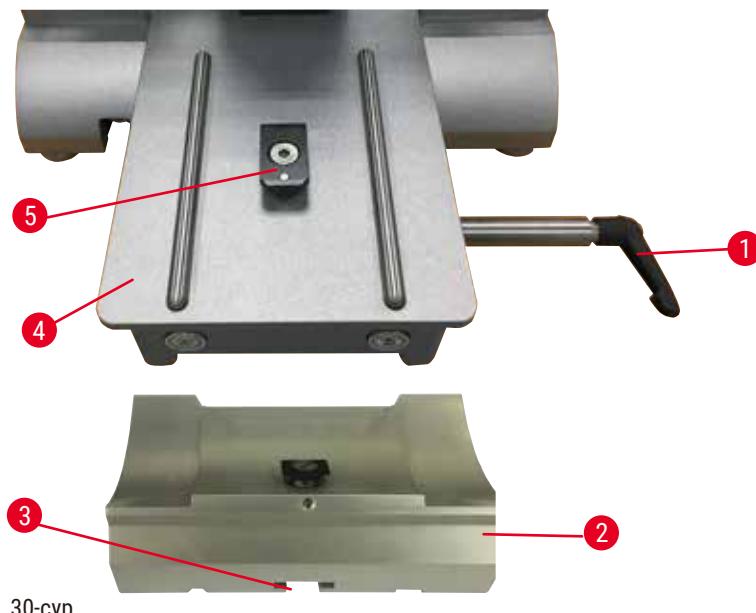

- Қысқыш тұтқаны (\rightarrow “30-сүр. - 1”)
сағат тіліне қарсы бұрап босатыңыз.
- Пышақ ұстағыш негізін (\rightarrow “30-сүр. - 2”)
микротомды тақтасының (\rightarrow “30-сүр. - 4”)
Т-бөлігінің (\rightarrow “30-сүр. - 5”)
төменгі жағындағы ойықты (\rightarrow “30-сүр. - 3”)
пайдаланып
салыңыз.


3. Жұз ұстағыштың ([→ "30-сүр. - 2"](#)) негізін микротомдық тақтада алға-артқа жылжытуға болады. Бұл екі функциясы бар "E" жұз ұстағышын үлгіге қатысты оңтайлы кесу күйіне келтіруге мүмкіндік береді. Пышақ ұстағыш негізін бекіту үшін қысқыш тұтқаны ([→ "30-сүр. - 1"](#)) сағат тілімен бұраңыз.

5.2.2 Екі функциясы бар "E" жұз ұстағышын енгізу

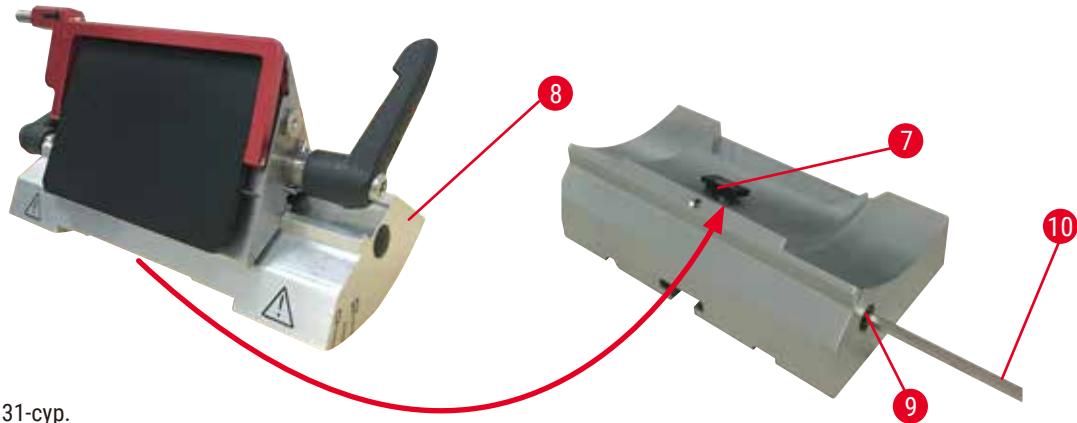

- №4 алтыбұрыш кілтінің ([→ "31-сүр. - 10"](#)) көмегімен эксцентрлік ([→ "31-сүр. - 9"](#)) болтты босатыңыз.
- Екі функциясы бар "E" жұз ұстағышын ([→ "31-сүр. - 8"](#)) астыңғы ойығымен пышақ ұстағышы негізінің ([→ "30-сүр. - 2"](#)) Т-бөлігіне ([→ "31-сүр. - 7"](#)) салыңыз.
- Қысу үшін эксцентрикті болтты ([→ "31-сүр. - 9"](#)) қайта қатайтыңыз.

5.3 Саңылау бұрышын реттеу

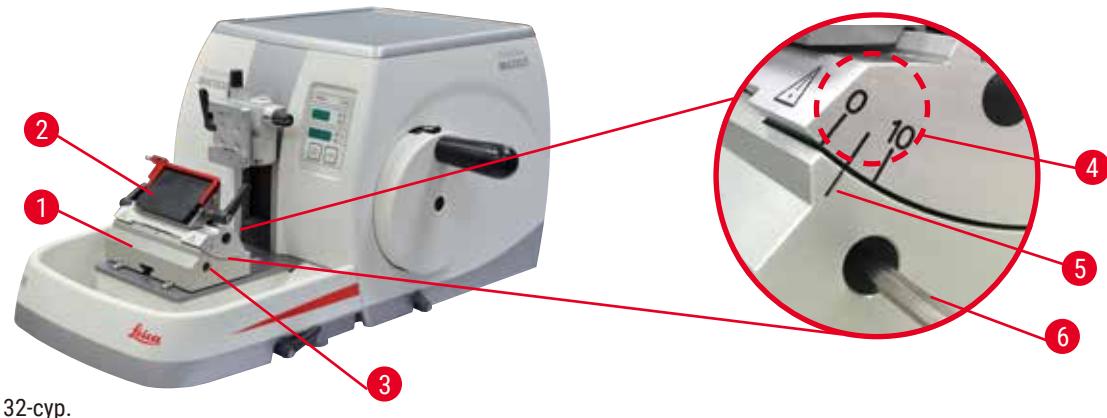

Саңылау бұрышын ([→ "32-сүр. - 4"](#)) реттеуге арналған индекстік белгілер (0° , 5° және 10°) екі функциясы бар "E" жұз ұстағышының ([→ "32-сүр. - 2"](#)) он жағында орналасқан. Пышақ ұстағыш негізінің ([→ "32-сүр. - 1"](#)) он жағында индекс белгісі ([→ "32-сүр. - 5"](#)) бар, ол аралық бұрышын реттеу кезінде тірек нүктесі болып табылады.

- Бұранданы ([→ "32-сүр. - 3"](#)) №4 алтыбұрыш кілтінің ([→ "32-сүр. - 6"](#)) көмегімен екі функциясы бар "E" жұз ұстағышы ([→ "32-сүр. - 2"](#)) жылжытылғанша босатыңыз.

2. Қажетті тазалау бұрышының индексі пышақ ұстағыш негізінде тірек сыйығымен сәйкес келгенше екі функциясы бар “E” жүз ұстағышын жылжытыңыз. Үлкейтілген суретте (\rightarrow “32-сур.”) 5° аралық бұрышы көрсетілген.




Кеңестер

Екі функциясы бар “E” жүз ұстағышы үшін ұсынылған аралық бұрышының параметрі шам. $2,5^\circ - 5^\circ$.

3. Екі функциясы бар “E” жүз ұстағышын осы қалыпта ұстаңыз және қысқышқа арналған бұранданы (\rightarrow “32-сур. - 3”) қайта бекітіңіз.

5.4 Әмбебап кассета қысқышын салу

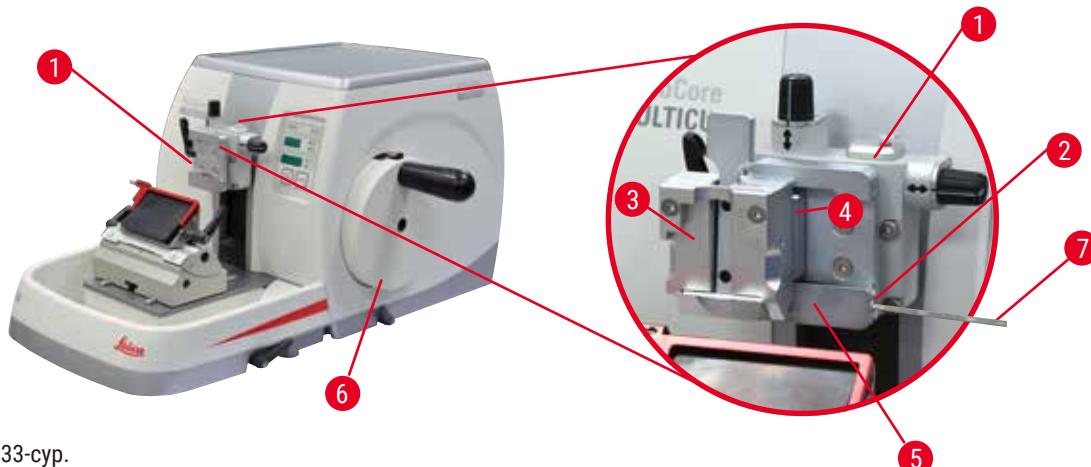

33-сур.

Бірі бағдарланған және екіншісі бағдарланбаған екі үлгі ұстағышы бар, (\rightarrow 61-б. - 6. Қосымша керек-жарақтар) қараңыз. Улгінің бағдарлануы үлгі бекітілген кезде үлгі бетінің жай күйін түзетуге мүмкіндік береді. Қолжетімді керек-жарақтардың барлық қысқыштарын ұсташа үшін жылдам қысу жүйесін (\rightarrow “33-сур. - 5”) қолдануға болады (қосымша ақпарат алу үшін (\rightarrow 61-б. - 6. Қосымша керек-жарақтар) қараңыз).

Ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Дөңгелекті айналдыру арқылы заттың басын (\rightarrow “33-сур. - 1”) жоғарғы шеткі орынға жылжытыңыз және қолмен басқару құралын бекіту механизмін (\rightarrow “33-сур. - 6”) қосыңыз.
2. Қысқыш жүйені босату үшін № 4 алтыбұрыш кілтінің (\rightarrow “33-сур. - 7”) көмегімен жылдам қысу жүйесінің (\rightarrow “33-сур. - 5”) бұрандасын (\rightarrow “33-сур. - 2”) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
3. Әмбебап кассета қысқышының (\rightarrow “33-сур. - 3”) бағыттағышын (\rightarrow “33-сур. - 4”) сол жақтан жылдам қысу жүйесіне (\rightarrow “33-сур. - 5”) дейін созыңыз.
4. Кассета қысқышын қысу үшін бұранданы (\rightarrow “33-сур. - 2”) сағат тілімен бұраңыз.



Кеңес

Керек-жарақтар ретінде қолжетімді барлық үлгілік қысқыштар артқы жағында бірдей бағыттағышпен жабдықталғандықтан, олар кассета қысқышының мысалында осында сипатталғандай салынған.

5.5 Үлгіні қысу



Сақ болыңыз

Оператор жұмыс тәртібінің дұрыс орындалмағанына байланысты пышақ немесе жүзді ұстайды.

Егер пышақ немесе жүздер үлгіден бұрын орнатылған болса, үлгіні орнына қою кезінде адамдар ауыр жарақат алуы мүмкін.

- Үлгіні микротомға жүктемес бұрын, кесу жиегінің сақтандырышпен жабылғанына және қол дөңгелегінің құлыптау механизмінің іске қосылғанына көз жеткізіңіз. Оператор үлгіні, сондай-ақ пышақты/жүзді салуды жоспарлағаннан кейін, үлгі блогын пышақты/жүзді орнатпас бұрын және қыспастан бұрын жүктеңіз.

1. Қолмен басқару құралын үлгі қысқыш жоғарғы соғғы күйге келгенше айналдырыңыз.
2. Қолмен басқару құралын бекітіңіз немесе қолмен басқару құралын бекіту механизмін ([→22-б. – 2.3.1 Қолмен басқару құралын құлыптау](#)) іске қосыңыз.
3. Үлгі қысқышының ішіне үлгіні салыңыз.



Кеңес

Үлгіні әр түрлі қысқыштар мен ұстағыштарға енгізу дің толық сипаттамасы ([→61-б. – 6. Қосымша керек-жарақтар](#)) ішінде берілген.

5.6 Пышақты/бір реттік жүзді қысу



Сақ болыңыз

Пышақтар немесе жүздер қолайсыз түрде пайдаланылған және/немесе кәдеге жаратылған.

Өте өткір пышақтармен және/немесе жүздермен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақтармен және/немесе жүздермен жұмыс жасағанда, аса мүқият және абайлап жұмыс жасаңыз.
- Пышақтармен және/немесе жүздермен жұмыс жасағанда әрқашан арнайы киімдерді (оның ішінде кесуге төзімді қолғаптарды) киіңіз.
- Пышақтар мен жүздерді әрқашан қауіпсіз жерге тастаңыз (мысалы, арнайы пышақ қорапшасы) және адамдардың жарақат алмауын қамтамасыз етіңіз.
- Ешқашан пышақты кесу жиегін жоғары қаратып қоймаңыз және құлап жатқан пышақты ұстауға тырыспаңыз.
- Үлгіні қыспас бұрын әрқашан пышақтың/жүздің шетін сақтандырышпен жабыңыз.



Сақ болыңыз

Оператор пышаққа және/немесе жүз ұстағышына екі пышақ және/немесе жүзді орнатады.

Өте өткір пышақтармен және/немесе жүздермен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ ұстағышына/жүз ұстағышына екі пышақты/жүзді қыспаңыз. Пышақты/жүзді пышақ/жүз ұстағышының ортасына орнатыңыз. Пышақтар/жүздер пышақ/жүз ұстағышының шетінен аспауы керек.

**Сақ болыңыз**


Жұздер қысым тақтасының жоғарғы шетіне толық параллель орнатылмаған.

Бүйірлік қозғалыс функциясын қолданғанда, пышақты қысым тақтасына параллель орнатпау кесу нәтижесінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Мысалы, егер бөлім тым қалың, немесе тым жіңішке болса, ең нашар сценариіде бөлімнің ішінде сейлесу үлгіні зақымдауы мүмкін.

- Бөлімнің қанағаттанарлықсыз нәтижелерін алған кезде бөлуді жалғастырмаңыз.
- Жұздерді қайта орнатыңыз және оның қысым тақтасының жоғарғы шетіне параллель екеніне көз жеткізіңіз.
- Жұздерді көлденең жылжыту функциясы арқылы жылжытқаннан кейін әрқашан жүз бен қысым тақтасы арасындағы параллельдікті тексеріңіз.

Жоғары профильді жұздерді салу

34-сур.

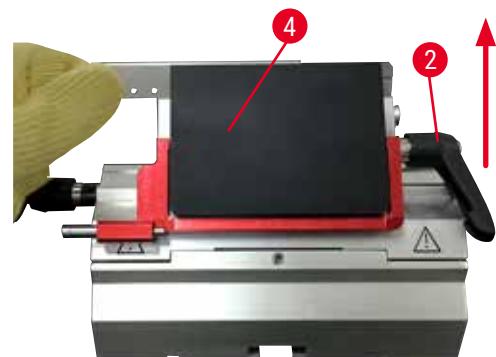

35-сур.

1. Қауіпсіздік қорғанысын ([→ "34-сур. - 1"](#)) төмен түсіріңіз.
2. Жұзді енгізу үшін, қысқыштың оң жақ тұтқасын ([→ "34-сур. - 2"](#)) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
3. Жұзді жоғарыдан немесе бүйірінен абайлап итеріңіз. Жұздің ортасында орналасқанына және ең бастысы қысым тақтасының ([→ "35-сур. - 4"](#)) жоғарғы шетіне параллель екеніне көз жеткізіңіз.
4. Жұзді қысу үшін қысқыш тұтқаны ([→ "34-сур. - 2"](#)) сағат тілімен бұраңыз.

Төмен профильді жұздерді енгізу

36-сур.



37-сур.


Төмен профильді жүздерді пайдаланған кезде, төмен профильді жүздерге арналған кірістіруді ([→ "37-сур. - 1"](#)) алдымен екі функциясы бар "E" жүз ұстағышына қою керек және кірістірудің төменгі жиегі жүз ұстағыштың ойығына тығыз сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Кірістірудің ([→ "36-сур. - 1"](#)) артқы жағына екі магнит бекітілген. Дөңгелектелген жиектері жоғары қарайтын кірістірлгеннен кейін олар оператордан (артқы қысым тақтасына қарай) көрсетеді. Кірістірудің төмен қарай итерілгеніне және пышақтың кесу жиегіне параллель отыруына мүмкіндік беретініне көз жеткізіңіз - егер бұл дұрыс орындалмаса, үлгінің зақымдану қаупі бар. Содан кейін пышақты ([→ 53-б. -](#)) ішінде сипатталғандай салыңыз (жоғары профильді пышақ үшін).

Жүздерді алу



38-сур.

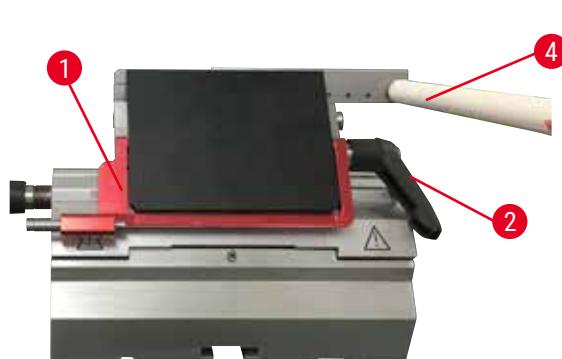

39-сур.

1. Қысқыш тұтқаны ([→ "38-сур. - 2"](#)) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
2. Пышақ әжекторындағы істікті ([→ "38-сур. - 3"](#)) итеріңіз.



Кеңестер

Жүзді қауіпсіз шығару үшін жүзді шығару құралын қолданыңыз.

3. Қауіпсіздік қорғанысын ([→ "39-сур. - 1"](#)) төмен түсіріңіз. Жүзді оң жақтан және сыртқа шығару үшін магнитті щетканы ([→ "39-сур. - 4"](#)) қолданыңыз.
- Екі функциясы бар "E" жүз ұстағышынан жүз алынғаннан кейін, ол жүз диспенсерінің төменгі жағындағы пайдаланылған жүз контейнеріне ([→ "40-сур."](#)) тасталады.



40-сур.



Сақ болыңыз

Пышақтар немесе жүздер қолайсыз түрде пайдаланылған және/немесе кәдеге жаратылған. **Өте өткір пышақтармен және/немесе жүздермен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.**

- Пышақтармен және/немесе жүздермен жұмыс жасағанда, аса мүқият және абайлап жұмыс жасаңыз.
- Пышақтармен және/немесе жүздермен жұмыс жасағанда әрқашан арнайы киімдерді (оның ішінде кесуге төзімді қолғаптарды) киіңіз.
- Пышақтар мен жүздерді әрқашан қауіпсіз жерге тастаңыз (мысалы, арнайы пышақ қорапшасы) және адамдардың жарақат алмауын қамтамасыз етіңіз.
- Ешқашан пышақты кесу жиегін жоғары қаратып қоймаңыз және құлап жатқан пышақты ұстауға тырыспаңыз.
- Үлгіні қыспас бұрын әрқашан пышақтың/жүздің шетін сақтандырғышпен жабыңыз.



Кеңес

Жеке пышақ ұстағыштарға пышақты салудың толық сипаттамасы ([→61-6. – 6. Қосымша керек-жарақтар](#)) ішінде берілген.

5.7 Үлгіні кесу



Сақ болыңыз

Дөңгелектің бұрылу бағыты қате таңдалды.

Үлгінің зақымдалуы.

- Дөңгелекті айналдырmas бұрын, үлken беріліс дөңгелегінің бұрылу бағытын дұрыс таңдағаныңызға әрқашан көзіңізді жеткізіңіз.



Абайлаңыз

Қолмен басқару құралы мен үлken беріліс дөңгелегін бір уақытта айналдыру.

Үлгінің зақымдалуы.

- Қолмен басқару құралын айналдыру кезінде үлken беріліс дөңгелегін айналдырмаңыз.

- TRIM режимін таңдау үшін TRIM/SECT түймесін пайдаланыңыз.
- 
- Қажетті кесу қалыңдығын орнатыңыз.
- Руль дөңгелегінің құлыштау механизмі мен дөңгелектің тежегіш тұтқасын босатыңыз.
- TRIM режимінде үлгіні пышаққа/жүзге қарай жылжыту үшін үлкен беріліс түймелерін немесе электронды үлкен беріліс дөңгелегін қолданыңыз.
- Үлгіні дөңгелекті немесе үлкен беріліс дөңгелегін бұры арқылы кесініз немесе
- ROCK режимін таңдау үшін ROCK түймесін басыңыз (түймедегі ЖД → "41-сур. - 1" қосылады). Қолмен басқару құралын алға-артқа айналдыру арқылы үлгіні кесініз.
- Қажетті кесу бетіне және терендігіне жеткенде кесуді тоқтатыңыз.

41-сур.

**Сақ болыңыз**

Қолмен тез кесу кезінде қолмен басқару құралының босатылғаннан кейін үлгі мен пышақ/жүздің арасына саусақтар қойылады.

Оператор қолмен басқару құралының құлпы ашылған кезде оның бұрылуына байланысты кесілуі немесе жарапануы мүмкін.

- Кесу мен бөлу кезінде үлгі мен пышақ/жүздің арасына саусақтарды қоймаңыз.

5.8 Бөлу**Сақ болыңыз**

Құралмен жұмыс істейтін біліктілігі жеткіліксіз қызметкерлер.

Пышақ/жүзге жақындаған кезде, мысалы, оператордың дұрыс емес әрекеттерінен, мысалы, қол дөңгелегі ашылған кезде заттың басы пышақ ұстағышына құлап кетуі мүмкін болғандықтан, адамдардың ауыр жарақат алуы немесе сынаманың зақымдалуы туындауы мүмкін.

- Құралды тек арнайы және жеткілікті дайындық пен біліктілігі бар зертханалық персонал басқаратынына көз жеткізіңіз.
- Бұл құралмен жұмыс істеуге тағайындалған барлық зертхана қызметкерлері осы Пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шыққанына және оны қолданар алдында құралдың барлық техникалық ерекшеліктерімен танысқанына әрқашан көз жеткізіңіз.

**Сақ болыңыз**

Жеке қорғаныс құралдары қолданылмаған.

Адамдар жарақатталуы мүмкін.

- Микротомдармен жұмыс жасағанда жеке қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Жұмыс кезінде қауіпсіздік аяқ киімін, қолғапты, бетперде мен қорғаныс көзілдірігін кию міндettі.

**Сақ болыңыз**

Тиісті қорғаныс киімінсіз құралмен және сынғыш үлгімен жұмыс істеу.

Сынғыш үлгіні кесу кезінде адамдардың сынықтан ауыр жарақат алу қаупі.

- Эрқашан тиісті қорғаныс киімін киіңіз (қауіпсіздік көзілдірігін қоса) және сынғыш үлгіні кесу кезінде әсіресе мұқият жұмыс жасаңыз.

**Сақ болыңыз**

Бөлу үшін типтік жағдайлар жеткіліксіз.

Үлгінің зақымдалуы немесе нашар кесу, мысалы, қалыңдығы бойынша ауысатын, қысылған, бүктелген немесе жалаңаш кесінділер.

- Бөлімдердің жеткілікісі нәтижелері анықталса, бөлуді жалғастырмаңыз.
- Тиісті бөлу үшін барлық алғышарттардың орындалғанына көз жеткізіңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін осы пайдалану нұсқаулығының ақауларды жою бөлімін қараңыз.
- Егер бөлу бойынша ақаулықтарды жою туралы жеткілікті біліміңіз болмаса, мұндай салада білімі бар адамдармен, мысалы, Leica Biosystems қосымшасының сарапшыларымен кеңесіңіз.

**Сақ болыңыз**

Қолмен басқару құралын сағат тіліне қарсы бұры.

Адамдардың жарақаты/үлгінің зақымдалуы.

- Қолмен басқару құралын сағат тілінің бағытына қарсы бұрмаңыз, бұл дөңгелекті бекіту механизмінің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

**Сақ болыңыз**

Қолмен басқару құралының айналу жылдамдығы үлгінің қаттылығына сәйкес келмейді.

Құрал зақымдалуы және үлгінің зақымдалуы мүмкін.

- Қолмен басқару құралының айналу жылдамдығы үлгінің қаттылығына сәйкес келуі керек. Қурделі үлгілер үшін баяу жылдамдықты қолданыңыз.

**Сақ болыңыз**

Қолмен бөлу режимінде пайдаланушы қолмен басқару құралын өте жоғары жылдамдықпен айналдыру арқылы үлгі блогын кеседі.

Бұл кесу сапасының нашарлауына және тіпті үлгінің бұзылуына әкелуі мүмкін.

- Қолмен бөлу режимінде қолмен басқару құралының айналу жылдамдығы 60 айн/мин жылдамдығынан аспауы керек.

**Абайлаңыз**

Пышақ/жұз ұстағыш бүйірден жылжытылғаннан кейін, үлгі кері тартылмайды және қайта кесілмейді.

Үлгінің зақымдалуы.

- Пышақ/жұз ұстағышын бүйірінен жылжытқаннан кейін, заттың басын артқа тартып, үлгі блогын қайта қысыңыз.



Абайлаңыз

Электронды үлкен беріліс дөңгелегінің көмегімен кесуден кейін пайдаланушы бөлу режиміне ауыспайды.

Улгінің зақымдалуы немесе құралдың күтпеген жұмысы.

- Электронды үлкен беріліс дөңгелегімен кесу аяқталғаннан кейін, бөлу режиміне ауысуды ұмытпаңыз.
- Бөлуді бастамас бұрын, әрқашан тиісті бөлу қалыңдығының таңдалғанына көз жеткізіңіз.



Ескертпе

Керек-жарақтар мен құрамдастар коррозиялық/қатты қышқыл/сілтілі реагентті немесе еріткішті, мысалы құрамында қышқылы бар кальцийленбеген ерітінді, құрамында сілті бар аммоний гидроксиді және т.б. құралмен немесе керек-жарақпен қолдану нәтижесінде коррозияға ұшырайды.

Керек-жарақтар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

- Құрал бетіне немесе керек-жарақтарға агрессивті/қатты қышқыл/сілтілі реагент немесе еріткіш тамшыламаңыз.
- Егер мұндағы реагент немесе еріткіш құралдың бетіне немесе керек-жарақтарына тисе, оның қалдықтарды сұртіп, керек-жарақтарды мұмкіндігінше тез кептіріңіз.
- Егер мұндағы реагент немесе еріткіш жиі қолданылса, жұз ұстағышты, әмбебап кассета қысқышын (UCC) және қажет болған жағдайда басқа керек-жарақтарды құнделікті мұқият тазалаңыз.

Әрқашан кесу және бөлу үшін кесу жиегінің басқа аймағын қолданыңыз.



- Ол үшін пышақ/жұз ұстағышын бүйірден ауыстырыңыз. Бүйірлік үғысыу бар екі функциясы бар "E" жұз ұстағышын қолданғанда, жұз ұстағышын бүйірге жылжыту жеткілікті.



- SECT режимін таңдау үшін TRIM/SECT түймесін пайдаланыңыз.



- Сәйкес бөлімнің қалыңдығын реттеңіз немесе таңдалған мәнді тексеріңіз.



- Әдеттегі бөлуді таңдаңыз.

42-сур.

- Улгіні бөлу үшін қолмен басқару құралын сағат тілінің бағытымен біркелкі бұраңыз.
- Бөлімдерді алыңыз.

5.9 Улгіні өзгерту немесе бөлуді ұзу



Сақ болыңыз

Қолмен басқару құралының құлпы ашылады және заттың басы пышақ/жұз ұстағышына түседі.

Адамдардың жарақаты/улгінің зақымдалуы.

- Бөлу кезеңінен басқа, қолмен басқару құралы әрқашан құлыштаулы болуы керек.

**Сақ болыңыз**

Улгі кері тартылу кезеңінде бағытталған.

Үлгінің кері қысқару кезеңінде қайта бағдарлануына байланысты үлгінің және пышақ/жұздің бүлінуі.

- Улгі блоктары кері тартылу кезеңінде бағытталмауы керек. Егер блок қысқару кезінде бағытталған болса, ол келесі бөлімге дейін қысқару мәнімен плюс таңдалған қиманың қалыңдығымен алға жылжиды. Бұл үлгінің де, пышақтың/жұздің де зақымдалуына әкелуі мүмкін.

**Сақ болыңыз**

Улгіні кесу кезінде пышақ/жұз тиісті қорғаныспен қапталмаған.

Адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ/жұз немесе үлгі қысқышымен қандай да бір жұмыс жасамас бұрын, үлгіні ауыстырап алдында және барлық жұмыс үзілістерінде әрқашан пышақтың/жұздің шетін сақтандырышпен жабыңыз.

**Сақ болыңыз**

Улгіні микротомға тиісті киімсіз және сәйкес емес түрде жүктеу немесе түсіру.

Оператор жарапануы мүмкін, бұл ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін.

- Үлгіні микротоммен өңдеу кезінде әрқашан кесуге төзімді қауіпсіздік қолғаптарын қолданыңыз.
- Үлгінің қысқышын пайдаланбас бұрын және үлгіні алмастырмас бұрын, дөңгелекті құлыштап, пышақ жиегін сақтандырышпен жабыңыз.

1. Улгіні жоғарғы шеткі күйге көтеріңіз және доңғалақты бекіту механизмін іске қосыңыз.
2. Бөлу жиегін сақтандырышпен жабыңыз.
3. Улгіні қысқыштан алыңыз және жалғастыру үшін жаңа үлгіні орнатыңыз.
4. Жаңа үлгіні кеспес бұрын, үлгінің басын артқы шеткі күйге қойыңыз.



43-сур.

5.10 Күнделікті режимді аяқтау

**Сақ болыңыз**

Бөлімдегі қалдықтар науасының ажыратылғаннан кейін құлап түсу қаупі.

Адамдар жарақатталуы мүмкін.

- Қалдықтарды шығаратын науаны алып тастау кезінде әсіресе мұқият жұмыс жасаңыз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жұз ұстағышын микротомнан алып тастаған кезде пышақ/жұз алынбады.

Өте өткір пышақпен/жұзбен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ/жұз ұстағышын микротомнан алмас бұрын, пышақты/жұзді кесуге төзімді қолғап кигенде ажыратыңыз және пышақты/жұзді қауіпсіз жерде сақтаңыз.

**Сақ болыңыз**

Пышақ/жұз дұрыс сақталмаған.

Адамдардың ауыр жарақаттары, мысалы, күтпеген жерден құлау.

- Пышақ/жұзді пайдаланбайтын кезде оларды әрқашан тиісті жерде сақтаңыз, мысалы, арнайы пышақ қорабына салыңыз.
- Ешқашан пышақты кесу жиегін жоғары қаратып қоймаңыз және құлап жатқан пышақты ұстауға тырыспаңыз.

**Сақ болыңыз**

Парафин қалдықтары еденге түсү және тазартыла алмау қаупі.

Адамдардың ауыр жарақат алу қаупі, мысалы, пышаққа/жұзге сырғып түсіп кету салдарынан.

- Парафин қалдықтары таралмай, тайғақ болмай, қауіпке айналмайынша, оны үнемі тазалаңыз.
- Сәйкес аяқ киімді киіңіз.

1. Дөңгелекті айналдыру арқылы үлгіні жоғарғы шеткі орынға жылжытыңыз және қолмен басқару құралын бекіту механизмін қосыңыз.
2. Жұзді екі функциясы бар “Е” жұз ұстағышынан алып тастаңыз және оны диспенсердің төменгі жағындағы ыдысқа салыңыз немесе жұзді ұстағышынан алып, жұз қорабына қайта салыңыз.
3. Үлгіні қысқыштан алыңыз.
4. Заттың басын артқы жағына жылжытыңыз немесе пышақ ұстағыш негізіндегі пышақ ұстағышты сыртқа қарай жылжытыңыз.
5. Барлық қоқыстарды қоқыс жәшігіне салыңыз да, науаны босатыңыз.
6. Құралды негізгі қуат қосқышында өшіріңіз.
7. Құралды тазалаңыз ([→94-б. – 8.1 Құралды тазалау](#)).

6. Қосымша керек-жарақтар

6.1 Үлгі қысқышына арналған бекіту жинағы



Кеңестер

Сатып алу тапсырысына байланысты негізгі құрал алдымен жиналатын үлгі қысқыштары үшін дәл бағытталған, бағытталған немесе қатаң бекіткішпен бірге жеткізіледі. Керек-жарақтар ретінде қолжетімді барлық үлгі қысқыштары қысқыштарға арналған үш қондырғының бірінде қолданыла алады.


Үлгі қысқыштарына арналған қондырманы жинамас бұрын, қолмен басқару құралының бекіту механизмін іске қосыңыз.

6.1.1 Үлгі қысқыштары үшін қатаң бекітпе



Кеңестер


Резеңке сақинаны ([→ “44-сур. - 5”](#)) заттың басын бекіткеннен кейін ғана алыңыз.

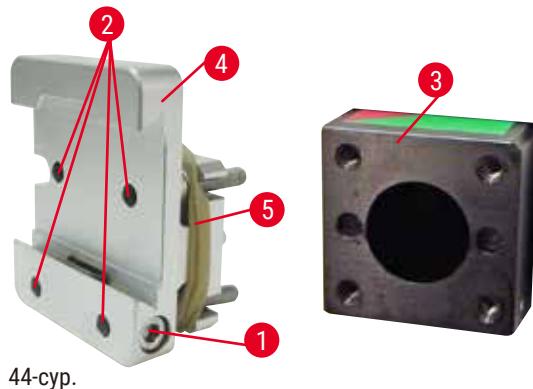

Үлгі қысқыштары ([→ “44-сур. - 4”](#)) үшін қатаң бекіткішті зат басына ([→ “44-сур. - 3”](#)) бұраңыз.

- Бұранданы ([→ “44-сур. - 1”](#)) алып тастаңыз, үлгіні ұстағыш қондырғыны ([→ “44-сур. - 4”](#)) заттың басына ([→ “44-сур. - 3”](#)) алдыңғы жағынан қойыңыз және бұрандаларды ([→ “44-сур. - 2”](#)) №3 алтыбұрыш кілтімен бекітіңіз.
- Содан кейін бұранданы ([→ “44-сур. - 1”](#)) бүйірден салыңыз да, оны №4 алтыбұрыш кілтімен қысыңыз.


6.1.2 Үлгі қысқыштарына арналған бағыттауыш бекітпе

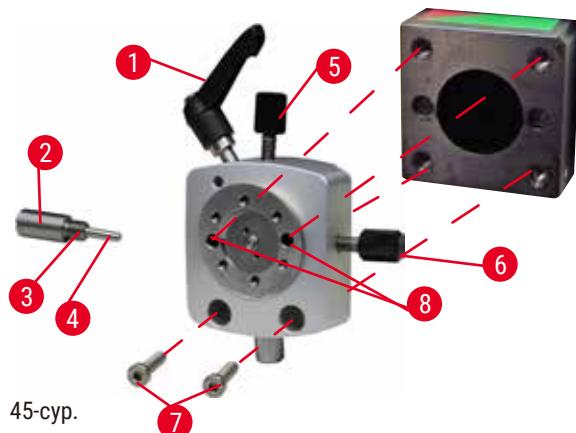

45-сур.

- Эксцентрлік болтты ([→ "45-сур. - 1"](#)) сағат тіліне қарсы бұрап босатыңыз.
- Тегіс бұрағышпен ([→ "45-сур. - 2"](#)) інтіректі толығымен бұрап алыңыз да, оны серіппені ([→ "45-сур. - 3"](#)) және істікпен ([→ "45-сур. - 4"](#)) бірге шығарыңыз.
- Бекіткіш бұрандаларды ([→ "45-сур. - 5"](#)) және ([→ "45-сур. - 6"](#)) толығымен бұрап алыңыз.
- Үлгілердің қысқыштарына арналған бағыттауыш қондырығыны бұрандаларды ([→ "45-сур. - 8"](#)) бұрап қатайту арқылы орнатыңыз (саңылаулар арқылы 2 бұрандаға қол жеткізуге болады) және №3 алтыбұрыш кілтінің көмегімен бұраңыз. Бұрандаларды ([→ "45-сур. - 7"](#)) суретте көрсетілгендей тесіктеге салыңыз және оларды №3 алтыбұрыш кілтімен бұраңыз.
- Серіппені ([→ "45-сур. - 3"](#)) және істікті ([→ "45-сур. - 4"](#)) сынаға ([→ "45-сур. - 2"](#)) жалпақ жағымен бекітіңіз. Сынаны бұрағышпен тартылатын бөлікті толығымен бұраңыз.
- Бекіткіш бұрандаларды ([→ "45-сур. - 5"](#)) ([→ "45-сур. - 6"](#)) толығымен бұраңыз.

6.1.3 Үлгі қысқыштарына арналған дәл бағыттағыш қондырығы

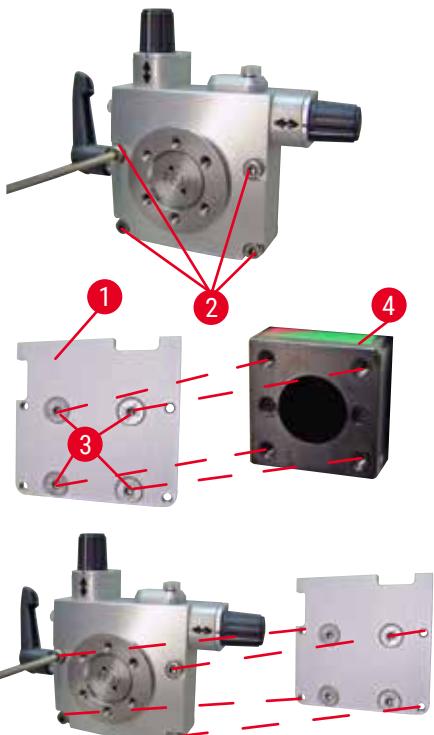


46-сур.

- Үлгілерге арналған қысқышты бекітуге арналған бекіткішті орнатпас бұрын, 4 бұранданы ([→ "46-сур. - 2"](#)) босатыңыз (№3 алтыбұрыш кілті) және үлгі қапсырмаларына арналған бекітпені астыңғы тақтадан ([→ "46-сур. - 1"](#)) мүқият алып тастаңыз.
- Берілген 4 бұранданы ([→ "46-сур. - 3"](#)) және №3 алтыбұрыш кілтін қолданып, негізгі тақтаны зат басына ([→ "46-сур. - 4"](#)) бекітіңіз.
- Енді үлгілік қысқыштар үшін жұқа бағыттағыш қондырығыны 4 бұрандамен ([→ "46-сур. - 2"](#)) және №3 алтыбұрыш кілтімен объектінің басына бұраңыз.

**Кеңестер**

Егер үлгіні қысқыштарға арналған дәл бағыттағыш қондырғы қолданылмаса, негізгі тақтаны (\rightarrow "46-сур. - 1") және 4 бұранданы (\rightarrow "46-сур. - 3") үлгілік қысқышқа арналған жұқа бағыттағышпен бірге ұстаңыз.

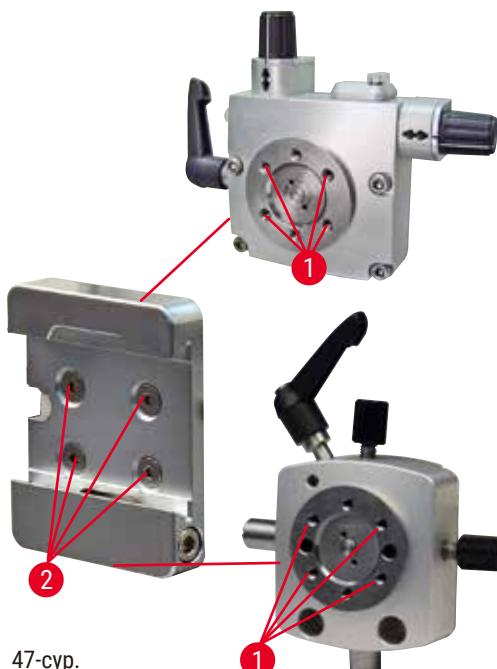6.1.4 Жылдам қысқыш жүйесі


Ол нөлдік нүктө индикаторы бар үлгіні қысқыштарға арналған жұқа бағыттағыш қондырғымен немесе үлгі қысқыштары үшін бағыттауышпен бірге қолдануға арналған адаптер ретінде қолданылады.

Аллен кілтінің өлшемі 2,5 болатын 4 бұранданы (\rightarrow "47-сур. - 2") тесікке (\rightarrow "47-сур. - 1") бұрап бекітіңіз.

6.2 Үлгі қысқыштары мен ұсташыстары**Кеңестер**

Керек-жарақтар ретінде қолжетімді барлық үлгілік қысқыштар үлгіні ұстайтын жұқа бағыттаушы немесе бағыттаушы қондырғыларға біріктірілуі мүмкін. Үлгі қысқыштар мен ұсташыстарды жылдам қысу жүйесіне қалай орнату керектігін (\rightarrow 51-б. – 5.4 Әмбебап кассета қысқышын салу) бөлімінен қараңыз.

6.2.1 Стандартты үлгі қысқышы

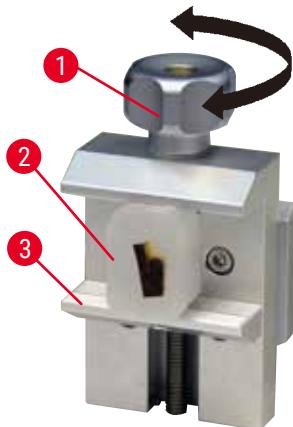

48-сүр.

Стандартты үлгі қысқышы екі өлшемде шығарылады: 40 x 40 мм және 50 x 55 мм. Олар тікбұрышты блоктарды тікелей қысуға арналған. Сонымен қатар, олар фольга қысқышын және V-кіріктірмесін орналастырады.

- Жылжымалы иекті ([→ "48-сүр. - 3"](#)) төмен қарай жылжыту үшін бұралған бұранданы ([→ "48-сүр. - 1"](#)) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Үлгіні ([→ "48-сүр. - 2"](#)) қажетінше орнатыңыз.
- Үлгіні сенімді түрде қысу үшін қозғалмалы жақты бекітілген жаққа қарай жоғары жылжыту үшін бұралған бұранданы ([→ "48-сүр. - 1"](#)) сағат тілімен бұраңыз.




Сақ болыңыз

Бөлу үшін типтік жағдайлар жеткіліксіз.

Үлгінің зақымдалуы немесе кесудің нашар нәтижесі, мысалы, қалыңдығы бойынша ауыспалы, қысылған, бүктелген немесе жолақты кесінділер.

- Бөлімдердің жеткіліксіз нәтижелері анықталса, бөлуді жалғастырмаңыз.
- Тиісті бөлу үшін барлық алғышарттардың орындалғанына көз жеткізіңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін осы пайдалану нұсқаулығының ақауларды жою бөлімін қараңыз.
- Егер бөлу бойынша ақаулықтарды жою туралы жеткілікті біліміңіз болмаса, мұндай салада білімі бар адамдармен, мысалы, Leica Biosystems қосымшасының сарапшыларымен кеңесіңіз.

6.2.2 Әмбебап кассета қысқышы

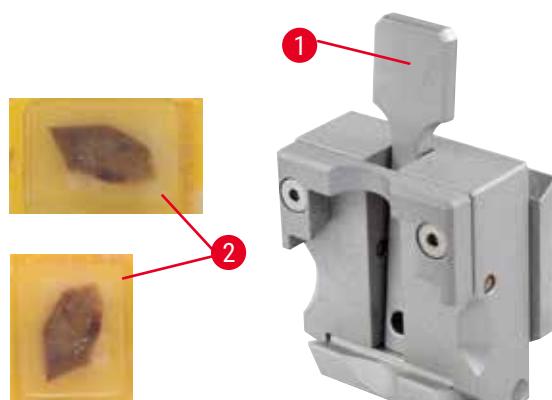

49-сүр.

Ең аз өлшемдері 39,8 x 28 мм және максимальды өлшемдері 40,9 x 28 мм болатын сургипат кассеталары әмбебап кассета қысқышында (UCC) көлденең және тігінен қысылуы мүмкін.

- Тұтқаны ([→ "49-сүр. - 1"](#)) операторға қарай тартыңыз.
- Қажет болса, кассетаны ([→ "49-сүр. - 2"](#)) көлденең немесе тігінен орнатыңыз.
- Кассетаны қысу үшін тұтқаны ([→ "49-сүр. - 1"](#)) босатыңыз.



Сақ болыңыз

Бөлу үшін типтік жағдайлар жеткіліксіз.

Улгінің зақымдалуы немесе кесудің нашар нәтижесі, мысалы, қалыңдығы бойынша ауыспалы, қысылған, бұқтелген немесе жолақты кесінділер.

- Бөлімдердің жеткіліккіз нәтижелері анықталса, бөлуді жалғастырмаңыз.
- Тиісті бөлу үшін барлық алғышарттардың орындалғанына көз жеткізіңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін осы пайдалану нұсқаулығының ақауларды жою бөлімін қараңыз.
- Егер бөлу бойынша ақаулықтарды жою туралы жеткілікті біліміңіз болмаса, мұндай салада білімі бар адамдармен, мысалы, Leica Biosystems қосымшасының сарапшыларымен кеңесіңіз.



Сақ болыңыз

Кассета қақпағының қалған сынған жиегі нашар қысылуына байланысты қима сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін.

Адамдардың ауыр жарақаты.

- Қақпағы қалыпталған кассетаны пайдаланған кезде, қақпақты алу кезінде қалған сынған үлгінің мықтап бекітілуіне кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз - қажет болған жағдайда үлгіні қөлденеңінен қысу керек.



Абайлаңыз

Жұқа қабырғалы кассеталарды қолданған кезде, кассеталар деформацияланады немесе нашар бекітіледі немесе қысқыш жүйеге байланысты басқа ақаулар болады.

Улгінің зақымдалуы/диагностиканың кідірісі.

- Жұқа қабырғалы кассеталарды қолданғанда абай болыңыз. Жұқа қабырғалы кассеталардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Егер пайдаланушы кассетаны қысуға тырысса және оның орнында бекітілмегені белгілі болса, неғұрлық тұрақтысын қолданыңыз.




Абайлаңыз

Кассетаның сыртындағы парафин шөгінділері әмбебап кассета қысқышын кірлеуі мүмкін.

Ластану кассетаның мықтап бекітілуіне жол бермейді және кесіндінің тыым қалың немесе жұқа болуына әкеліп соғуы мүмкін, бұл бөлімнің ішінде жарылып кетуі мүмкін және ең нашар жағдайда үлгіге зақым келуі мүмкін.

- Бөлу алдында пайдаланушы үлгінің мықтап бекітілгенін тексеруі керек.
- Әмбебап кассеталық қысқыштан парафин шөгінділерін алып тастаңыз.

6.2.3 Супер кассеталы қысқышы

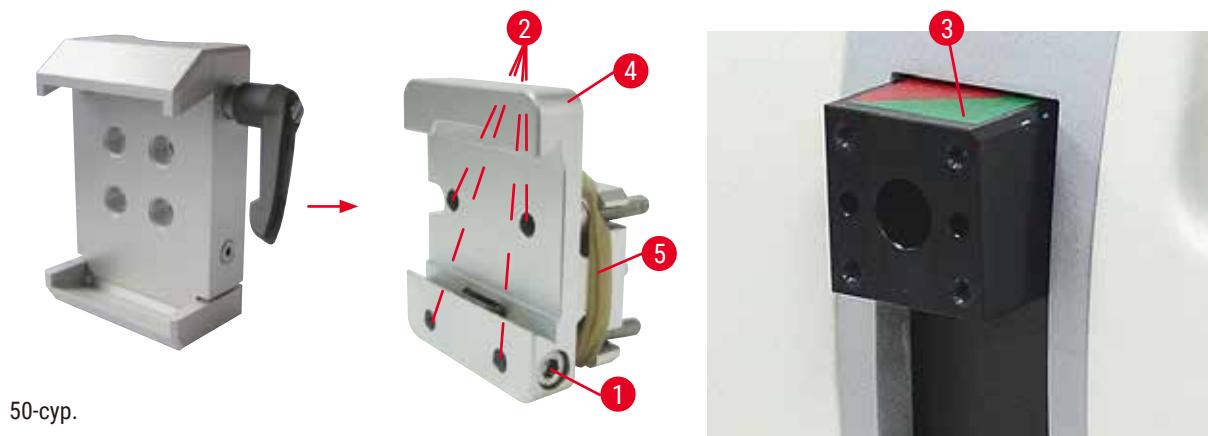

Супер кассеталық қысқыш жинағы



Кеңестер

Резеңке сақинаны (\rightarrow "50-сур. - 5") заттың басына үлгі қысқыштары үшін қатаң бекіткішті орнатқаннан кейін ғана алыңыз.

Үлкен кассеталық қысқыш үлгілерге арналған қысқыштар үшін қатаң бекіткішпен қолданылуы тиіс.

Ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Үлгі қысқыштары (\rightarrow "50-сур. - 4") үшін қатаң бекіткішті обьектінің басына (\rightarrow "50-сур. - 3") бұраңыз: Бұранданы (\rightarrow "50-сур. - 1") алып тастаңыз, үлгілік қысқыштар (\rightarrow "50-сур. - 4") үшін қатаң бекіткішті заттың басына (\rightarrow "50-сур. - 3") алдыңғы жағынан қойыңыз және бұрандаларды (\rightarrow "50-сур. - 2") №3 алтыбұрыш кілтімен бекітіңіз. Содан кейін бұранданы (\rightarrow "50-сур. - 1") бүйірден салыңыз да, оны №4 алтыбұрыш кілтімен қысыңыз.
- Үлгі кассета қысқышын сол жақтан үлгінің қысқыштары үшін қатаң бекіткіштің ұшқыш бағыттағышына салыңыз және бұранданы (\rightarrow "50-сур. - 1") бұраңыз.



Абайлаңыз

Үлкен кассеталық қысқыш қолданылғанда, пышақ ұстағышының табанымен үлгі қысқыштарына арналған бағыттағыш қондырығы қолданылғанда немесе артқы жарықтандырылған кезде бағдар "0" күйіне орнатылмаған.

Құрал дұрыс жұмыс істемеү мүмкін, бұл диагностиканы кідіртеді.

- Бағыт "0" күйінде болуы керек және артқы жарықтандыруға арналған қақпақ ажыратылуы керек.
- ЕШҚАШАН артқы жарығы бар супер кассета қысқышын қолданбаңыз.
- Күштің тере-тендік жүйесін супер кассеталық қысқышпен пайдалану кезінде реттеу қажет.

6.3 Пышақ ұстағыш негізі мен пышақ ұстағыш



51-сур.

Құрал мен пышақ ұстағыштардағы барлық қысқыш түтқалардың пластик ұстағыштары әр пайдалануши үшін ең қолайлы күйге бұрылуы мүмкін.

Түтқаны ([→ "51-сур. - 1"](#)) ұстағыштан тартып шығарыңыз, оны осы қалыпта ұстаңыз және қажетті күйге бұрыңыз. Содан кейін ол босатылған кезде автоматты түрде құлышталады.

6.3.1 Екі функциясы бар "E" жүз ұстағышы



52-сур.

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 Жүзді шығару құралы | 6 Қауіпсіздік қорғанысы |
| 2 Қысқыш қақпағы | 7 Болт |
| 3 Қысу түтқасы (сол жақ) | 8 Қысу түтқасы (оң жақ) |
| 4 Сегмент доғасы | 9 Қысым тақтасы |
| 5 Жүз ұстағышының негізі | |


Екі функциясы бар "E" жүз ұстағышы бір рет қолданылатын пышақтарға арналған және "Surgipath" бір реттік пышақтармен қолдануға оңтайландырылған. Оны жоғары профильді де, төмен профильді де бір реттік жүздер үшін қолдануға болады. Екі функциясы бар "E" жүз ұстағышында көлденең жылжыту функциясы бар, сондықтан жүздің бүкіл енін қолдануға болады. Қолданғаннан кейін жүзді қауіпсіз алу үшін жүзді шығару құралымен жабдықталған. Қысым тақтасы ауыстырыла алады.



Кеңестер

Екі функциялы "E" пышақ ұстағышындағы қысқыш түтқалар бір-бірін алмастырмайды. Қысқыштың екі түтқасы ([→ "52-сур. - 8"](#)) ([→ "52-сур. - 3"](#)) әрқашан көрсетілген қалыпта қалуы керек, әйтпесе екі функциялы "E" ұстағышында оқшауланған ақаулары орын алуы мүмкін. Жүздің ([→ "52-сур. - 8"](#)) қысқыш түтқасы оң жақта, бүйірлік ығысыуға ([→ "52-сур. - 3"](#)) арналған қысқыш түтқасы сол жақта.

6 Қосымша керек-жарақтар

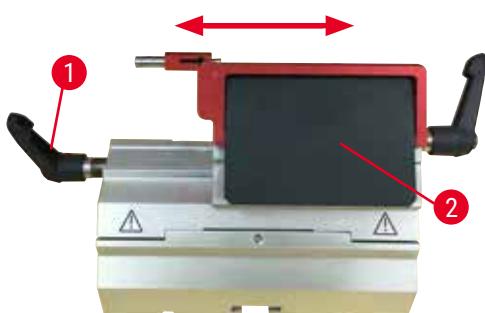

53-сур.

Бүйірлік ығысу

Екі функциясы бар “E” жұз ұстағышының бүйірлік қозғалыс ерекшелігі қысқыш шыңды бүйірге жылжыту арқылы пышақтың бүкіл ұзындығын пайдалануға мүмкіндік береді. Қажет болса, стандартты кассетаның еніне сәйкес келетін үш алдын ала анықталған тоқтау позициясын (сол жақ, орталық, оң жақ) қолдануға болады.

- Қысқышты босату үшін екі функциясы бар “E” жұз ұстағышының сол жақ тұтқасын ([→ “53-сур. - 1”](#)) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Қысқыш қақпағын ([→ “53-сур. - 2”](#)) бүйірге жылжытыңыз.
- Қысу үшін тұтқаны ([→ “53-сур. - 1”](#)) сағат тілімен бұраңыз.



Сақ болыңыз

Жұздер қысым тақтасының жоғарғы шетіне толық параллель орнатылмаған.

Бүйірлік қозғалыс функциясын қолданғанда, пышақты қысым тақтасына параллель орнатпау кесу нәтижесінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Мысалы, егер бөлім тым қалың немесе тым жіңішке болса, ең нашар сценарийде бөлімнің ішінде сейлесу үлгіні зақымдауы мүмкін.

- Бөлімнің қанағаттанарлықсыз нәтижелерін алған кезде бөлуді жалғастырмаңыз.
- Жұздерді қайта орнатыңыз және оның қысым тақтасының жоғарғы шетіне параллель екеніне көз жеткізіңіз.
- Жұздерді көлденең жылжыту функциясы арқылы жылжытқаннан кейін әрқашан жұз бен қысым тақтасы арасындағы параллельдікті тексеріңіз.

6.3.2 Пышақ ұстағышының негізі, бүйірлік жылжу функциясы жоқ



54-сур.

Пышақ ұстағыш негізінің орнын ауыстыру

Бір бөліктен тұратын пышақ ұстағыш негізін (қатаң) ([→ “54-сур. - 2”](#)) микротомды тақтасында алға және артқа жылжытуға болады.

Бұл тік ығысу пышақ ұстағышты үлгіге қатысты оңтайтын кесу күйіне келтіруге мүмкіндік береді.

- Босату үшін микротомдың тақтасында оң жағындағы қысқыш тұтқаны ([→ “54-сур. - 1”](#)) сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Пышақ ұстағышын пышақ ұстағыш негізімен бірге сәйкесінше алға немесе артқа ауыстырыңыз.
- Тұтқаны ([→ “54-сур. - 1”](#)) сағат тілімен бұрау арқылы қысқыш механизмді бекітіңіз.

6.3.3 "E" пысақ ұстағышы төмен профильді пысақтарға арналған су шүнқыры бар



55-сур.

Су шүнқыры ([→ "55-сур."](#)) бар "E" пысақ ұстағышы тек төмен профильді пысақтарға арналған.

"E" пысақ ұстағышындағы сақтандырғыш қызыл жиналмалы тұтқадан ([→ "55-сур. - 1"](#)) тұрады. Кескіш жиекті жабу үшін, сақтандырғыш тұтқасын ([→ "55-сур. - 1"](#)) суретте көрсетілгендей сағат тілімен бұраңыз.



Кеңестер

Пысақ ұстағышындағы қысқыш тұтқалар бір-бірін алмастырмайды. Қысқыштың екі тұтқасы ([→ "55-сур. - 2"](#)) және ([→ "55-сур. - 3"](#)) әрқашан көрсетілген күйде қалуы керек, себебі пысақ ұстағышының оқшауланған ақаулары орын алуы мүмкін.

Жүздің ([→ "55-сур. - 2"](#)) қысқыш тұтқасы оң жақта, бүйірлік ығысуға ([→ "55-сур. - 3"](#)) арналған қысқыш тұтқасы сол жақта.



56-сур.

Пайдалану

Су бетінде қалқып жүретін жұқа парафинді бөліктер (мысалы, иммунды бояудың келесі процедурапары үшін).


Үдис жүзге дейін тазартылған немесе ионсыздандырылған сүмен толтырылады. Кескіннен кейін, ыдистан бөлік қалдықтарын алып тастаңыз және дайындалатын бөлімдерді жасаңыз.

Су бетінде қалқып жүретін бөліктерді әйнек слайдының көмегімен жинауға болады.

6.3.4 Пысақ ұстағышы N

Пысақ ұстағыш N ұзындығы 16 см-ге дейінгі с және d профильді стандартты болат пысақтарға сәйкес келеді. Биіктікті реттеудің интеграцияланған мүмкіндігі бірнеше рет жаңартылған пысақтарды қолдануға мүмкіндік береді.

- Пысақ ұстағышы N ([→ "57-сур."](#)): Ұзындығы 16 см-ге дейін қаралайым пысақтарды ұстап арналған.

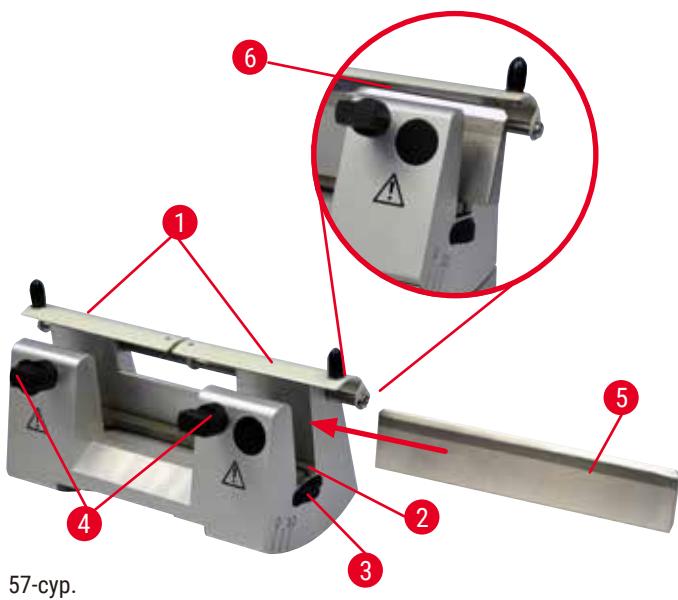

Пышақтың тіреуіш стерженін орнату

- Қауіпсіздік қорғанысын (→ “57-сүр. - 1”) ортаға қарай итеріңіз.
- Пышақтың тіреуішін стерженін (→ “57-сүр. - 2”) биіктікті реттеу бұрандаларына орнатыңыз. Биіктікті реттеу бұрандаларының жалпақ ұштары пышақ тіреу штангасының әр ұшындағы ойықтарда орналасуы керек.



Сақ болыңыз

Пышақ/жүздер пышақ/жүз ұстағышы мен пышақ/жүз ұстағыш негізі құралға орнатылmas бұрын орнатылады.

Өте еткір пышақтармен және/немесе жүздермен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақты/жүзді салмас бұрын микротомға пышақ/жүз ұстағышы мен пышақ/жүз ұстағыш негізін орнату қажет.

Пышақты енгізу

- Пышақ ұстағыштың оң және сол жағындағы ілгекті гайкаларды (→ “57-сүр. - 3”) қарама-қарсы бағытта алға қарай айналдырыңыз, пышақтың тіреуіш штангасын мүмкіндігінше төменге түсіріңіз, осылайша пышақ салынған кезде пышақ жиегінің зақымдалмайтындығына көз жеткізіңіз.
- Қысқыш бұрандаларды (→ “57-сүр. - 4”) пышақ қауіпсіз енгізілгенше бұрап алыңыз (сағат тіліне қарсы).
- Пышақты (→ “57-сүр. - 5”) пышақ түбінен ұстаңыз және кескіш жиекті жоғары қаратып, оны ұстағышқа бүйірінен мұқият салыңыз.



58-сүр.

С профильді пышақтың ([→ "58-сүр. - 1"](#)) екі жағын да енгізуге болады, ал д профильді пышақтың ([→ "58-сүр. - 2"](#)) беті операторға қарауы керек. Пышақты қате қою үлгі мен пышақты зақымдауы мүмкін.

Пышақ биіктігін реттеу

Пышақ биіктігін реттеу кезінде пышақ жиегі пышақ ұстағышының нақты айналу орталығында мүмкіндігінше дәл орналасуы керек. Артқы қысқыш ілгектердің бекітілген жиегі ([→ "57-сүр. - 6"](#)) пышақ биіктігін дұрыс реттеу үшін тірек орны болып табылады.

- Пышақ жүзі ([→ "57-сүр. - 6"](#)) артқы қысқыш ілгектердің бекітілген жиектеріндегі белгілерге параллель болғанша, бұралған гайкаларды ([→ "57-сүр. - 3"](#)) біркелкі және артқа қарай бұраңыз.
- Пышақты ([→ "57-сүр. - 5"](#)) біркелкі қысу үшін екі пышақ қысқыш бұранданы ([→ "57-сүр. - 4"](#)) ішке қарай бұраңыз (сағат тілімен).

Пышақтың бүйірлік орналасуы

- Қауіпсіздік қорғанысын ([→ "57-сүр. - 1"](#)) ортаға қарай итеріңіз.
- Қысқыш бұрандаларды ([→ "57-сүр. - 4"](#)) сағат тіліне қарсы бұрап босатыңыз.
- Пышақты ([→ "57-сүр. - 5"](#)) қажетінше солға немесе оңға итеріңіз.
- Пышақтың орнын ауыстырғаннан кейін пышақтың биіктігін ([→ 71-6. – Пышақ биіктігін реттеу](#)) реттеңіз, содан кейін пышақты ([→ "57-сүр. - 5"](#)) қысу үшін сағат тілімен бұрап, бүйірінде орналасқан қысқыш бұранданы ([→ "57-сүр. - 4"](#)) бұраңыз.



Абайлаңыз

Пышақ/жұз ұстағыш бүйірден жылжытылғаннан кейін, үлгі кері тартылмайды және қайта кесілмейді.

Үлгінің зақымдалуы.

- Пышақ/жұз ұстағышын бүйірінен жылжытқаннан кейін, заттың басын артқа тартып, үлгі блогын қайта қысыңыз.

6.4 Бөліктің қалдықтар науасы



59-сүр.

Антистатикалық секцияға арналған қалдықтар науасы антистатикалық бетке байланысты тазалаудың жеңілдігін қамтамасыз етеді. Бөлім қалдықтар науасын ([→ "59-сүр. - 1"](#)) екі магнит ([→ "59-сүр. - 3"](#)) (микротомды табақшаның алдыңғы жағында) ұстағанша, алдыңғы жағынан микротомды негіздік тақтасына ([→ "59-сүр. - 2"](#)) қарай итеріңіз.

6

Қосымша керек-жарақтар


6.5 Артқы жарық



Кеңестер

Артқы жарықтандыруды "Е" екі функциялы жүз ұстағышының пышақ ұстағыш негізімен бірге пайдалану мүмкін емес.

HistoCore MULTICUT артқы жарықтандыру қосулы күйде пайдалану үшін сыртқы қуат көзінің артқы жарығына (Тапсырыс №: 14 0500 31244) бөлек тапсырыс берілуі керек.

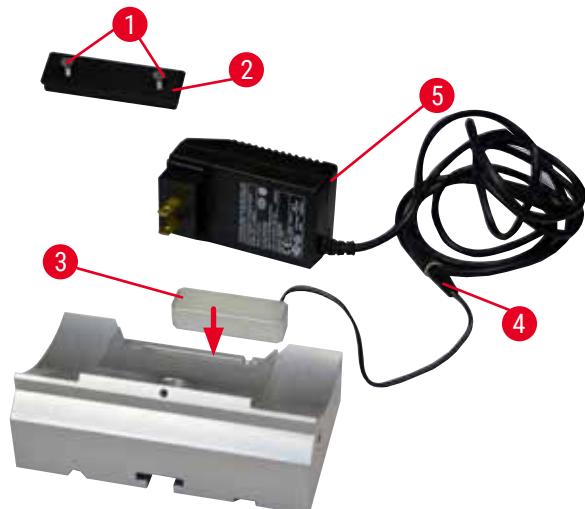

60-сур.

- Саңылаулы бұрауыштың көмегімен екі бұранданы ([→ "60-сур. - 1"](#)) алыңыз, содан кейін қақпақ тақтасын ([→ "60-сур. - 2"](#)) алыңыз.
- Артқы жарығын ([→ "60-сур. - 3"](#)) пышақ ұстағыш негізінің артқы жағындағы ойықта салыңыз.
- Артқы жарықтың тығызынын ([→ "60-сур. - 4"](#)) сыртқы қуат блогының артқы жарықтығынына ([→ "60-сур. - 5"](#)) қосыңыз.
- Тиісті кернеуге сәйкес келетін тығынды таңдап, оны адаптерге қосыңыз. Тығынды қуат розеткасына салыңыз, артқы жарық жанады.



Абайлаңыз

Үлкен кассеталық қысқыш қолданылғанда, пышақ ұстағышының табанымен үлгі қысқыштарына арналған бағыттағыш қондырғы қолданылғанда немесе артқы жарықтандырылған кезде бағдар "0" күйіне орнатылмаған.

Құрал дүрыс жұмыс істемеүі мүмкін, бұл диагностиканы кідіртеді.

- Бағыт "0" күйінде болуы керек және артқы жарықтандыруға арналған қақпақ ажыратылуы керек.
- ЕШҚАШАН артқы жарығы бар супер кассета қысқышын қолданбаңыз.
- Күштің тепе-теңдік жүйесін супер кассеталық қысқышпен пайдалану кезінде реттеу қажет.

6.6 Жоғарғы науа



61-сур.


Жоғарғы науа микротомның корпусына орнатылады. Үстіңгі науда да, сорғышта да орналасқан белгі ([→ "61-сур. - 1"](#)) жоғарғы науаны орнатуды бағыттауға көмектеседі. Үстіңгі науа кесу кезінде қолданылатын ыдыстарды, сондай-ақ кесілген үлгілерді сақтауға арналған.

6.7 Әмбебап микроскоп тасымалдаушысы



Кеңестер

Қаптамадағы барлық керек-жарақтарды орап, толықтығын тексеріңіз.

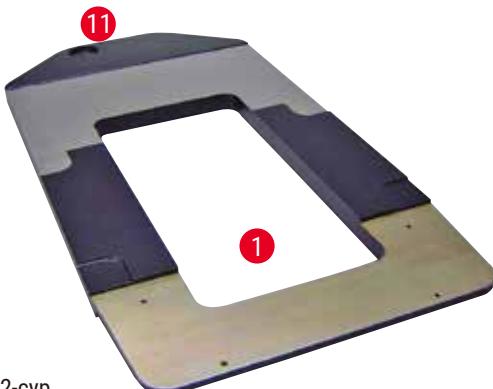

62-сүр.



63-сүр.

- (→ “62-сүр. - 1”), Бұрғылау бар табан
(→ “62-сүр. - 11”)
- (→ “63-сүр. - 2”), Көлемі 8 қақпақшалы бұрандалы (→ “63-сүр. - 12”) және бекіткіш шайбалы (→ “63-сүр. - 13”) тік баған
- (→ “63-сүр. - 3”), Көлденең бөлік (→ “63-сүр. - 14”) және тірек сақинасы (→ “63-сүр. - 15”) бар
- (→ “63-сүр. - 4”), Қолдау тақтасы, үлкен (BIOCUT, MULTICUT және AUTOCUT үшін)
- (→ “63-сүр. - 5”), Қолдау тақтасы, кішкентай (NANOCUT R үшін)
- (→ “63-сүр. - 6”), №3 алтыбұрыш кілті
- (→ “63-сүр. - 7”), Тіреуіш тақтаны орнату үшін 4 қарама-қарсы бұрандалар
- (→ “63-сүр. - 8”), алтыбұрыш кілті, өлшемі: 8




64-сүр.

Микроскоптың әмбебап тасымалдаушысын жинау

- Негізгі тақтаны бекітіңіз. Қолданылатын микротомға байланысты үлкен (→ “63-сүр. - 5”) немесе кіші (→ “63-сүр. - 4”) тіреу тақтасын таңдаңыз. Тіреу тақтасын №3 алтыбұрыш кілтін (→ “63-сүр. - 6”) қолдана отырып, бекітілген 4 бұранданың (→ “63-сүр. - 7”) көмегімен табан тақтасына бекітіңіз.



65-сүр.

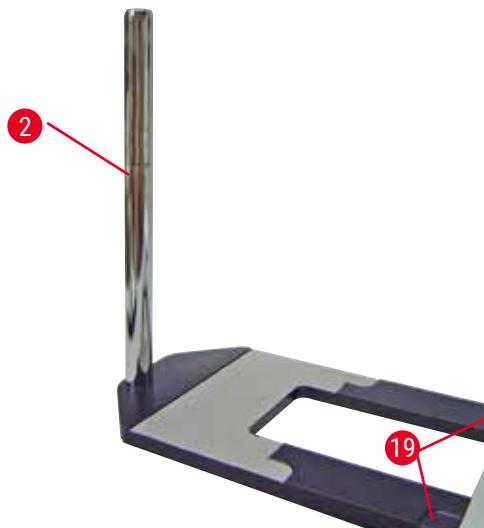

66-сүр.

- Тік бағанды бекітіңіз. Қақпақ бұрандасын (\rightarrow “65-сүр. - 12”) астыңғы тақтай тесігіне төмennен салыңыз. Құлыш шайбасын (\rightarrow “65-сүр. - 13”) қақпақ бұрандасына жоғарыдан қойыңыз. Құміс тік бағанды (\rightarrow “66-сүр. - 2”) негіз тақтасына үстінен орналастырып, алтыбұрыш кілтінің келесі өлшемімен бекітіңіз: 8.



Сақ болыңыз

Әмбебап микроскоптың тасымалдаушысына қатысты кеңестер.


Адамдардың ауыр жарақаты.

- Тік бағанды орнатқаннан кейін, микротомның алдыңғы табандары таяз ойықтарда (\rightarrow “66-сүр. - 19”) орналасатында етіп, микротомды дереу табанға қойыңыз.



Кеңестер

Бағанның байқаусызда бұрылып кетуіне жол бермеу үшін құлыштау жуғышын негізгі тақтай мен тік бағананың арасына орналастыру қажет.

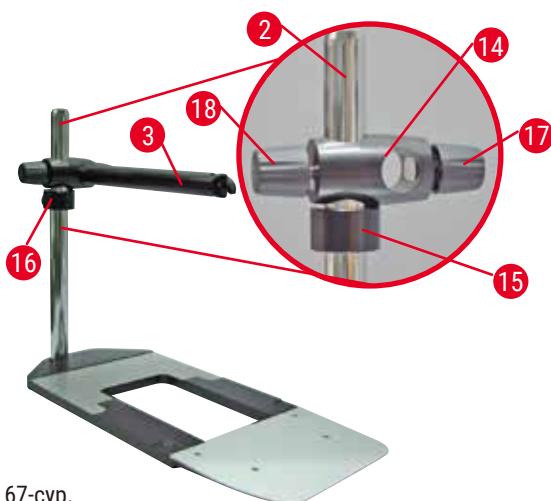

- Көлденең таянышты бекітініз. Тіреу сақинасын ([→ "67-сүр. - 15"](#)) тік бағанға сырғытыңыз және бекіткіш гайкасы ([→ "67-сүр. - 16"](#)) артқа қарайтындағы етіп орналастырыңыз. Бекіткіш гайканы қатайтыңыз. Көлденең бөлікті ([→ "67-сүр. - 10"](#)) бағанға қарай сырғытыңыз. Бекіткіш бұранданың ([→ "67-сүр. - 17"](#)) негізгі тақтаның оң жағына қарағанына көз жеткізіңіз. Көлденең қол микроскоптың ортасында орналасуы керек. Көлденең таянышты ([→ "67-сүр. - 3"](#)), тегіс жағын құлыштау бұрандасына ([→ "67-сүр. - 17"](#)) қаратып, көлденең бөлікке ([→ "67-сүр. - 14"](#)) сырғытыңыз және қатайтыңыз.



Кеңестер

Микроскопты, үлкейткіш линзаны немесе сүйкі жарық көзін қосу және қолдану туралы қосымша ақпарат алу үшін тиісті Пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

6.8 Үлкейткіш линза, ЖД жарықтандыруы



Кеңестер


Үлкейткіш линза 2 есе үлкейтуді қамтамасыз етеді және оны HistoCore сериялы айналмалы микротомдармен қолдануға болады.



- Микроскоп тасымалдаушының көлденең тұтқасындағы бұранданы ([→ "68-сүр. - 3"](#)) сағат тіліне қарсы бағытта ашыңыз.
- Күміс қосылу бөлігін ([→ "68-сүр. - 1"](#)) мүмкіндігінше алыс салыңыз. Бұранданы ([→ "68-сүр. - 3"](#)) қатайтыңыз.
- Адаптер ([→ "68-сүр. - 2"](#)) жоғары жарық диодты жарықдиодты нұктелерді орнатуға мүмкіндік береді. ЖД 1000 Hi-Power нұктелерін, 2 таянышты адаптермен ([→ "69-сүр."](#)) қосыңыз. ЖД 1000 Hi-Power нұктелерінің тығындарын ([→ "69-сүр. - 1"](#)), 2 білікті, жоғары қуатты нұктелік контроллердің ([→ "69-сүр. - 3"](#)) розеткасына ([→ "69-сүр. - 2"](#)) салыңыз. ЖД 1000 басқару

блогының қуат адаптерін ([→ "69-сур. - 4"](#)) жоғары қуатты нұктелік контроллерге, содан кейін қуат көзіне қосыңыз. Аймағыңыздың қуат адаптері үшін ұсынылған розеткадан ([→ "69-сур. - 5"](#)) дұрыс штепсельді таңдағаныңызға көз жеткізіңіз.

- Екі нұктелі шамды ([→ "69-сур. - 6"](#)) қосу немесе өшіру үшін жоғары қуатты нұктелік контроллердегі түймені ([→ "69-сур. - 7"](#)) басыңыз, ол сәйкесінше жоғары қуатты нұктеле контроллеріндегі екі жасыл шаммен ([→ "69-сур. - 8"](#)) көрсетілген. Диск шамдарының жарықтығын реттеу үшін басқару дөңгелегін ([→ "69-сур. - 9"](#)) бұраңыз.

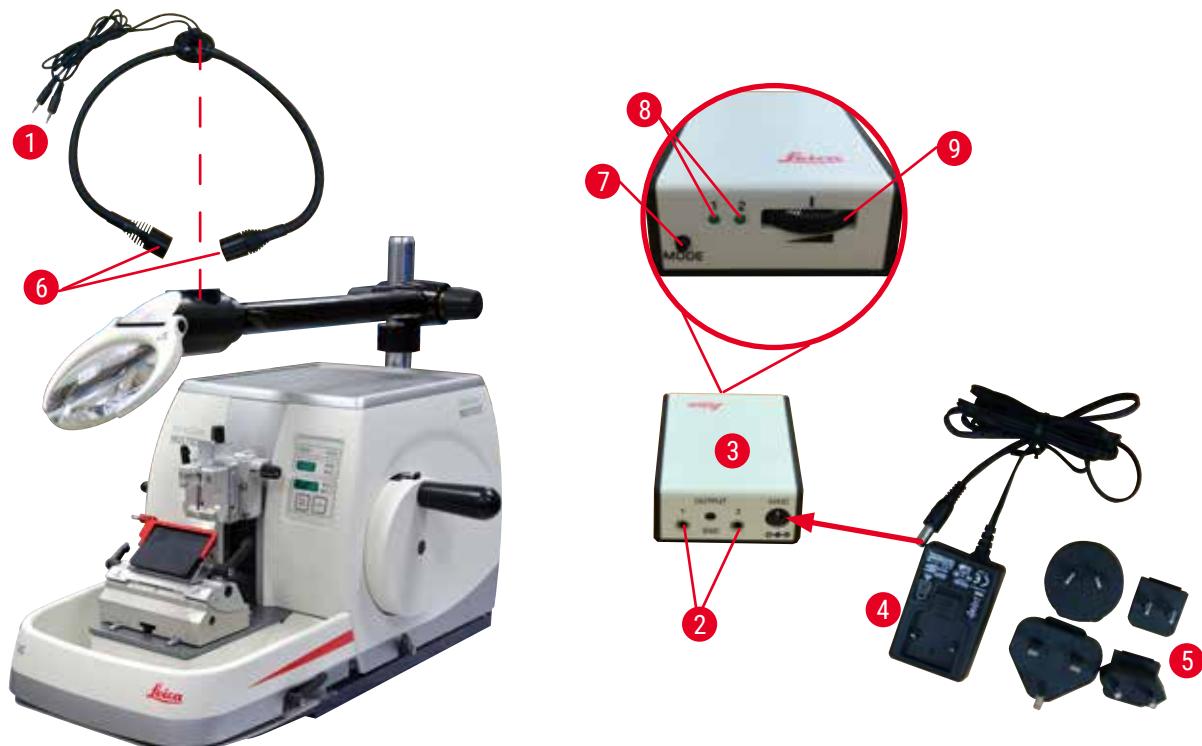

69-сур.

- Үлкейткіш линзаның орнын өңделетін үлгіге реттеңіз. Қажет болса, үлкейткіш линзаны толық бүйірге бұруға болады.



Сақ болыңыз

Үлкейткіш линза онымен жұмыс істемеген кезде жабылмайды.

Жаңып тұрған әйнектің әсерінен адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым туындауы мүмкін. Үлкейткіш линза айналадағы заттарды, әсіресе тікелей күн сәулесі түскен кезде, өртеп жіберуі мүмкін.

- Үлкейткіш линзамен жұмыс жасамаған кезде оны әрқашан жабыңыз.
 - Әсіресе оны тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз.
- Үлкейту линзасын жабу үшін берілген қорғаңыс қақпағын ([→ "68-сур. - 4"](#)) қолданыңыз.

6.9 Қосымша керек-жарақтар

Пышақ ұстағыш негізі, бағытталмайды



70-сур.

Пышақ ұстаушы N үшін күміс және пышақ ұстаушы Е үшін сынамен

- Тапсырыс №: 14 0502 37962

Пышақ ұстағышы N



71-сур.

Күміс, ұзындығы 16 см-ге дейін қарапайым пышақтарды ұстауға арналған
Пышақтың биектігін реттеу
Бөлек саңылау бұрышын реттеу
Жылжымалы қауіпсіздік қорғанысы

- Тапсырыс №: 14 0502 37993

Сынасы бар "Е" пышақ ұстағышы



72-сур.

Төмен профильді бір реттік пышақтар үшін, (80 x 8 x 0,25 мм), күміс, су төгу оймасымен
Жылдам қысқыш жүйесі
Қысқыштың үстіңгі жағын жылжыту мүмкіндігі
3 рет басу күйлері пышақтың бүкіл ұзындығын
пайдалануды жеңілдетеді
Түсті кодталған, бұқтелетін қауіпсіздік
қорғанысы

- Тапсырыс №: 14 0502 38961

“Екі функциясы бар “E” жүз ұстағышының негізі



73-сур.

“Екі функциясы бар “E” жүз ұстағышының негізі

- Тапсырыс №: 14 0502 55546

Екі функциясы бар “E” жүз ұстағышы



74-сур.

Жоғары және төмен профильді бір реттік пышақтар үшін

HistoCore MULTICUT үшін

Қысқыш шыңды бүйірден жылжыту мүмкіндігі
3 рет басу қүйлері пышақтың бүкіл ұзындығын пайдалануды жеңілдетеді

Қысым тақтасы ауыстырыла алады.

Түсті кодталған, бүктелетін қауіпсіздік қорғанысы

Жүзді шығару құралы бар

- Тапсырыс №: 14 0502 54497

Бір реттік пышақтар – төмен профильді (819)



75-сур.

80 x 8 x 0,25 мм


- 50 дана 10 бума: 14 0358 38925
- 50 дана 10 бума: 14 0358 38382

Бір реттік пышақтар – жоғары профиль (818)

76-сур.

80 x 14 x 0,35 мм

- 50 дана 10 бума: 14 0358 38926
- 50 дана 10 бума: 14 0358 38383

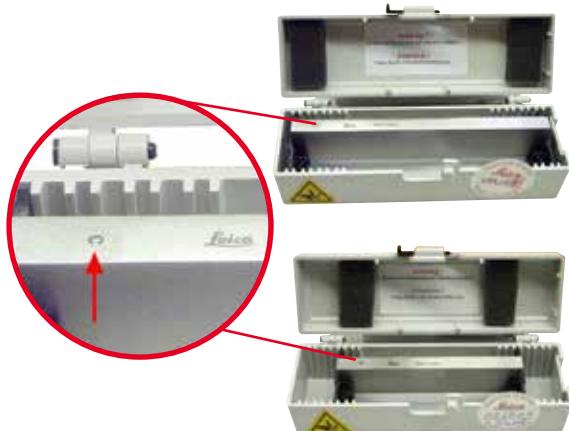Пышақ 16 см - в профилі - болат, Пышақ 16 см - d профилі - болат

77-сур.

Пышақ, ұзындығы 16 см, с профилі
Ескертпе: 14 0213 11140 пышақ корпусы
қамтылған

- Тапсырыс №: 14 0216 07100

Пышақ, ұзындығы 16 см, d профилі
Ескертпе: 14 0213 11140 пышақ корпусы
қамтылған

- Тапсырыс №: 14 0216 07132

Пышақ корпусы - кіші

78-сур.

Пластик, ұзындығы 10-16 см аралығында,
1 немесе 2 пышаққа арналған айныамалы.

- Тапсырыс №: 14 0213 11140

Әмбебап кассета қысқышы



79-сүр.

адаптері бар, күміс
Өлшемдері минимумы 39,8 x 28 x 5,8 мм және
максимумы 40,9 x 28,8 x 6,2 мм стандартты
кассеталармен қолдану үшін.

- Тапсырыс №: 14 0502 37999

Стандартты үлгі қысқышы



80-сүр.

50 x 55 мм, адаптері бар, күміс
• Тапсырыс №: 14 0502 38005

Стандартты үлгі қысқышы



81-сүр.

40 x 40 мм, адаптері бар, күміс
• Тапсырыс №: 14 0502 37998

Үлгі ұстағыш қондырғы, бағытталған



82-сур.

Күміс, оның ішінде қондырғы жабдықтары.
Ескертпе: Жылдам қысу жүйесіне 14 0502
37718 бөлек тапсырыс беру керек.

- Тапсырыс №: 14 0502 38949

Үлгі ұстағыш қондырғы, бағытталмаған



83-сур.

Күміс, әр түрлі қысқыштарды ұстау, соның ішінде
орнату қондырғылары үшін ([→61-б. – 6.](#)
[Қосымша керек-жарақтар](#)) қараңыз

- Тапсырыс нөмірі: 14 0502 38160

Үлгі ұстағыш қондырғы, дәл бағыттаушы



84-сур.

Күміс, 2 нөлдік нүктө индикаторымен, XY
бағдары бойынша 8°, әр 2° сайын тоқтайды
Ескертпе: Жылдам қысу жүйесіне 14 0502
37718 бөлек тапсырыс берілуі керек.

- Тапсырыс №: 14 0502 37717

Жылдам қысқыш жүйесі



85-сур.

Үлгі ұстағыш үшін 14 0502 37717 нөлдік нүктелік индикаторы бар үлгілік қысқыштар үшін жұқа бағыттағыш қондырғымен немесе үлгі қысқыштары үшін бағыттауышпен 14 0502 38949

- Тапсырыс №: 14 0502 37718

Супер кассеталы қысқышы



86-сур.

Адаптермен, күміс

Ескертпе:

14 0502 38160 үлгілерін ұстауға арналған бағдарланбайтын қондырғымен бірге бөлек тапсырыс беріңіз.

Артқы жарық 14 0502 38719 супер кассеталық қысқышқа байланысты қолданыла алмайды. Біз "Surgipath" супер кассеталар мен қақпақтарды, ақ түсті (VSP 59060B-BX, VSP 59060-CS) және супер металды ендіретін қалыптарды (VSP58166) қолдануды ұсынамыз. (YxEхB) 75 x 52 x 35 мм

- Тапсырыс №: 14 0502 38967

RM CoolClamp

87-сур.

HistoCore айналмалы микротомға арналған адаптері бар электрлік жолмен салқындастылатын әмбебап кассеталы қысқыш. Өлшемдері минимумы 39,8 x 28 x 5,8 мм және максимумы 40,9 x 28 мм стандартты кассеталармен қолдану үшін.

RM CoolClamp көмегімен әмбебап кассета қысқышын электрмен салқындау арқылы біркелкі микротомды қималарды қалыптаиды. Қуатты үнемдеу

жылу тарату жүйесі арқылы салқындастылады. HistoCore айналмалы микротомдарының патенттелген күш тепе-теңдігі жүйесі үлгі дөңгелектерін дөңгелекті өзгертуей тез және сенімді түрде өзгертуге мүмкіндік береді. Антистатикалық материал тазалауды жеңілдетеді. HistoCore сериясының барлық айналмалы микротомдары үшін қайта жабдықталуы мүмкін.

Техникалық мәліметтер:

Жұмыс басталғанға дейін алдын ала салқындау уақыты: 30 минут

Температура: Қоршаған ортасының температурасынан 20 К төмен

Қоршаған орта температурасының диапазоны: +10 °C және +35 °C аралығында

Салыстырмалы ылғалдылық: макс. 80%, конденсатсыз

Салмағы: шам. 650 гр

Өлшемдері (Е x Т x Б): 80 x 114 x 204 мм

Қуат кірісі: 100 - 240 В/ 50/ 60 Гц

Сертификаттар: CE, c_CSA_US

Стандартты жеткізу:

RM CoolClamp

Кабельмен және 4 адаптері бар қуат көзі (Ұлыбритания, АҚШ, EO, AUS)

5 кабель қысқыштары

Қолдану жөніндегі нұсқаулық және DVD

- Тапсырыс №: 14 0502 46573

**Кеңестер**

RM Coolclamp микроскоппен немесе үлкейткішпен бірге қолданыла алмайды.

Үлкейткіш



88-сур.

Микроскоп тасымалдаушыларда құрастыру үшін (14 0502 40580), 2 есе үлкейту

Ескертпе:

Үлғайтыш қосымша ЖД жарықтандыруды ұстауға арналған адаптерді қамтиды

- Тапсырыс №: 14 0502 42790

Әмбебап микроскоп тасымалдаушысы



89-сур.

Әмбебап жинақ

- Тапсырыс №: 14 0502 40580

Артқы жарық



90-сур.

Ескертпе:

HistoCore BIOCUT және MULTICUT жүйелері үшін тек сыртқы қуатпен қамту блогының артқы жарығы 14 0500 31244 берілген.

14 0502 38967 Супер кассеталы қысқышына байланысты артқы жарықты қолдану мүмкін емес.

- Тапсырыс №: 14 0502 38719

Сыртқы қуатпен қамту блогының артқы жарығы



91-сүр.

14 0502 38719 артқы жарықтандыруда қолдану үшін, HistoCore BIOCUT and MULTICUT айналмалы микротом сериясына арналған
Келесі адаптерлер қамтылған:
Біріккен Корольдік, Еуропа, АҚШ/Жапония, Австралия

- Тапсырыс №: 14 0500 31244

Жоғарғы науа



92-сүр.

HistoCore айналмалы микротом сериялары үшін

- Тапсырыс №: 14 0517 56261

Бөліктің қалдықтар науасы



93-сүр.

HistoCore айналмалы микротом сериялары үшін

- Антистатикалық бөліктің қалдықтар науасы
Тапсырыс нөмірі: 14 0517 56237

Қылشاқ



94-сүр.

"Е" екі функциялы жұз ұстағышына арнаған жүзді алып тастауға арналған магниті бар

- Тапсырыс №: 14 0183 40426

Қауіпсіздік қолғаптары



95-сүр.

Өлшемі: M, 250 ± 20 мм, сары

- Тапсырыс №: 14 0340 29011

Кесуден қорғалған қауіпсіздік қолғаптары, өлшемі: S, 250±20 мм

- Тапсырыс №: 14 0340 40859

6.10 Тапсырыс беру ақпараты

Пышақ ұстағыш негізі	14 0502 37962
Пышақ ұстағышы N	14 0502 37993
Төмен профильді "Е" пышақ ұстағышы	14 0502 38961
Жұз ұстағышының негіzi	14 0502 55546
2 функциясы бар "Е" жұз ұстағышы	14 0502 54497
Бір реттік пышақтар – төмен профильді, 1 қаптама, 50 дана (80 x 8 x 0,25 мм)	14 0358 38925
Бір реттік пышақтар – төмен профильді, 10 қаптама, 50 дана	14 0358 38382
Бір реттік пышақтар – жоғары профильді, 1 қаптама 50 дана (80 x 14 x 0,35 мм)	14 0358 38926
Бір реттік пышақтар – жоғары профильді, 10 қаптама, 50 дана	14 0358 38383
Пышақ 16 см - в профилі - болат	14 0216 07100
Пышақ 16 см - d профилі - болат	14 0216 07132
Пышақ корпусы - кіші	14 0213 11140
Әмбебап кассета қысқышы	14 0502 37999

Стандартты үлгі қысқышы 50x55 мм	14 0502 38005
Стандартты үлгі қысқышы 40x40 мм	14 0502 37998
Үлгі қысқышына арналған бағыттауыш бекітпе	14 0502 38949
Үлгі қысқышына арналған қатаң бекітпе	14 0502 38160
Үлгі қысқышына арналған дәл бағыттағыш қондырғы	14 0502 37717
Жылдам қысқыш жүйесі	14 0502 37718
Супер кассеталы қысқышы	14 0502 38967
RM CoolClamp	14 0502 46573
Үлкейткіш	14 0502 42790
Әмбебап микроскоп тасымалдаушысы	14 0502 40580
ЖД 1000 Hi-Power нұктелері, 2 білікті (Бұл модуль тек ЖД 1000 басқару блогымен жұмыс жасай алады, Тапсырыс №: 14 6000 04825.)	14 6000 04826
ЖД 1000 басқару блогы (Бұл модуль тек ЖД 1000 жоғары қуатты нұктелермен, 2 білікті, Тапсырыс №: 14 6000 04826.)	14 6000 04825
Артқы жарық (Артқы жарықтандыруды тек пышақ ұстағыш негізімен қолдануға болады Тапсырыс №: 14 0502 37962.)	14 0502 38719
Сыртқы қуатпен қамту блогының артқы жарығы	14 0500 31244
Жоғарғы науа	14 0517 56261
Антистатикалық қалдықтар науасы	14 0517 56237
Магниті бар қылشاқ	14 0183 40426
Қауіпсіздік қолғаптары, M өлшемі	14 0340 29011
Қауіпсіздік қолғаптары, S өлшемі	14 0340 40859

Басқа керек-жарақтарды көру үшін, өнімнің онлайн каталогына кіріңіз
www.LeicaBiosystems.com.

7. Ақаулықтарды шешу

7.1 Қате кодтары

Құрылғыда қате пайда болған кезде үш сандық ЖД дисплейде қате коды пайда болады.

Төмендегі кестеде көрсетілетін қате кодтары берілген. “Орындалатын әрекеттер” бағанындағы нұсқауларды орындаңыз.

Қате коды	Құралдың ақауы	Қате сипаттамасы	Орындалатын әрекеттер
	E1 қате коды көрсетіледі.	Барлық параметр мәндері әдепкі мәндерге қайтарылады.	<ol style="list-style-type: none"> Қатені растау үшін басқару тақтасындағы кез келген түймені басыңыз. Бұрын енгізілген мәндердің әлі де дұрыс екенін білу үшін барлық параметрлер мәндерін тексеріңіз. Мәндерді қайта енгізу қажет болуы мүмкін. Егер E1 қате коды қайта-қайта пайда болса, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.
	E2 қате коды көрсетіледі; екі секундқа созылатын ескерту дыбысы естіледі. Құрал ешқандай әрекетке жауап бермейді.	Заттың басының беріліс драйвері дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.	<ol style="list-style-type: none"> Құралды қайта іске қосыңыз және E2 қате кодының бар-жоғын тексеріңіз. Егер E2 қате коды әлі де бар болса, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.
	E3 қате коды көрсетіледі; екі секундқа созылатын ескерту дыбысы естіледі. Құрал ешқандай әрекетке жауап бермейді.	Заттың басын беру/ қайтару қосқышы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.	<ol style="list-style-type: none"> Құралды қайта іске қосыңыз және E3 қате кодының бар-жоғын тексеріңіз. Егер E3 қате коды әлі де бар болса, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.
	E4 қате коды көрсетіледі; екі секундқа созылатын ескерту дыбысы естіледі. Құрал ешқандай әрекетке жауап бермейді.	Заттың басын беру диапазоны дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.	<ol style="list-style-type: none"> Құралды қайта іске қосыңыз және E4 қате кодының бар-жоғын тексеріңіз. Егер E4 қате коды әлі де бар болса, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.
	E5 қате коды көрсетіледі; екі секундқа созылатын ескерту дыбысы естіледі. Құрал ешқандай әрекетке жауап бермейді.	Бір жады күйі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.	<ol style="list-style-type: none"> Құралды қайта іске қосыңыз және E5 қате кодының бар-жоғын тексеріңіз. Егер E5 қате коды әлі де бар болса, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.

7.2 Мүмкін ақаулар

Мәселе	Мүмкін себебі	Түзету әрекеті
Қалың/жіңішке бөліктер Бөліктер қалың және жіңішке болып ауысады, немесе бөліктерде сықырлау пайда болады немесе үлгі кірістірмеден жыртылады. Кейбір жағдайларда ешқандай бөліктер жоқ.	<ul style="list-style-type: none"> Жүз, пышақ ұстағыш немесе бағыттау дұрыс бекітілмеген. Үлгі дұрыс қыстырылмаған. 	<ul style="list-style-type: none"> Жүзді, пышақ ұстағыштарды немесе бағытты қайта қыстырыңыз. Кассетаның әмбебап кассеталық қысқышқа мықтап бекітілгенін тексеріңіз. Егер әмбебап кассета қысқыш парафинмен ластанған болса, әмбебап кассета қысқышын (→94-б. – 8.1 Құралды тазалау) тазалаңыз. Қақпағы қалыпталған кассеталарды пайдаланған кезде, сынған жиектің кассетаны мықтап бекітуге мүмкіндік беретінін тексеріңіз; қажет болса, бұрылыстарды алыңыз немесе кассетаны әмбебап кассета қысқышына тігінен емес, көлденеңінен қысыңыз. Егер кассета өлшемдері көрсетілген рұқсат етілген шегінде болса және кассетаны әлі де сенімді түрде бекіту мүмкін болмаса, әмбебап кассета қысқышы дұрыс конфигурацияланбаған немесе ақаулы болуы мүмкін. Бұл жағдайда Техникалық қызмет көрсету орталығына әмбебап кассета қысқышын тексеріп, оны қайта конфигурациялаңыз.

Мәселе	Мүмкін себебі	Түзету әрекеті
(жалғасы) Қалың/жіңішке бөліктер Бөліктер қалың және жіңішке болып аудысады, немесе бөліктерде сықырлау пайда болады немесе үлгі кірістірмeden жыртылады. Кейбір жағдайларда ешқандай бөліктер жоқ.	<p>(жалғасы)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Үлгі дұрыс қыстырылмаған. • Жүздің беті күңгірт. • Қысым тақтасы зақымдалған немесе дұрыс реттелмеген. • Пышақ/жүздің тазалау бұрышы тым кішкентай. • Парафин берілген үшін қатты емес. 	<p>(жалғасы)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leica Biosystems компаниясынан басқа фирмандың кассеталарын, әсіресе жұқа қабырғалы кассеталарды пайдаланған кезде, кассета деформациялануы мүмкін немесе басқа қысу проблемалары туындауы мүмкін. Егер кассетаны қысуға тырысқанда, оның орнында бекітілмегенің түсінсеңіз, балама кернеу қысқышын қолдану қажет. • Пышақ/жүз ұстағышын кейін ауыстырыңыз немесе жаңа пышақ/жүзді салыңыз. • Жаңа қысым тақтасын салыңыз немесе жаңа екі функциялы жүз ұстағышын қолданыңыз. • Қысым тақтасын қайта реттеңіз. • Оңтайлы бұрыш табылмайынша, тазарту бұрышының бірнеше реттелуін жүйелі түрде қолданып көріңіз. • Балқу температурасы жоғары парафиннді қолданыңыз немесе блокты салқындастыңыз.
Бөлікті қысу Бөліктер тым қысылған, бетінде қатпарлар байқалады немесе бірге қысылған.	<ul style="list-style-type: none"> • Жүздің беті күңгірт. • Үлгі тым ыстық. • Бөлу жылдамдығы тым жоғары. 	<ul style="list-style-type: none"> • Жүздің басқа аймағын немесе жаңа жүзді қолданыңыз. • Үлгіні кесу алдында салқындастыңыз. • Бөлу жылдамдығын азайтыңыз.
Бөліктердегі “жолақтар” Екі функциясы бар “E” жүз ұстағышы	<ul style="list-style-type: none"> • Пышақ ұстағыштың артқы қысым пластинасында парафиннің жиналуды байқалады. • Саңылау бұрышы тым тік, нөлге жақын. • Пышақтың кесу жиегінде ойықтар бар. 	<ul style="list-style-type: none"> • Бұл аймақтан парафинді үнемі алып тастаңыз. • Саңылау бұрышын реттеңіз. • Жүзді ауыстырыңыз.

Мәселе	Мүмкін себебі	Түзету әрекеті
Бөлу кезіндегі шу Пышақ қатты үлгілерді кесу кезінде “шу шығарады” Бөлімдерде сызаттар немесе белгілер бар.	<ul style="list-style-type: none"> Бөлу жылдамдығы тым жоғары. Саңылау бұрышы тым кең. Үлгі және/немесе пышақ ұстағыштың жеткіліксіз қысылуы. Шайыр/пластик ендірілген үлгілерді бөлу кезінде кері тарту өшіріледі. 	<ul style="list-style-type: none"> Баяу бөлу жылдамдығын таңдаңыз. Оңтайлы реттеу алынғанша тазарту бұрышын жүйелі түрде азайтыңыз. Үлгіні ұстау жүйесіндегі және пышақ ұстағыштағы бұрандалар мен қысқыштардың барлық қосылыстарын тексеріңіз. Қажет болса, тұтқалар мен бұрандаларды қатайтыңыз. Кері қайтаруды қосыңыз.
Жұздің жоғары тұтынылуы	<ul style="list-style-type: none"> Тым үлкен бөлу күші қолданылды. Тым кіші саңылау бұрышы. 	<ul style="list-style-type: none"> Кесу кезінде кесу жылдамдығын және/немесе бөлімнің қалыңдығын реттеңіз. Қалыңдығы кішірек бөлікті таңдаңыз, дөңгелекті баяу айналдырыңыз. Саңылау бұрышын реттеңіз.

7.3 Құралдың дұрыс жұмыс істемеуі


Төменде құралмен жұмыс кезінде туындауы мүмкін ең жиі кездесетін ақаулардың тізімі, ықтимал себептері мен ақаулықтарды жою процедурапары көрсетілген. Егер ақаулықты кестеде көрсетілген опциялардың бірімен жою мүмкін болмаса немесе мәселе бірнеше рет қайталанса, Leica Biosystems Service Support қызыметіне дереу хабарлаңыз.

Мәселе	Мүмкін себебі	Түзету әрекеті
Дисплей көрсетпейді; құрал қосылғаннан кейін басылған түймелерге жауап жоқ.	<ul style="list-style-type: none"> Қуат кабелі дұрыс жалғанбаған. Қуат сақтандырғыштары ақаулы. Басқару панелінің кабелі дұрыс қосылмаған. Кернеуді таңдау қосқышы дұрыс орнатылмаған. 	<ul style="list-style-type: none"> Қуат кабелінің қосылуын тексеріңіз. Қуат сақтандырғыштарын ауыстырыңыз. Кабельдің басқару тақтасына қосылуын тексеріңіз. Кернеу параметрін тексеріп, қажетінше түзетіңіз (→34-6. – 4.5.1 Кернеуді тексеру).

Мәселе	Мүмкін себебі	Түзету әрекеті
Беріліс қозғалысы бұдан былай жоқ.	<ul style="list-style-type: none"> Қалған жолдың соңына жетті. Құрал қосылған кезде үлгі қалған жолда болды. 	<ul style="list-style-type: none"> TRIM/SECT түймесін басу арқылы кесу режимін таңдаңыз. Содан кейін үлгіні үлкен беру түймесін пайдаланып шығарыңыз. Жоғарыда қараңыз.
Қалған жол аймағындағы үлгіні үлкен беріліс түймелері арқылы қайтаруға болмайды.	STEP режимі әлі де белсенді (SECT түймешігіндегі ЖД жанады).	<ul style="list-style-type: none"> Кесу режиміне ауысу үшін TRIM/SECT түймесін басыңыз. Үлгіні үлкен беріліс түймесін пайдаланып қайтарыңыз.

7.4 Екі функциясы бар "Е" жүз ұстағышының ақаулары

7.4.1 Қысым тақтасын аудастыру

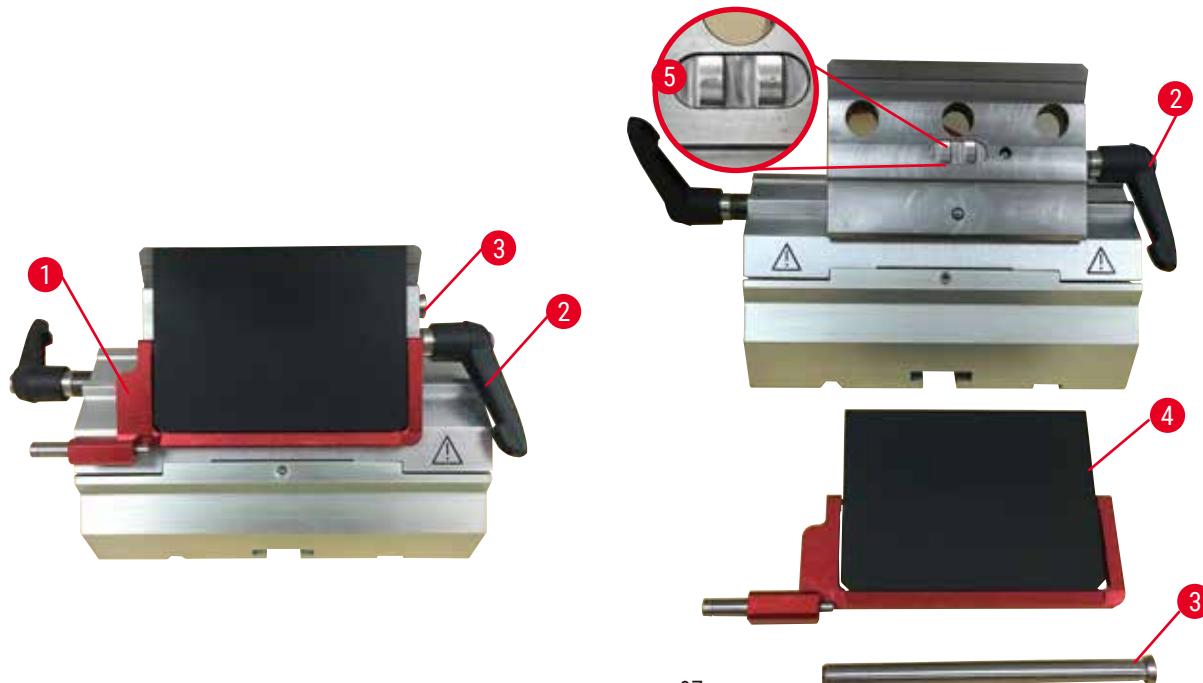

96-сур.

97-сур.

- Қауіпсіздік қорғанысын төмен ([→ "96-сур. - 1"](#)) түсіріңіз.
- Қысқыш тұтқаны сағат тіліне қарсы ([→ "96-сур. - 2"](#)) бұраңыз.
- Болтты ([→ "96-сур. - 3"](#)) ([→ "97-сур. - 3"](#)) шығарыңыз.
- Зақымдалған қысым тақтасын ([→ "97-сур. - 4"](#)) алыңыз.




Кеңестер

Қысқыш үстіңгі бөлігінің құлап қалу жағдайында көрсетілгендей ([→ "97-сур. - 5"](#)) орнатылғанын тексеріңіз. Егер ол қате орнатылса, қысым тақтасын қысуға болмайды.

- Жаңа қысым тақтасын орнатыңыз.
- Болтты ([→ "97-сур. - 3"](#)) салыңыз.
- Қысқыш тұтқаны сағат тілімен ([→ "97-сур. - 2"](#)) бұраңыз.

7.4.2 Қысқыштың жоғарғы бөлігін сегмент доғасына бекіту

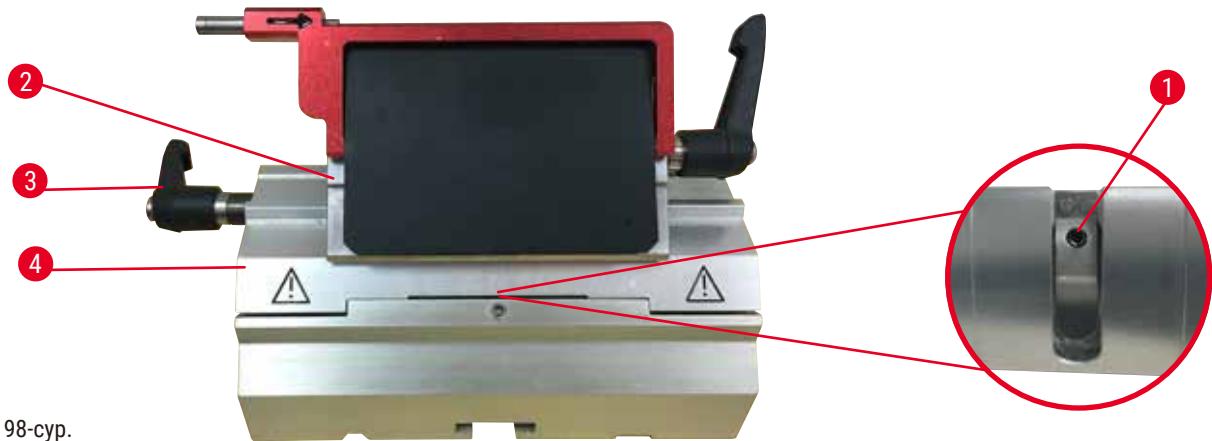

Дұрыс кесу нәтижесін қамтамасыз ету үшін, қысқыштың жоғарғы жағы ([→ "98-сүр. - 2"](#)) сегмент доғасына ([→ "98-сүр. - 4"](#)) мықтап бекітілуі керек.

Қысу эксцентрлік тұтқаның ([→ "98-сүр. - 3"](#)) көмегімен жүзеге асады. Қысу күші сегмент доғасының астыңғы жағындағы бекіткіш бұранда ([→ "98-сүр. - 1"](#)) көмегімен реттеледі. Қысқышты орнату тұрақты қарсылықпен қысқыш тұтқаны тоқтауға бұруға болатында етіп жүзеге асырылады.

Бекіткіш бұрандадағы ([→ "98-сүр. - 1"](#)) 2,5 мм алтыбұрыш кілтінің көмегімен қысуды реттегіш іске қосылған кезде тұтқа бастапқыда “сырғып кететін” етіп реттеңіз. Бекіткіш бұранданы ([→ "98-сүр. - 1"](#)) сәл айналдыруды жалғастырыңыз (шамамен 1/4 солға немесе онға бұрыңыз), содан кейін тетіктің “сырғып кетпейтінін”, сонымен қатар “қатты” кептеліп қалмағанын тексеріңіз.

7.5 Қысқыш қондырғының қысқыш жүйесінің негіздік тақтаға орнатылуы



Эксцентрлік болттан қысу қашықтығын 270°-қа орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз.

1. Пышақ ұстағыш негізін құралдың негізіне ([→ "99-сүр. - 1"](#)) қойыңыз.
2. Эксцентрлік болтты ([→ "99-сүр. - 2"](#)) 0° ([→ "99-сүр. - 3"](#)) және 270° ([→ "99-сүр. - 4"](#)) қүйінде қысуға болатында етіп, №4 алтыбұрыш кілтін ([→ "99-сүр. - 6"](#)) қолдана отырып, негіздегі қысқыш бөлігіндегі қарама-қарсы бұранданы ([→ "99-сүр. - 5"](#)) бұрау немесе бұрау арқылы реттеңіз.

8. Тазалау және техникалық қызмет көрсету

8.1 Құралды тазалау



Сақ болыңыз

Құралды электр ашасын ажыратпай тазалау.

Адамдардың жарақат алуына әкелетін электр тогының соғуы.

- Эр тазалау алдында құралды өшіріп, ашаны желіден ажыратыңыз. Тиісті еріткіштерді немесе тазартқыштарды сұйықтықтың енуіне жол бермеу үшін құралға тікелей емес, тазартқыш алаңға шашыңыз. Егер сұйықтық құралдың ішіне түссе, Leica Biosystems қызметіне хабарласыңыз.



Сақ болыңыз

Сұйықтықтардың құралдың ішкі бөлігіне ену қаупі.

Құрал/адамдардың ауыр жарақаты немесе үлгінің бүлінуі.

- Жұмыс кезінде және техникалық қызмет көрсету кезінде сұйықтықтың құралдың ішкі жағына түспеуін қадағалаңыз.



Сақ болыңыз

Пышақ/жұз ұстағышын микротомнан алып тастаған кезде пышақ/жұз алынбады.

Өте өткір пышақпен/жұзбен жанасу салдарынан адамдардың ауыр жарақаты.

- Пышақ/жұз ұстағышын микротомнан алмас бұрын, пышақты/жұзді кесуге төзімді қолғап кигенде ажыратыңыз және пышақты/жұзді қауіпсіз жерде сақтаңыз.



Сақ болыңыз

Пышақ/жұз дұрыс сақталмаған.

Адамдардың ауыр жарақаттары, мысалы, күтпеген жерден құлау.

- Пышақ/жұзді пайдаланбайтын кезде оларды әрқашан тиісті жерде сақтаңыз, мысалы, арнайы пышақ қорабына салыңыз.
- Ешқашан пышақты кесу жиегін жоғары қаратып қоймаңыз және құлап жатқан пышақты ұстауға тырыспаңыз.



Сақ болыңыз

Пышақ/жұз ұстағышы құралдан құлап түсу қаупі.

Адамдардың ауыр жарақаты және/немесе мүліктік зақым.

- Егер пышақ/жұз ұстағыш бекітілмеген болса, мысалы, орнату немесе тазалау кезінде, пышақ/жұз ұстағышының құлап кетпеуін қадағалаңыз.
- Мүмкіндігінше, пышақ/жұз ұстағышы құлап кетпеу үшін оны бекітіңіз.
- Кездейсоқ құлап кетпес үшін орнату немесе техникалық қызмет көрсету үшін пышақ ұстағыш негізінен пышақ/жұз ұстағышын алыңыз.



Абайлаңыз

Құралды немесе керек-жарақтарды тазалау үшін дұрыс емес еріткіштерді немесе тазартқыштарды немесе өткір/қатты құралдарды қолдану.

Құралдың мүмкін дұрыс жұмыс істемеуді немесе диагностика кідірісі.

- Тазалау үшін құрамында ацетон немесе ксилол бар еріткіштерді қолданбаңыз.
- Тазартқышты қолданған кезде өндірушінің қауіпсіздік нұсқауларын және зертханалық қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз.
- Құралдың бетін тырнау үшін ешқашан өткір немесе қатты құралды қолданбаңыз.
- Керек-жарақтарды ешқашан тазалағыш ерітіндіге немесе суға батырмаңыз.
- Болат пышақтарды спирт негізіндегі ерітінді немесе ацетонмен тазалаңыз.
- Парафинді тазалау және шығару үшін құрамында ксилолды немесе құрамында спирті бар сұйықтықтарды (мысалы, шыны тазалағыш) қолданбаңыз.



Ескертпе

Керек-жарақтар мен құрамдастар коррозиялық/қатты қышқыл/сілтілі реагентті немесе еріткішті, мысалы құрамында қышқылы бар кальцийленбен ерітінді, құрамында сілті бар аммоний гидроксиді және т.б. құралмен немесе керек-жарақпен қолдану нәтижесінде коррозияға ұшырайды.

Керек-жарақтар дұрыс жұмыс істемеуді мүмкін.

- Құрал бетіне немесе керек-жарақтарға агрессивті/қатты қышқыл/сілтілі реагент немесе еріткіш тамшыламаңыз.
- Егер мұндай реагент немесе еріткіш құралдың бетіне немесе керек-жарақтарына тисе, оның қалдықтарды сұртіп, керек-жарақтарды мүмкіндігінше тез кептіріңіз.
- Егер мұндай реагент немесе еріткіш жиі қолданылса, жұз ұстағышты, әмбебап кассета қысқышын (UCC) және қажет болған жағдайда басқа керек-жарақтарды күнделікті мұқият тазалаңыз.

Әр тазалау алдында келесі дайындық шараларын орындаңыз:

- Үлгі қысқышын жоғарғы шеткі жағдайға көтеріп, қолмен басқару құралын іске қосыңыз.
- Құрады өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
- Жұзді жұз ұстағышынан алыңыз және оны диспенсердің төменгі жағындағы ыдысқа салыңыз немесе пышақты пышақ ұстағыштан шығарып алып, қайтадан пышақ қорабына салыңыз.
- Тазалау үшін пышақ/жұз ұстағыш негізі мен пышақ/жұз ұстағышты алыңыз.
- Үлгіні қысқыштан алыңыз.
- Бөлім қалдықтарын құрғақ қылшақпен алып тастаңыз.
- Үлгі қысқышын алыңыз және бөлек тазалаңыз.

Құрал және сыртқы беттер

Қажет болса, басқару тақталарының лакпен қапталған сыртқы беттерін жұмсақ түрмистық тазартқышпен немесе сабынды сумен тазалап, содан кейін шүберекпен сұртуге болады.

Парафин қалдықтарын кетіру үшін ксилол алмастырыштарды, парафин майын немесе парафинді кетіргіштерді қолдануға болады.

Қайта қолданар алдында құрал толығымен құрғақ болуы керек.



Сақ болыңыз

Тазалау кезінде жұзді дұрыс емес бағытта сұрту.

Адамдардың ауыр жарақаты.


- Пышақты әрқашан жұздің артқы жағынан кесу жиегіне дейін сұртіңіз.



Кеңес

Құралды толық құрғамайынша қоспаңыз.

Екі функциясы бар "Е" жүз ұстағышы

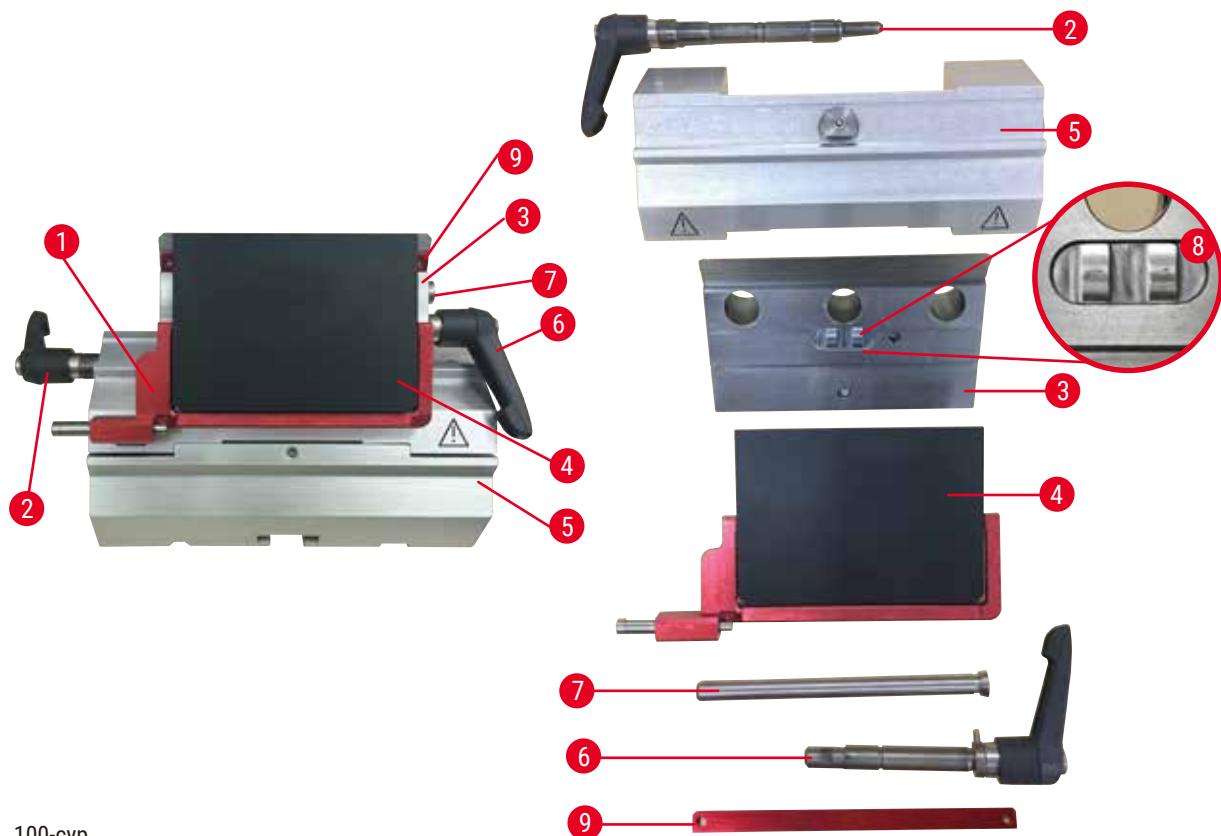

100-сур.

1. Төмен профильді пышақтар үшін кірістіруді (*→ "100-сур. - 9"*) алыңыз.
2. Қысқыш тақтаны алдымен қысқыш төбесінен (*→ "100-сур. - 4"*) алыңыз. Ол үшін пышақтың қысқыш тұтқасын (*→ "100-сур. - 6"*) сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз және оны бүйірінен шығарыңыз; болтты (*→ "100-сур. - 7"*) шығарып, қысым тақтасын алыңыз.
3. Қысқыштың жоғарғы жағын алыңыз. Ол үшін бүйірлік ығысудың қысқыш тұтқасын (*→ "100-сур. - 2"*) сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз және оны бүйірден шығарыңыз; қысқыштың жоғарғы жағын (*→ "100-сур. - 3"*) сегменттік доғадан (*→ "100-сур. - 5"*) шығарылмайынша итеріңіз.
4. №4 алтыбұрыш кілтінің көмегімен эксцентрлік болтты босатыңыз және пышақ ұстағышының негізінен сегменттік доғаны алыңыз.
5. "Е" екі функциялы жүз ұстағышының барлық бөлшектерін тазалаңыз.



Абайлаңыз

Тазалау кезінде жүз ұстағыштардың бөліктегі аудисуы мүмкін.

Кескін сапасы нашар.

- Тазалау кезінде жүз ұстағыштарын өзара ауыстырмаңыз.

6. Алынған бөліктерді сіңіргіш шүберекке кептіру камерасына салыңыз (максимум 65°C дейін) және парафинмен ластануды тоқтатыңыз.



Сақ болыңыз

Пышақ/жұз ұстағышты тазалау кезінде кептіру камерасынан бөлшектерді алу (65°C).

Күйіп қалу қаупі.

- Бөлшектерді кептіру камерасынан алу кезінде жылу оқшаулағыш қолғап киіңіз (65°C).


7. Пышақ ұстағышын Е сүртіңіз және бөлме температурасына дейін сұтыңыз, содан кейін оны қайта жинаңыз.
8. Екі функциясы бар "Е" жұз ұстағышының қозғалмалы бөліктерін тазалағаннан кейін, оларға жұқа қабатты жетек майын жағыңыз.
9. Қысым тақтасын ([→ "100-сур. - 4"](#)) орнатқан кезде қысқыш үстіңгі бөлігінің ([→ "100-сур. - 8"](#)) көрсетілгендей дұрыс орнатылғанын және қысым тақтасының үстіңгі жиегі қысқыш үстіңгі жиегімен ([→ "100-сур. - 3"](#)) параллель және бір деңгейде екенін тексеріңіз.



Кеңестер

Егер қысқыштың үстіңгі бөлігі дұрыс орнатылмаса, қысым тақтасын қысуға болмайды.

Әмбебап кассета қысқышы

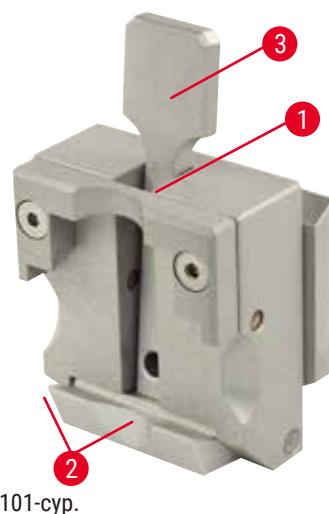

- Парафиннің барлық қалдықтарын алып тастап, мұқият тазарту үшін кассета қысқышын ([→ "101-сур. - 1"](#)) ажыратыңыз.
- Тазалау үшін ксилолды қолданбаңыз. Ксилолды алмастырыштарды немесе парафинді кетіргіштерді қолданыңыз.
- Кассеталық қысқыш ([→ "101-сур. - 1"](#)) сұйықтық парафині шыққанша максимум 65°C дейін қыздырылған пешке де орналастырылуы мүмкін.
- Парафин қалдықтарын құрғақ шүберекпен алып тастаңыз.
- Тұмшапеште осындай тазарту процедурасынан кейін, әрқашан кернеу тұтқасының ([→ "101-сур. - 3"](#)) спиральды серіппелерін ([→ "101-сур. - 2"](#)) майлауды ұмытпаңыз. Кассетаны қысқышты құралға қайта орнатпас бұрын сұтып алыңыз.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

8.2.1 Сақтандырыштарды аудиостыру



Сақ болыңыз

Сақтандырыштарды құралды өшірмей аудиостыру және қуат ашасын ажырату.

Адамдардың жарақат алуына әкелетін электр тогының соғуы.

- Сақтандырыштарды аудиостырмас бұрын құралды қуат қосқышының көмегімен өшіріп, ашаны желіден ажыратыңыз.



Абайлаңыз

Пайдалану нұсқаулығындағы Техникалық мәліметтер бөлімінде анықталған сипаттамасы жоқ сақтандырыштарды қолдану.

Диагностика кідірісі, себебі құрал қате сақтандырыштармен жұмыс істемейді.

- Пайдалану нұсқаулығындағы Техникалық мәліметтер бөлімінде анықталған сипаттамадағы сақтандырыштарды ғана қолданыңыз.



102-сур.

- Кішкене бұрағышты ұяшыққа ([→ "102-сур. - 3"](#)) салыңыз да, кірістіруді абайлап шығарыңыз.
- Сақтандырыштармен ([→ "102-сур. - 4"](#)) бірге кернеу селекторының корпусын ([→ "102-сур. - 2"](#)) алыңыз.
- Сақтандырыштарды алыңыз. Бұл кезде кернеу селекторының қосқыш блогын ([→ "102-сур. - 5"](#)) корпуста қалдырыңыз.
- Ақаулы сақтандырыштарды аудиостырыңыз және кернеу селекторын құралға қайта орнатыңыз.
- Көрү терезесінде ([→ "102-сур. - 1"](#)) кернеудің дұрыс мәні көрсетілгенін тексеріңіз.

8.3 Техникалық қызмет көрсету нұсқаулары



Кеңестер

Құралдың ішкі құрамдастарына қызмет көрсету және оларды жөндеу үшін тек уәкілетті және білікті қызмет көрсетуші қызметкерлер қатынаса алады.

Құрал негізінен техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Құралдың ұзақ уақыт бойы ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін Leica Biosystems компаниясы төмендегілерді ұсынады:

1. Құралды күн сайын мұқият тазалаңыз.
2. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін қызмет көрсету туралы келісімшарт жасаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін жергілікті Leica Biosystems техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
3. Құралды Leica Biosystems өкілеттігі бар білікті қызмет көрсетуші технигі жүйелі түрде тексеріп тұрын. Арапықтар құралдың қаншалықты қолданылатынына байланысты.

Кестеде көрсетілген екі санатта анықталған құралдың жалпы жүктемесіне байланысты келесі тексеру аралықтарын ұсынамыз:

I санат	II санат
Күн сайынғы бөлімдер саны: Күніне > 8000 бөлім	Күніне < 8000 бөлім
Жұмыс көлемі (тәулігіне сағат): Күніне > 5 сағат	Күніне ≤ 5 сағат
Бөлу жылдамдығы: Жоғары бөлу жылдамдығы басым	Баяу және орташа бөлу жылдамдығы
Үлгі материалы: Жұмсақ және қатты үлгілермен жұмыс	Негізінен жұмсақ материал
Техникалық қызмет көрсету: Әр 12 ай сайын	Әр 24 ай сайын

Тексеру үшін ескерту

Құрал шам. 2 миллион соққыны орындағаннан кейін, SEr коды TRIM/SECT түймесі басылған кезде (кесу мен секция режимі арасында ауысу) үш таңбалы дисплейде әрқашан шам. 3 секундқа шығады.

Бұл құралды Leica Biosystems үәкілетті қызмет көрсету техникасы тексеруі керек екенін еске салады, бұл құралдың қаншалықты қолданылғанына қарамастан.



103-сур.

8.4 Құралды майлау

Айна бір рет келесі бөліктерді жетек бөлшектер майымен майлаңыз (1-2 тамшы жеткілікті).



Сақ болыңыз

Май төгілді және бірден тазартылмады.

Адамдардың ауыр жарақаттары, мысалы, сырғып кету және құралдың пышағы/жүзі сияқты қауіпті бөліктерге тиіп кету.

- Әрқашан май төгілмегеніне көз жеткізіңіз.
- Егер май төгілген болса, оны дереу, мұқият және толық тазалаңыз.

Құрал



104-сур.

- Микротомдық табақшадағы пышақ ұстағыш негізіне арналған бағыттаушы рельстер (\rightarrow "104-сур. - 1").
- Микротомды негізгі пластинадағы Т-бөлігі (\rightarrow "104-сур. - 2").


Екі функциясы бар “E” жүз ұстагыши



105-сүр.

- Бүйірлік ығысуға арналған қысқыш тұтқа (\rightarrow “105-сүр. - 1”).
- Пышақтың қысқыш тұтқасы (\rightarrow “105-сүр. - 2”).

Әмбебап кассета қысқышы

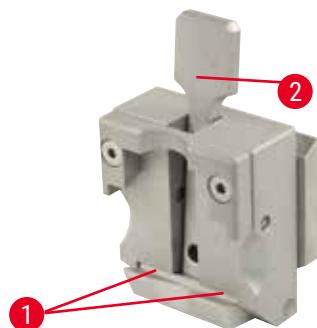

106-сүр.

Кернеу тұтқасының (\rightarrow “106-сүр. - 2”) спиральды серіппелерін (\rightarrow “106-сүр. - 1”) майлап, бірнеше рет алға-артқа жылжытыңыз.

9. Кепілдік және қызмет көрсету

9.1 Кепілдік

Leica Biosystems Nussloch GmbH жеткізілген келісімшарттық өнім Leica Biosystems компаниясының ішкі тестілеу стандарттарына негізделген сапаны бақылаудың кешенде процедурасынан өткенине және өнімнің ақаусыз екенине және кепілдік берілген барлық техникалық сипаттамаларға және/немесе келісілген сипаттамаларға сәйкес келетініне кепілдік береді.

Кепілдік көлемі жасалған келісімнің мазмұнына негізделген. Leica Biosystems сату үйімінің немесе келісімшарттық өнімді сатып алған үйімнің кепілдік шарттары бірегей түрде қолданылады.

9.2 Қызмет көрсету туралы ақпарат

Егер техникалық қолдау немесе қосалқы бөлшектер қажет болса, Leica Biosystems өкіліне немесе құралды сатып алған Leica Biosystems дилеріне хабарласыңыз.

Келесі ақпаратты ұсыну қажет:

- Құралдың атауы мен сериялық нөмірі.
- Құралдың орналасқан жері және байланысатын адамның аты-жөні.
- Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалудың себебі.
- Жеткізу күні.

9.3 Пайдаланудан шығару және жою

Құрал немесе оның бөліктері қолданыстағы жергілікті ережелерге сәйкес жойылуы керек.

10. Залалсыздандыруды растау

Leica Biosystems компаниясына қайтарылған немесе жергілікті жерде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін әрбір өнім тиісті түрде тазаланып, залалсыздандырылуы керек.

Залалсыздандыруды растаудың арнайы пішімді www.LeicaBiosystems.com веб-сайтынан өнім мәзірінде табуға болады. Бұл пішім барлық қажетті деректерді жинау үшін қолданылуы керек. Өнімді қайтару кезінде толтырылған және қол қойылған растаудың көшірмесі қоса берілуі немесе қызмет көрсетушіге тапсырылуы тиіс. Бұл растаусыз немесе толық расталмаған жағдайда кері қайтарылатын өнімдер үшін жауапкершілік жөнелтушіге жүктеледі. Кәсіпорынның ықтимал қауіп көзі болып саналатын қайтарылған тауарлар жіберушінің есебінен және тәуекелімен қайтарылады.

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
D-69226 Nussloch
Германия

Тел.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Факс: +49 - (0) 6224 - 143 268
Веб: www.LeicaBiosystems.com