

HistoCore BIOCUT

Rotacijski mikrotom

Upute za upotrebu

Hrvatski

Br. narudžbe: 14 0517 80124 – Prerađeno izdanje F

Priručnik uvijek čuvajte uz aparat.

Pažljivo ga pročitajte prije upotrebe aparata.

CE



Informacije, brojčani podaci, napomene i procjene vrijednosti iz priručnika predstavljaju informacije utemeljene na trenutačnim znanstvenim spoznajama i najnaprednijoj tehnologiji, na način na koji ih mi vidimo putem istraživanja u tom polju.

Nismo obvezni redovno ažurirati ovaj priručnik sukladno najnovijim spoznajama u skladu s tehnološkim napretkom niti klijentima osigurati dodatne kopije, ažuriranja ili slično za ovaj priručnik.

U najvećem dopuštenom obimu sukladno nacionalnom zakonodavstvu primjenjivom u svakom pojedinačnom slučaju nismo odgovorni za pogrešne izjave, crteže, ilustracije i slično iz ovog priručnika. Posebice i ni u kojem slučaju ne snosimo odgovornost za finansijske gubitke ili posljedične štete nastale zbog ili vezano uz usklađenost s izjavama ili drugim informacijama iz ovog priručnika.

Izjave, crteži, ilustracije i druge informacije vezane uz sadržaj ili tehničke pojedinosti ovih uputa za upotrebu ne smatraju se zajamčenom značajkom naših proizvoda.

Zajamčene se značajke utvrđuju isključivo putem ugovornih odredbi dogovorenih između nas i naših klijenata.

Leica zadržava pravo izmjene tehničkih specifikacija i proizvodnih procesa bez prethodne obavijesti. To je jedini način za neprekidno poboljšanje tehnologija i tehnika proizvodnji koje rabimo za svoje proizvode.

Ovaj je dokument zaštićen autorskim pravima. Nositelj svih autorskih prava za ovaj dokument je tvrtka Leica Biosystems Nussloch GmbH. Za svaku reprodukciju teksta i ilustracija (ili bilo kojeg njihovog dijela) putem ispisa, fotokopija, mikrofisa, web-kamere ili drugih metoda – uključujući sve elektroničke sustave i medije – potrebno je izričito prethodno pisano dopuštenje tvrtke Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Serijski broj i godinu proizvodnje aparata pogledajte na nazivnoj pločici na poleđini aparata.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Njemačka

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Faks: +49 - (0) 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com

Sklapanje ugovoreno s tvrtkom Leica Microsystems Ltd. Shanghai

Sadržaj

1.	Važne informacije	7
1.1	Simboli upotrijebljeni u tekstu i njihovo značenje	7
1.2	Vrsta aparata	9
1.3	Namjena.....	9
1.4	Kvalifikacije osoblja	9
2.	Sigurnost	10
2.1	Sigurnosne napomene	10
2.2	Upozorenja	10
2.2.1	Oznake na samom aparatu	10
2.2.2	Transport i instalacija	11
2.2.3	Upravljanje aparatom.....	12
2.2.4	Čišćenje i održavanje	16
2.3	Ugrađeni zaštitni uređaji	17
2.3.1	Zabravljinjanje ručnog kotača.....	18
2.3.2	Sigurnosni štitnik na držaču noža/oštice	19
3.	Sastavni dijelovi i specifikacije aparata	20
3.1	Pregled – sastavni dijelovi aparata	20
3.2	Specifikacije aparata.....	21
3.3	Tehnički podaci.....	22
4.	Postavljanje aparata.....	24
4.1	Zahtjevi na mjestu ugradnje.....	24
4.2	Uobičajeni obim isporuke – dostavnica	24
4.3	Raspakiravanje i ugradnja	25
4.4	Sastavljanje ručnog kotača	29
5.	Rad.....	30
5.1	Radni elementi i njihove funkcije.....	30
5.1.1	Postavljanje debljine nareska	30
5.1.2	Kotač grubog umetanja	30
5.1.3	Retrakcija uzorka	31
5.1.4	Funkcija mehaničkog podrezivanja.....	31
5.1.5	Precizno usmjeravanje pričvršćenja držača uzorka.....	32
5.1.6	Precizno namještanje ravnoteže sile	33
5.2	Umetanje držača oštice dva u jednom E	35
5.2.1	Postavljanje podnožja držača oštice	35
5.2.2	Umetanje držača oštice dva u jednom E	35
5.3	Namještanje kutnog zazora	36
5.4	Umetanje univerzalne kasetne stezaljke.....	36
5.5	Stezanje uzorka	37

5.6	Stezanje noža/jednokratne oštice.....	37
5.7	Obrezivanje uzorka	40
5.8	Sekcioniranje.....	40
5.9	Zamjena uzorka ili prekid sekcioniranja	42
5.10	Završavanje dnevne rutine	43
6.	Dodatni pribor.....	44
6.1	Sklop za pričvršćenje stezaljki uzorka	44
6.1.1	Kruto pričvršćenje stezaljke uzorka.....	44
6.1.2	Pričvršćenje stezaljke uzorka s usmjeravanjem.....	44
6.1.3	Pričvršćenje stezaljki uzorka s preciznim usmjeravanjem	45
6.1.4	Brostezni sustav.....	46
6.2	Stezaljke uzorka i držači.....	46
6.2.1	Standardna stezaljka uzorka.....	46
6.2.2	Univerzalna kasetna stezaljka	47
6.2.3	Super velika kasetna stezaljka	48
6.3	Podnožje držača noža i držač noža.....	49
6.3.1	Držač oštice dva u jednom E	49
6.3.2	Postolje držača noža bez značajke bočnog pomicanja	50
6.3.3	Držač noža E s koritom za vodu za niskoprofilne oštice	51
6.3.4	Držač noža N.....	51
6.4	Ladica za otpad pri sekcioniranju.....	53
6.5	Pozadinsko osvjetljenje	54
6.6	Gornja ladica	54
6.7	Univerzalni nosač mikroskopa	55
6.8	Povećalo, LED-osvjetljenje	57
6.9	Dodatni pribor	59
6.10	Informacije o naručivanju	67
7.	Uklanjanje pogrešaka	69
7.1	Moguće pogreške	69
7.2	Neispravnosti aparata.....	70
7.3	Neispravnosti držača oštice dva u jednom E	71
7.3.1	Zamjena potisne ploče.....	71
7.3.2	Postavljanje steznog vrha na luk segmenta	72
7.4	Postavljanje zateznog sustava nosača stezaljke na podnožju	72
8.	Čišćenje i održavanje.....	73
8.1	Čišćenje aparata	73
8.2	Upute za održavanje	76
8.3	Podmazivanje aparata	77

Sadržaj

9.	Jamstvo i servis	79
9.1	Jamstvo	79
9.2	Servisne informacije	79
9.3	Povlačenje iz uporabe i zbrinjavanje	79
10.	Potvrda o dekontaminaciji	80

1. Važne informacije

1.1 Simboli upotrijebljeni u tekstu i njihovo značenje



Opasnost:

označava neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, izazvati smrt ili tešku ozljedu.



Upozorenje:

ako se takva opasnost ne izbjegne, može doći do smrti ili teške ozljede.



Oprez:

označava potencijalnu opasnost koja bi, ako se ne izbjegne, mogla izazvati smrt ili tešku ozljedu.



Napomena:

označava situaciju moguće opasnosti za oštećenje imovine koja bi, ako se izbjegne, mogla izazvati oštećenje aparata ili predmeta u njegovoj blizini.



Savjet:

daje savjete za pojednostavljivanje tijeka rada.

1

Brojevi stavke za numeriranje ilustracija.

→ "Sl. 7 – 1"

Brojevi napisani crveno odnose se na broj stavke na ilustracijama.



Proizvođač



Broj narudžbe



Serijski broj



Datum proizvodnje



Pridržavajte se uputa za upotrebu.



Oprez, informacije o mjerama opreza potražite u uputama.



Medicinski uređaj za In vitro dijagnostiku (IVD)



Proizvod ispunjava zahtjeve direktiva EU.



Sadržaj pakiranja je lomljiv i njime se treba oprezno rukovati.



Pakiranje treba držati na suhom.




Slaganje u najviše 3 komada na hrpi



Označava da je pravilan položaj pakiranja uspravni položaj.

Transport temperature range:




Označava dopušten raspon temperature za transport pakiranja.

Minimalno -29 °C

Maksimalno +50 °C


Storage temperature range:



Označava dopušten raspon temperature za skladištenje pakiranja.

Minimalno +5 °C

Maksimalno +50 °C



Označava dopušten raspon vlage za skladištenje i transport pakiranja.

minimalno 10 % relativne vlažnosti

maksimalno 85 % relativne vlažnosti



U sustavu Shockwatch, točkice jačine udarca prikazuju u crvenoj boji udarce ili udarce jače od zadatog intenziteta. Prekoračenje zadatog ubrzanja (vrijednost g) uzrokuje promjenu boje indikatorske cijevi.



Indikator prevrtanja za nadzor je li se pošiljka transportirala i skladištila u uspravnom položaju sukladno zahtjevima. Pod kutom od 60° ili više plavi kvarcni pjesak prelijeva se u indikatorički prozorčić u obliku strelice i tamo ostaje. Nepravilno se rukovanje pošiljkom odmah uočava i može se jasno dokazati.



Označava stavku koja se može reciklirati ako postoji za to predviđena lokacija.

1.2 Vrsta aparata

Sve informacije u ovim uputama za upotrebu odnose se samo na vrstu aparata navedenu na naslovnoj stranici. Na nazivnoj pločici pričvršćenoj na poleđini aparata naveden je serijski broj aparata.

1.3 Namjena

HistoCore BIOCUT rotacijski je mikrotom s ručnim upravljanjem posebno namijenjen za stvaranje tankih narezaka uzoraka ljudskog tkiva različite tvrdoće za histološku dijagnozu, primjerice dijagnozu raka.

Namijenjen je za sekcioniranje mekih i tvrdih uzoraka ljudskog tkiva, sve dok su prikladni za ručno rezanje.



Upozorenje

Svi ostali načini upotrebe osim namjenske.

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje uzorka.

- Slijedite upute za namjensku upotrebu opisane u uputama za upotrebu. Svaka se druga upotreba aparata smatra neprikladnom.

1.4 Kvalifikacije osoblja

- Aparatom HistoCore BIOCUT smije rukovati isključivo ospozobljeno laboratorijsko osoblje.
- Cjelokupno laboratorijsko osoblje koje će rukovati ovim uređajem treba pažljivo pročitati ove upute za upotrebu i mora biti upoznato sa svim tehničkim značajkama aparata prije nego što pokuša njime rukovati.

2. Sigurnost

2.1 Sigurnosne napomene

Upute za upotrebu uključuju važne informacije vezane za sigurno rukovanje i odražavanje aparata.

Upute za upotrebu važan su sastavni dio proizvoda i morate ih pažljivo pročitati prije pokretanja i upotrebe te ih uvijek morate držati u blizini aparata.

Ovaj je aparat napravljen i ispitana prema sigurnosnim zahtjevima za laboratorijske instrumente.

Korisnik se mora pridržavati svih napomena i upozorenja u ovim uputama za upotrebu radi održavanja takvog stanja i osiguravanja sigurnog rada.

Uvijek se morate pridržavati napomena za sigurnost i oprez u ovom poglavlju.

Obavezno pročitajte ove upute, čak i ako ste upoznati s radom i uporabom drugih proizvoda marke Leica Biosystem.

Te upute za upotrebu moraju se na odgovarajući način dopuniti postojećim važećim propisima za sprječavanje nesreća i zaštitu okoliša države u kojoj se upotrebljava.



Upozorenje

Zaštitni uređaji ili sigurnosna dodatna oprema koju proizvođač isporučuje uklonjeni su ili izmijenjeni.

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine uključujući i oštećenje uzorka.

- Nikada nemojte uklanjati ili izmjenjivati bilo koji zaštitni uređaj aparata ili dodatnu opremu. Popravak aparata i pristup njegovim unutarnjim sastavnim dijelovima dopušten je isključivo servisnom osoblju koje je završilo obuku tvrtke Leica Biosystem.
- Prije rada s aparatom uvijek provjerite jesu li svi zaštitni uređaji i sigurnosna oprema na svom mjestu i ispunjavaju li pravilno svoju namjenu.



Savjet

Trenutačno važeća CE izjava o sukladnosti nalazi se na mreži:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

2.2 Upozorenja

Zaštitni uređaji koje je proizvođač ugradio u aparat služe isključivo za prevenciju nezgoda. Sigurno upravljanje aparatom prije svega je odgovornost vlasnika kao i svih osoba koje su određene za upravljanje, servisiranje ili čišćenje aparata.

Za osiguranje rada aparata bez poteškoća potrebno je pridržavati se sljedećih uputa i upozorenja.

2.2.1 Oznake na samom aparu



Upozorenje

Nepoštivanje ispravnih uputa za rukovanje uređajem (navedenih u ovom priručniku), povezanih s odgovarajućim oznakama i trokutima upozorenja istaknutima na aparu..

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje aparata, dodatne opreme ili uzorka.

- Obratite pozornost na oznake na aparu i strogo se pridržavajte uputa za rad opisanih u priručniku za upotrebu kada radite s označenom stavkom ili je zamjenjujete.

2.2.2 Transport i instalacija



Upozorenje

Dodatni pribor/aparat ispada iz pakiranja prilikom raspakiranja.

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine.

- Budite oprezni prilikom raspakiranja aparata.
- Nakon raspakiranja aparat se mora postaviti u uspravan položaj.
- U potpunosti pratite upute navedene u uputama za raspakiranje pričvršćene s vanjske strane pakiranja ili radnje opisane u uputama za upotrebu.



Upozorenje

Aparat nije podignut na pravilan način.

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine.

- Prilikom podizanja aparata uhvatite ga isključivo za podizne točke opisane u uputama za upotrebu i uputama za raspakiranje (podnožje na prednjem dijelu i ispod aparata na stražnjem dijelu).
- Aparat nikada nemojte podizati držeći za dršku ručnog kotača, kotačić za grubo umetanje, vrh predmeta ili kotačić za postavljanje deblijine nareska.
- Uvijek uklonite ladicu za otpad pri sekcioniranju prije transportiranja aparat.



Upozorenje

Nepažljivo pomicanje aparata.

Ozbiljne ozljede ruku i/ili prstiju zbog prgnjećenja između aparata i radne površine.

- Prilikom pomicanja aparata uhvatite ga isključivo za podizne točke opisane u uputama za upotrebu i uputama za raspakiranje (podnožje na prednjem dijelu i ispod aparata na stražnjem dijelu).
- Pazite da ruke i prsti nisu između aparata i radne površine.



Upozorenje

Aparat nije sigurno postavljen sa sve 4 nožice na odgovarajućem laboratorijskom stolu.

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine.

- Aparat stavljajte jedino na stabilan laboratorijski stol bez vibracija s vodoravnim i ravnom površinom stola. Tlo mora biti bez vibracija koliko god je to moguće.
- Uvijek provjerite jesu li sve 4 nožice potpuno postavljene na laboratorijski stol.
- Ako aparat pomiču druge osobe (primjerice radi servisiranja), uvijek provjerite ispravno postavljanje.



Upozorenje

Držać noža/oštice ispada s aparata.

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine.

- Ako držać noža/oštice nije pričvršćen, prilikom postavljanja ili čišćenja, posebno pazite na to da držać oštice ne ispada.
- Kada god je moguće, pričvrstite držać noža/oštice da biste izbjegli ispadanje.

2 Sigurnost



Upozorenje

Ladica za otpad pri sekcioniranju pada nakon odvajanja.

Ozljede ljudi.

- Posebno pažljivo radite kada odvajate ladicu za otpad pri sekcioniranju i stavite je na sigurno.



Upozorenje

Ulje se proljava i ne čisti se odmah.

Ozbiljne ozljede ljudi, primjerice zbog prolijevanja i doticaja s opasnim dijelovima kao što su nož/oštrica aparata.

- Uvijek pazite da se ulje ne proljava.
- Ako se ulje prolije, odmah ga očistite, u potpunosti i do kraja.



Upozorenje

Otpad parafina pada na pod i nečisti se.

Ozbiljne ozljede ljudi, primjerice zbog zapinjanja i spoticanja o nož/oštricu.

- Uvijek očistite parafinski otpad prije no što se proširi, postane klizav i opasan.
- Nosite odgovarajuću obuću.



Oprez

Otpuštanje/oštećenje pribora/sastavnih dijelova tijekom transporta.

Oštećenje opreme ili odgađanje postavljanja dijagnoze.

- Na ambalaži se nalaze dva indikatora, ShockDot Impact Indicator (indikator udara) i Tilt Indicator (indikator nagiba), koji upućuju na neprimjerene uvjete transportiranja. Odmah provjerite stanje ovih indikatora čim aparat bude isporučen. Bude li ijedan od navedenih indikatora aktiviran, pošiljkom se nije rukovalo u skladu s pravilima. U ovom slučaju, molimo Vas da dokumentaciju o pošiljci ispunite u skladu s prisutnim okolnostima i provjerite je li pošiljka oštećena.

2.2.3 Upravljanje aparatom



Opasnost

Opasnost od eksplozije.

Smrt ili ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine.

- Nikada nemojte rukovati aparatom u prostorijama gdje postoji opasnost od eksplozije.



Upozorenje

Osoblje nedovoljnih kvalifikacija radi s aparatom.

Može doći do ozbiljnih ozljeda ljudi i/ili oštećenja uzorka kada se uzorak približi nožu/oštrici zbog neodgovarajućeg djelovanja osobe koja rukuje aparatom, na primjer zato što glava predmeta može pasti na držać noža kada se ručni kotač otpusti.

- Uvijek pazite da jedino kvalificirano laboratorijsko osoblje koje je završilo posebnu i dovoljnu obuku rukuje aparatom.
- Uvijek pazite da je cjelokupno laboratorijsko osoblje koje će rukovati ovim uređajem pažljivo pročitalo ove upute za upotrebu i da je upoznato sa svim tehničkim značajkama aparata prije nego što pokuša njime rukovati.



Upozorenje

Zaštitni uređaji ili sigurnosna dodatna oprema koju proizvođač isporučuje uklonjeni su ili izmijenjeni.

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine uključujući i oštećenje uzorka.

- Nikada nemojte uklanjati ili izmjenjivati bilo koji zaštitni uređaj aparata ili dodatnu opremu. Popravak aparata i pristup njegovim unutarnjim sastavnim dijelovima dopušten je isključivo servisnom osoblju koje je završilo obuku tvrtke Leica Biosystem.
- Prije rada s aparatom uvijek provjerite jesu li svi zaštitni uređaji i sigurnosna oprema na svom mjestu i ispunjavaju li pravilno svoju namjenu.



Upozorenje

Ne upotrebljava se osobna zaštitna oprema.

Ozljede ljudi.

- Uvijek se morate pridržavati sigurnosnih mjera opreza prilikom rada s mikrotomima. Obavezno morate nositi zaštitnu radnu obuću, zaštitne rukavice, masku i zaštitne naočale.



Upozorenje

Noževima ili oštricama rukuje se i/ili se odlažu na neodgovarajući način.

Ozbiljne ozljede ljudi zbog doticaja s iznimno oštrim nožem/oštricom.

- Radite posebno temeljito i oprezno kada rukujete nožem/oštricom.
- Uvijek nosite namjensku odjeću (uključujući rukavice otporne na rezove) kada rukujete nožem/oštricom.
- Noževe i oštice uvijek odlažite na sigurno mjesto (primjerice, posebnu kutiju za noževe) i na odgovarajući način kojim se osigurava da neće doći do ozljeda ljudi.
- Nož nikada nemojte postavljati s reznom oštricom okrenutom prema gore i nikada nemojte pokušati uhvatiti nož u padu!
- Uvijek zategnite uzorak PRIJE postavljanja i stezanja noža/oštice.



Upozorenje

Nož/oštrica nije skinut kada je držač noža/oštice skinut s mikrotoma.

Ozbiljne ozljede ljudi zbog doticaja s iznimno oštrim nožem/oštricom.

- Prije skidanja držača noža/oštice s mikrotoma, nož/oštricu uvijek odvojite dok nosite rukavice otporne na rezove i nož/oštricu odložite na sigurno mjesto.



Upozorenje

Osoba koja rukuje aparatom hvata nož/oštricu zbog neodgovarajućeg postupka rada.

Ozbiljne ozljede ljudi prilikom postavljanja uzorka ako je nož/oštrica prethodno postavljen.

- Prije umetanja uzorka u mikrotom provjerite da rezna oštica nije prekrivena sigurnosnim štitnikom i je li uključen mehanizam za zatravljenje ručnog kotača. Kada je osoba koja rukuje aparatom učitala uzorak i umetnula nož/oštricu, blok uzorka uvijek umetnute prije postavljanja i stezanja noža/oštice.



Upozorenje

Osoba koja rukuje aparatom postavlja dva noža/oštice na držač noža/oštice.

Ozbiljne ozljede ljudi zbog doticaja s iznimno oštim noževima i/ili ošticama.

- Nemojte stezati dva noža/oštice na držač noža/držač oštice. Postavite nož/oštricu u središte držača noža/oštice. Noževi/oštice ne smiju prelaziti rub držača noža/oštice.

2 Sigurnost



Upozorenje

Nož/oštrica postavljen je prije no što su držač noža/oštice i postolje držača noža/oštice postavljeni na aparat.

Ozbiljne ozljede ljudi zbog doticaja s iznimno oštrim noževima i/ili ošticama.

- Prije umetanja noža/oštice, držač noža/oštice i postolje držača noža/oštice moraju se postaviti na mikrotom.



Upozorenje

Nož/oštrica nije prekriven odgovarajućim štitnikom kada se uzorak ne sekcionira.

Ozbiljne ozljede ljudi.

- Uvijek prekrijte rub noža/oštice odgovarajućim štitnikom noža prije rukovanja nožem/oštricom ili stezaljkom uzorka, prije zamjene sklopa uzorka i tijekom prekida u radu.



Upozorenje

Nož/oštrica spremlijen je na neodgovarajući način.

Ozbiljne ozljede ljudi, primjerice zbog neočekivanog pada.

- Nož/oštricu uvijek odlažite na sigurno mjesto kada ga ne upotrebljavate: odložite ga, na primjer, u posebnu kutiju za noževe.
- Nož nikada nemojte postavljati s reznom oštricom okrenutom prema gore i nikada nemojte pokušati uhvatiti nož u padu.



Upozorenje

Umetanje ili vađenje uzorka iz mikrotoma bez odgovarajuće odjeće i na neodgovarajući način.

Osoba koja rukuje aparatom može se porezati i ozlijediti što može imati ozbiljne posljedice.

- Uvijek upotrebljavajte rukavice otporne na rezove kada rukujete uzorkom u mikrotomu.
- Zabratite ručni kotač i prekrijte oštricu noža sigurnosnim štitnikom prije svakog rukovanja stezaljkom uzorka i prije zamjene uzorka.



Upozorenje

Uzorak je orijentiran u fazi retrakcije.

Oštećenje uzorka zbog ponovne orientacije uzorka u fazi retrakcije.

- Blokovi uzorka ne smiju se orijentirati tijekom faze retrakcije. Ako se blok orientira tijekom retrakcije, blok će se pomaknuti za vrijednost retrakcije plus debljinu odabranog nareska prije sljedećeg sekcioniranja. To može prouzročiti oštećenje uzorka i noža/oštice.



Upozorenje

Rad s aparatom i lomljivim uzorkom bez odgovarajuće zaštitne odjeće.

Ozbiljne ozljede ljudi uzrokovane krhotinama prilikom rezanja lomljivog uzorka.

- Uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću (uključujući zaštitne naočale) i posebno pažljivo radite kada rezete lomljivi uzorak.



Upozorenje

Nepravilno precizno namještanje ravnoteže sile.

Ozbiljna ozljeda osobe koja rukuje aparatom zbog doticaja s nožem i/ili oštećenje uzorka.

- Prije rada s aparatom, uvijek ponovno provjerite je li precizno namještanje ravnoteže sile pravilno postavljeno.
- Ako precizno namještanje nije pravilno postavljeno, nemojte raditi s aparatom, već obavite ponovno namještanje. Više pojedinosti potražite u poglavljju "Precizno namještanje ravnoteže sile".
- Osobito nakon zamjene dodatnog pribora na glavi predmeta odmah obavite precizno namještanje ravnoteže sile.



Upozorenje

Nedovoljni uvjeti okvira za sekcioniranje.

Oštećenje uzorka ili loši rezultati sekcioniranja, na primjer rezovi promjenjive debeline, sabijeni, preklopjeni ili ogoljeni rezovi.

- Nemojte nastaviti sa sekcioniranjem ako utvrdite nezadovoljavajuće rezultate sekcioniranja.
- Provjerite jesu li ispunjeni svi preduvjeti za odgovarajuće sekcioniranje. Dodatne pojedinosti potražite u dijelu o uklanjanju pogrešaka ovih uputa za upotrebu.
- Ako nemate dovoljno znanja o rješavanju pogreške nedovoljnih rezultata sekcioniranja, обратите se osobama koje to znaju, na primjer stručnjacima tvrtke Leica Biosystems.



Upozorenje

Smjer okretanja kotača grubog umetanja nepravilno je odabran.

Oštećenje uzorka.

- Uvijek provjerite jeste li odabrali točan smjer okretanja kotača grubog umetanja tako da provjerite postavku smjera kotača grubog umetanja na poleđini aparata.



Upozorenje

Okretanje ručnog kotača u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

Ozljede ljudi/oštećenje uzorka.

- Ručni kotač nemojte okretati u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu što može dovesti do neispravnosti mehanizma za zabravljenje ručnog kotača.



Upozorenje

Ručni je kotač odbravljen i glava predmeta pada u držać noža/oštice.

Ozljede ljudi/oštećenje uzorka.

- Ručni kotač uvijek mora biti zabravljen osim u fazi sekcioniranja.



Upozorenje

Brzina okretanja ručnog kotača ne odgovara tvrdoći uzorka.

Oštećenje aparata i moguće oštećenje uzorka.

- Brzina okretanja ručnog kotača mora se prilagoditi tako da odgovara tvrdoći uzorka. Sporije brzine upotrebljavajte za tvrde uzorke.



Upozorenje

Ručica kočnice ručnog kotača nepravilno se upotrebljava i ručni kotač nije moguće zakočiti.

Ozbiljne ozljede aparata/ljudi ili oštećenje imovine.

- Ručica kočnice ručnog kotača mora se nalaziti točno u zabravljenom položaju. Ako se ručica kočnice ručnog kotača pomakne preko te točke, može se dogoditi da se ručni kotač više ne koči.

2 Sigurnost



Upozorenje

Prsti umetnuti između uzorka i noža/oštice nakon otpuštanja ručnog kotača prilikom obavljanja brzog ručnog podrezivanja.

Osoba koja rukuje aparatom može se porezati i ozlijediti zbog okretanja ručnog kotača kada nije zabravljen.

- Nemojte stavljati prste između uzorka i noža/oštice tijekom podrezivanja i sekcioniranja.



Oprez

Nakon što se držač oštice/noža bočno pomakne, uzorak nije povučen ni ponovno podrezan.

Oštećenje uzorka.

- Povucite glavu predmeta i ponovno podrežite sklop uzorka svaki puta nakon bočnog pomicanja držača oštice/noža.



Oprez

Istovremeno okretanje ručnog kotača i kotača grubog umetanja.

Oštećenje uzorka.

- Nemojte okretati kotač grubog umetanja dok okrećete ručni kotač.



Oprez

Spojni je klin izgubljen prilikom postavljanja ručnog kotača.

Aparat se ne može upotrebljavati i to može prouzročiti kašnjenje kod postavljanja dijagnoze.

- Prije sastavljanja ručnog kotača provjerite spojni klin i provjerite je li u osovini ručnog kotača.



Napomena

Pribor i dijelovi uređaja će korodirati ako se na njega nanose korozivni/jako kiseli/alkalni reagensi ili otapala kao što su kisele dekalcificirane otopine, alkalni amonijev hidroksid, itd.

Pribor zbog toga može neispravno raditi.

- Ne dopustite da korozivni/jako kiseli/alkalni reagens ili otapalo kaplje po instrumentu ili po priboru.
- Ako takav reagens ili otapalo kane po instrumentu ili po priboru, obrišite ga i posušite što je prije moguće.
- Ako se takav reagens ili otapalo često koristi, obavezno svakodnevno temeljito očistite držač oštice, univerzalnu kasetnu stezaljku (UCC) i ostali pribor ako je potrebno.

2.2.4 Čišćenje i održavanje



Upozorenje

Tekućine ulaze u unutrašnjost aparata.

Ozbiljne ozljede aparata/ljudi.

- Provjerite da tekućine ne ulaze u unutrašnjost aparata prilikom rada i održavanja.



Upozorenje

Brisanje noža u netočnom smjeru prilikom čišćenja.

Ozbiljne ozljede ljudi.

- Nož uvijek brišite od stražnjeg dijela noža prema reznoj oštrici.



Upozorenje

Tijekom čišćenja držača noža/oštice dijelove izvadite iz komore za sušenje (65 °C).

Opasnost od opehotina.

- Nosite rukavice za zaštitu od topline prilikom vađenja dijelova iz komore za sušenje (65 °C).



Oprez

Upotreba neodgovarajućih otapala ili sredstava za čišćenje ili oštih/tvrđih predmeta za čišćenje aparata ili dodatnog pribora.

Moguća neispravnost aparata ili kašnjenje kod postavljanja dijagnoze.

- Nemojte upotrebljavati otapala koja sadrže aceton ili ksilen za čišćenje aparata.
- U slučaju upotrebe sredstava za čišćenje, pridržavajte se sigurnosnih uputa proizvođača i laboratorijskih sigurnosnih odredbi.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštре ili tvrde predmete za grebanje površine aparata.
- Dodatni pribor nikada nemojte potapati ni u koje otapalo za čišćenje ili vodu.
- Čelične noževe čistite otapalima na bazi alkohola ili acetona.
- Za čišćenje i uklanjanje parafina nemojte upotrebljavati ksilen ili tekućine za čišćenje koje sadrže alkohol (na primjer sredstvo za čišćenje stakla).



Oprez

Tijekom čišćenja pomiješani su dijelovi držača oštice.

Loša kvaliteta reza.

- Nemojte miješati držače oštica prilikom čišćenja.

2.3 Ugrađeni zaštitni uređaji




Upozorenje

Zaštitni uređaji ili sigurnosna dodatna oprema koju proizvođač isporučuje uklonjeni su ili izmijenjeni.

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine uključujući i oštećenje uzorka.

- Nikada nemojte uklanjati ili izmjenjivati bilo koji zaštitni uređaj aparata ili dodatnu opremu. Popravak aparata i pristup njegovim unutarnjim sastavnim dijelovima dopušten je isključivo servisnom osoblju koje je završilo obuku tvrtke Leica Biosystem.
- Prije rada s aparatom uvijek provjerite jesu li svi zaštitni uređaji i sigurnosna oprema na svom mjestu i ispunjavaju li pravilno svoju namjenu.

2.3.1 Zabravljivanje ručnog kotača

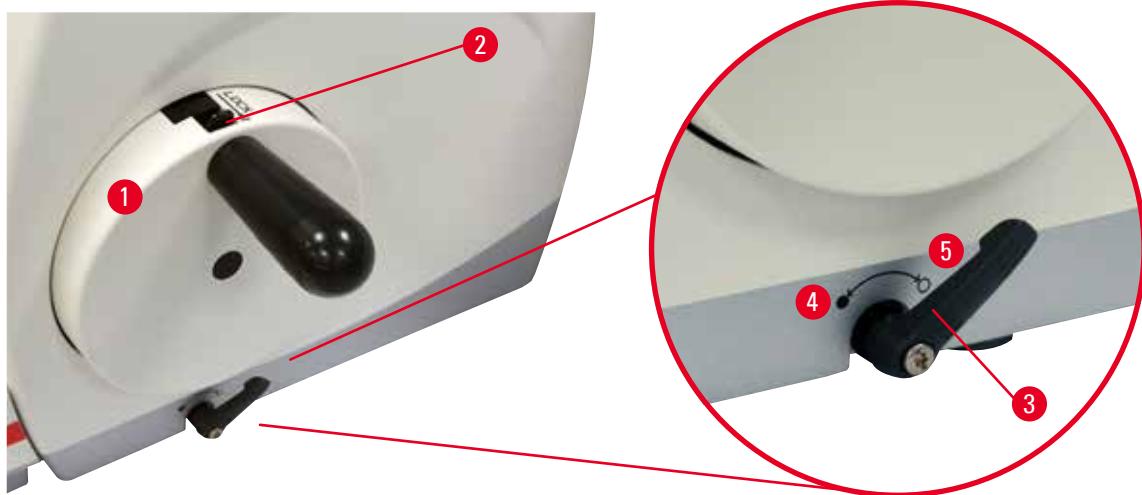

Sl. 1

Dva su načina zabravljivanja ručnog kotača (→ "Sl. 1-1"):

- Pomoću ručice kočnice ručnog kotača (→ "Sl. 1-3") na desnoj strani podnožja mikrotoma ručni se kotač može zakočiti u bilo kojem položaju.
 - Da biste zakočili, okrenite ručicu kočnice ručnog kotača u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu u položaj (→ "Sl. 1-4").



Upozorenje

Ručica kočnice ručnog kotača nepravilno se upotrebljava i ručni kotač nije moguće zakočiti.

Ozbiljne ozljede aparata/ljudi ili oštećenje imovine.

- Ručica kočnice ručnog kotača mora se nalaziti točno u zabravljenom položaju. Ako se ručica kočnice ručnog kotača pomakne preko te točke, može se dogoditi da se ručni kotač više ne koči.
 - Da biste odbravili ručni kotač, vratite ručicu kočnice ručnog kotača (→ "Sl. 1-3") u njezin početni položaj (→ "Sl. 1-5").
- Pomoću mehanizma za zabravljenje ručnog kotača (→ "Sl. 1-2") na vrhu ručnog kotača, on se može zakočiti u gornjem položaju (12 sati).
 - Da biste zabravili ručni kotač, pritisnite mehanizam za zabravljenje ručnog kotača (→ "Sl. 1-2") prema van i nastavite polako okretati ručni kotač u smjeru kazaljke na satu dok se ne zabravi točno u gornjem položaju (12 sati).
 - Da biste odbravili ručni kotač, okrenite mehanizam za zabravljenje ručnog kotača (→ "Sl. 1-2") prema unutra.




Savjet

Kada istovremeno upotrebljavate oba kočiona sustava, ručicu kočnice ručnog kotača (→ "Sl. 1-3") uvijek najprije pomaknite u položaj (→ "Sl. 1-5"). U protivnom, možda se neće moći otpustiti mehanizam za zabravljenje ručnog kotača (→ "Sl. 1-2").

2.3.2 Sigurnosni štitnik na držaču noža/oštice

Svaki je držač noža opremljen čvrsto postavljenom sigurnosnim štitnikom (→ "Sl. 2-1") (→ "Sl. 3-1"). Tako se omogućava potpuno prekrivanje rezne oštice u svim položajima noža ili oštice.

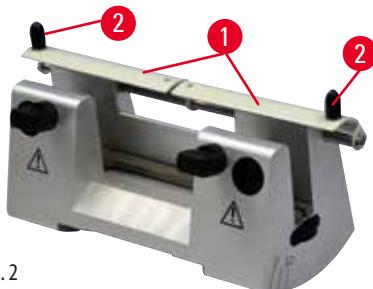

Sl. 2

Držač noža N

Sigurnosni štitnik (→ "Sl. 2-1") držača noža N može se jednostavno postaviti preko dvije ručice (→ "Sl. 2-2"). Da biste prekrili rub noža, gurnite obje prekrivne trake sigurnosnog štitnika u središte.



Sl. 3

Držač oštice dva u jednom E za visoko i niskoprofilne oštice

Sigurnosni štitnik na držaču oštice dva u jednom E sastoji se od crvene sklopive ručice (→ "Sl. 3-1"). Da biste prekrili reznu oštricu, preklopite sigurnosni štitnik ručice prema gore kao što je prikazano u (→ "Sl. 3").




Savjet

Stezne polugice na držaču oštice dva u jednom E ne mogu se međusobno zamjenjivati. Dvije stezne polugice (→ "Sl. 3-2") (→ "Sl. 3-3") cijelo vrijeme moraju ostati u prikazanom položaju jer u protivnom može doći do izoliranih neispravnosti držača oštice dva u jednom E. Stezna polugica za oštricu (→ "Sl. 3-2") nalazi se s desne strane, a ona za bočno pomicanje (→ "Sl. 3-3") s lijeve strane.

3 Sastavni dijelovi i specifikacije aparata


3. Sastavni dijelovi i specifikacije aparata

3.1 Pregled – sastavni dijelovi aparata

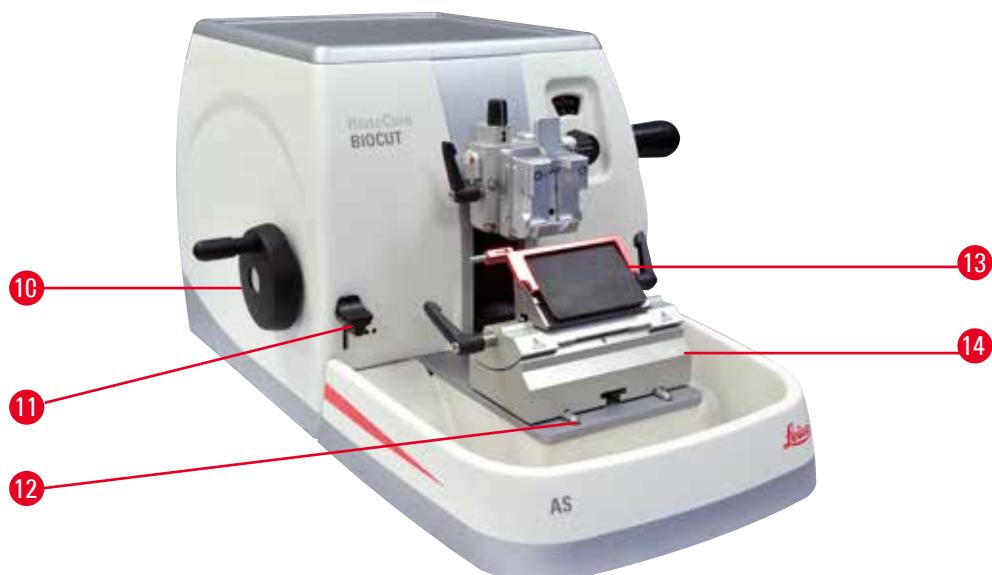

Sl. 4

- | | |
|---|--|
| 1 Gornja ladica | 8 Ručica kočnice ručnog kotača |
| 2 Glava predmeta s orientacijom i UCC | 9 Stezna polugica za podnožje držača noža/oštice |
| 3 Antistatička ladica za otpad pri sekcioniranju | 10 Kotač grubog umetanja |
| 4 Prozor za prikaz debljine reza | 11 Ručica za podrezivanje |
| 5 Mehanizam za zbravljenje ručnog kotača | 12 Podnožje mikrotoma |
| 6 Ručni kotač | 13 Držač oštice dva u jednom E |
| 7 Kotačić za namještanje za postavljanja debljine nareska | 14 Postolje držača oštice |

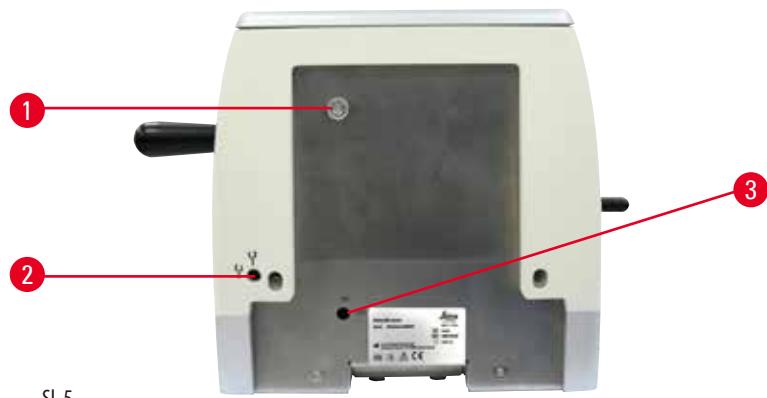Stražnji pogled

Sl. 5

1 Magnet

3 Prekidač retrakcije

2 Promjena smjera grubog umetanja

3.2 Specifikacije aparata

Osnovi aparat s mehaničkim podrezivanjem u 2 koraka, tihom retrakcijom s odabirom uključivanja/isključivanja, ergonomski postavljenim bočnim kotačem za grubo umetanje s jedinstvenim promjenama smjera koje bira korisnik, bez orientacije uzorka ili dodatne opreme.

- Ručni mehanički rotacijski mikrotom s niskom razinom održavanja i sustavom dovoda mikrometra bez povratnog hoda.
- Mehanizmi vodoravnog umetanja i okomitog hoda s poprečnim kugličnim ležajevima.
- Ručni kotač neometanog rada omogućuje dva ručna načina sekcioniranja: način rada s njihanjem i uobičajeno ručno sekcioniranje s punim okretanjem ručnog kotača.
- Dva samostalna sustava zatravljivanja ručnog kotača.
- Jedinstveni sustav ravnoteže sile koji namješta osobu koja rukuje aparatom s kompenzacijom sile opruge pruža dvije prednosti:
 1. Fleksibilnost prilagođavanja sile opruge različitim težinama uzorka/stezaljke, uklanjujući pri tom opasnost da glava predmeta padne na nož.
 2. Nije potreban težak protuteg na ručnom kotaču.
- Tih sustav retrakcije uzorka s funkcijom uključivanja/isključivanja.
- Ergonomski postavljen i jedinstveni kotač grubog umetanja koji se može prilagoditi pomoću smjera okretanja koji bira korisnik.
- Ergonomski postavljena ručica za mehaničko podrezivanje u 2 koraka za brzo podrezivanje sklopova pomoću unaprijed određenih koraka podrezivanja od 30 µm i 10 µm.
- Velika gornja površina koja omogućuje postavljanje predmeta za koje je potrebna ravna površina.
- Uklonjiva gornja ladica koja omogućuje odlaganje alata za sekcioniranje i sprečava pad predmeta.

3 Sastavni dijelovi i specifikacije aparata

3.3 Tehnički podaci

Općenito

Raspon debljine nareska	1 – 60 µm
Povećanja debljine nareska	<ul style="list-style-type: none">od 1 do 10 µm u rasponima povećanja od 1 µmod 10 do 20 µm u rasponima povećanja od 2 µmod 20 do 60 µm u rasponima povećanja od 5 µm
Raspon vodoravnog umetanja	24 ± 2 mm
Duljina okomitog hoda	70 ± 1 mm
Maksimalni raspon rezanja bez retrakcije	69 mm
Maksimalno područje sekcioniranja s retrakcijom	62 mm
Maksimalna veličina sklopa uzorka za široku standardnu stezaljku (V x Š x D)	55 x 50 x 30 mm
Maksimalna veličina sklopa uzorka za super veliku kasetnu stezaljku (V x Š x D)	68 x 48 x 15 mm
Tiha retrakcija uzorka:	pribl. 40 µm. može se isključiti.
Funkcija podrezivanja s 2 postavke	10 µm, 30 µm
Smjer okretanja kotača grubog umetanja u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu	Prema odabiru korisnika

Dimenzije i težine

Širina (uključujući ručni kotač i kotač grubog umetanja)	477 mm
Dubina (uključujući ladicu za otpad nakon sekcioniranja)	620 mm
Visina (bez gornje ladice)	295 mm
Težina (bez dodatnog pribora)	pribl. 31 kg
Zapremnina ladice za otpad nakon sekcioniranja	1400 ml

Dodatni pribor

Orientacija uzorka s položajem nula	<ul style="list-style-type: none">Vodoravno okretanje: ± 8°Okomito okretanje: ± 8°
Držač oštice dva u jednom	<ul style="list-style-type: none">Funkcija bočnog pomicanjaPomak istok-zapadPomicanje postolja držača ošticeSjever-jug: ± 24 mm

Radna okolina

Raspon radne temperature	+18 °C do +30 °C
Relativna vlažnost za rad	20 % do maks. 80 %, bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	do 2000 m iznad razine mora

Okolina za transport i skladištenje

Raspon temperature pri transportu	-29 °C do +50 °C
Raspon temperature skladištenja	+5 °C do +50 °C
Relativna vlažnost za transport i skladištenje	10 % do maks. 85 %, bez kondenzacije

4. Postavljanje aparata

4.1 Zahtjevi na mjestu ugradnje

- Stabilni laboratorijski stol bez vibracija s vodoravnom i ravnom površinom stola, tlo bez vibracija koliko god je to moguće.
- U blizini nema niti jednog drugog aparat koji bi mogao izazivati vibracije.
- Stalna temperatura prostorije između +18 °C i +30 °C.
- Pristup ručnom kotaču bez prepreka.



Opasnost

Opasnost od eksplozije.

Smrt ili ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine.

- Nikada nemojte rukovati aparatom u prostorijama gdje postoji opasnost od eksplozija.

4.2 Uobičajeni obim isporuke – dostavnica

Aparat HistoCore BIOCUT dostupan je u dvije konfiguracije.

Konfiguracija HistoCore BIOCUT: 14 9BI0000C1

Količina	Opis dijela	Br. narudžbe
1	Osnovni model aparata HistoCore BIOCUT	14 0517 56235
1	Pričvršćenje stezaljke uzorka s preciznim usmjeravanjem	14 0502 37717
1	Brostezni sustav	14 0502 37718
1	Univerzalna kasetna stezaljka	14 0502 37999
1	Postolje držača oštice	14 0502 55546
1	Držač oštice dva u jednom E	14 0502 54497

Osnovni aparat HistoCore BIOCUT uključuje sljedeću dostavnici.

Količina	Opis dijela	Br. narudžbe
1	Osnovni model aparata HistoCore BIOCUT	14 0517 56235
1	Ručni kotač, sklop	14 0501 38181
1	Antistatička ladica za otpad	14 0517 56237
1	Gornja ladica	14 0517 56261
1	Servisni komplet, HistoCore BIOCUT	14 0517 56318
1	Sigurnosna podloška Schnorr 10x6,4x0,7	14 3017 00073
1	Imbus vijak M6x16 DIN7984	14 2101 23130
1	Pokrivni disk	14 3025 00008
1	Upute za upotrebu (na engleskom jeziku, s CD-om s drugim jezicima 14 0517 80200)	14 0517 80001

Osnovni se aparat može konfigurirati s pomoću dolje navedenog pribora sukladno vašoj primjeni. Za dobivanje izvodljive konfiguracije potrebno je naručiti najmanje jednu stavku iz dolje navedenih kategorija.

Osnovni model aparata	14051756235	Osnovni aparat HistoCore BIOCUT bez svega sljedećeg: orijentacija, brzostezni sustav, stezaljka uzorka, mehanizam za namještanje držača oštice ili noža
HistoCore BIOCUT		
odaberite jedno		
Smjer uzorka	14050237717	Pričvršćenje stezaljke uzorka s preciznim usmjeravanjem (*)
	14050238949	Pričvršćenje stezaljke uzorka s usmjeravanjem (*)
	14050238160	Kruto pričvršćenje stezaljke uzorka
treba naručiti uz smjer učvršćenja s (*)		
Brzostezni sustav (*)	14050237718	Brzostezni sustav (*)
Naručite najmanje jednu stezaljku uzorka		
Stezaljke uzorka	14050237999	Univerzalna kasetna stezaljka
	14050238005	Standardna stezaljka uzorka 50x55 mm
	14050237998	Standardna stezaljka uzorka 40x40 mm
	14050238967	Super velika kasetna stezaljka
	14050246573	Stezaljka RM CoolClamp
Naručite najmanje jedno postolje držača oštice ili noža i jedan držač oštice ili noža		
Postolje držača oštice i držač oštice	14050255546	Postolje držača oštice
	14050254497	Držač oštice dva u jednom E
Postolje držača noža i držači noža	14050237962	Postolje držača noža
	14050237993	Držač noža N
	14050238961	Držač noža E s niskoprofilnim kanalom

Dodatni pribor i noževe/oštice potražite u poglavlju 6 (→ str. 44 – 6. Dodatni pribor).



Savjet

Naručeni dodatni pribor uključen je posebnu kutiju.

Provjerite sve isporučene dijelove prema dostavnici i svojoj narudžbi kako biste provjerili je li isporuka kompletna. Ako nađete na neka odstupanja, odmah se obratite prodajnom predstavniku tvrtke Leica Biosystems.

4.3 Raspakiravanje i ugradnja



Upozorenje

Dodatni pribor/aparat ispada iz pakiranja prilikom raspakiranja.

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine.

- Budite oprezni prilikom raspakiranja aparata.
- Nakon raspakiranja aparat se mora postaviti u uspravan položaj.
- U potpunosti pratite upute navedene u uputama za raspakiranje pričvršćene s vanjske strane pakiranja ili radnje opisane u uputama za upotrebu.



Upozorenje

Aparat nije podignut na pravilan način.

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine.

- Prilikom podizanja aparata uhvatite ga isključivo za podizne točke opisane u uputama za upotrebu i uputama za raspakiranje (podnožje na prednjem dijelu i ispod aparata na stražnjem dijelu).
- Aparat nikada nemojte transportirati držeći ga za dršku ručnog kotača, kotačić za grubo umetanje, vrh predmeta ili kotačić za postavljanje debljine nareska.
- Uvijek uklonite ladicu za otpad pri sekcioniranju prije transportiranja aparata.



Upozorenje

Nepažljivo pomicanje aparata.

Ozbiljne ozljede ruku i/ili prstiju zbog prgnjećenja između aparata i radne površine.

- Prilikom pomicanja aparata uhvatite ga isključivo za podizne točke opisane u uputama za upotrebu i uputama za raspakiranje (podnožje na prednjem dijelu i ispod aparata na stražnjem dijelu).
- Pazite da ruke i prsti nisu između aparata i radne površine.



Upozorenje

Aparat nije sigurno postavljen sa sve 4 nožice na odgovarajućem laboratorijskom stolu.

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine.

- Aparat stavlja jedino na stabilan laboratorijski stol bez vibracija s vodoravnim i ravnom površinom stola. Tlo mora biti bez vibracija koliko god je to moguće.
- Uvijek provjerite jesu li sve 4 nožice potpuno postavljene na laboratorijski stol.
- Ako aparat pomiču druge osobe (primjerice radi servisiranja), uvijek provjerite ispravno postavljanje.



Oprez

Otpuštanje/oštećenje pribora/sastavnih dijelova tijekom transporta.

Oštećenje opreme ili odgađanje postavljanja dijagnoze.

- Na ambalaži se nalaze dva indikatora, ShockDot Impact Indicator (indikator udara) i Tilt Indicator (indikator nagiba), koji upućuju na neprimjerene uvjete transportiranja. Odmah provjerite stanje ovih indikatora čim aparat bude isporučen. Bude li ijedan od navedenih indikatora aktiviran, pošiljkom se nije rukovalo u skladu s pravilima. U ovom slučaju, molimo Vas da dokumentaciju o pošiljci ispunite u skladu s prisutnim okolnostima i provjerite je li pošiljka oštećena.



Savjet

Transportno pakiranje i uključeni pričvrsni dijelovi trebaju se čuvati za slučaj kasnije povratne pošiljke. Da biste vratili aparat, pridržavajte se uputa u nastavku obrnutim redoslijedom.



Sl. 6

- Uklonite trake za pakiranje i samoljepivu vrpcu (→ "Sl. 6-1").
- Uklonite kartonski poklopac (→ "Sl. 6-2").




Sl. 7

- Izvadite paket s priborom (dodatni pribor) (→ "Sl. 7-3") i pakete (→ "Sl. 7-4") standardnog obima isporuke.



Sl. 8

- Izvadite pričvrsni modul (→ "Sl. 8-5"). Da biste to napravili držite ga za gornji rub modula i udubljenu dršku (→ "Sl. 8-6") i izvucite povlačeći prema gore.
- Uklonite vanjsku kartonsku pregradu (→ "Sl. 8-7").
- Podignite aparat (→ "Sl. 8-8") držeći ga za podnožje na prednjem dijelu (→ "Sl. 9-11") i ispod aparata na stražnjem dijelu (→ "Sl. 9-12") i podignite ga izvan oblikovanog jastuka (→ "Sl. 8-9"). (Ilustracija aparata navedena je samo kao primjer.)

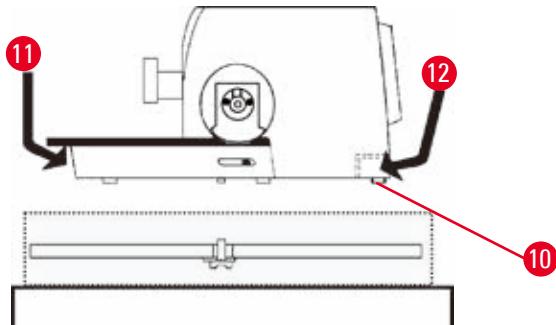

Sl. 9


- Aparat postavite na stabilan laboratorijski stol. Dva klizna elementa (→ "Sl. 9-10") koja se nalaze na stražnjem dijelu podnožja olakšavaju pomicanje instrumenta na stol.
- Da biste pomaknuli aparat, uhvatite ga za prednji dio podnožja (→ "Sl. 9-11"), lagano podignite i klizno pomaknite na njegovim klizačima.

4.4 Sastavljanje ručnog kotača



Savjet

Ručni kotač treba sastaviti prije početka upotrebe aparata. Potrebni dijelovi i alat nalaze se u isporučenom kompletu alata.

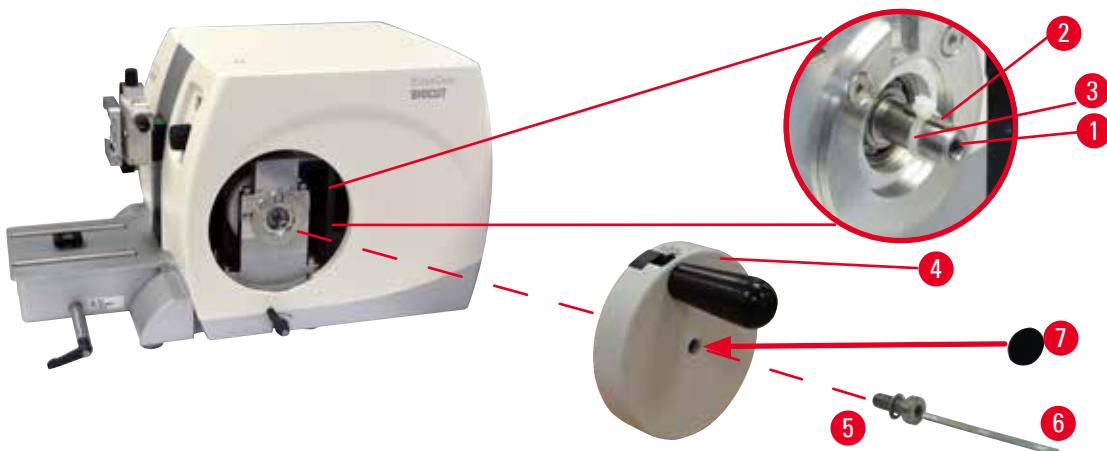

Sl. 10

Spojni je klin ([→ "Sl. 10-2"](#)) labavo postavljen u osovinu ručnog kotača ([→ "Sl. 10-1"](#)) i tijekom transporta pričvršćen je kabelskom vezicom.

- Uklonite kabelsku vezicu ([→ "Sl. 10-3"](#)).



Oprez

Spojni je klin izgubljen prilikom postavljanja ručnog kotača.

Aparat se ne može upotrebljavati i to može prouzročiti kašnjenje kod postavljanja dijagnoze.

- Prije sastavljanja ručnog kotača provjerite spojni klin i provjerite je li u osovini ručnog kotača.


- Postavite ručni kotač ([→ "Sl. 10-4"](#)) na osovinu ručnog kotača ([→ "Sl. 10-1"](#)) kao što je prikazano.
- Zategnite vijak ([→ "Sl. 10-5"](#)) koji se nalazi u središnjoj rupi ručnog kotača imbus ključem veličine 4 ([→ "Sl. 10-6"](#)).
- Uklonite pokrovnu foliju sa samoljepivog pokrovnog diska ([→ "Sl. 10-7"](#)) i disk pričvrstite na ručni kotač.

5 Rad

5. Rad

5.1 Radni elementi i njihove funkcije

5.1.1 Postavljanje debljine nareska

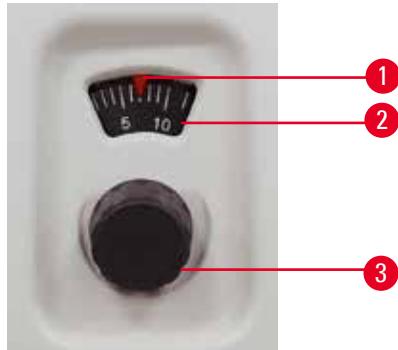


Sl. 11

Debljina nareska postavlja se okretanjem kotačića za namještanje (→ "Sl. 11-3") na prednjem dijelu mikrotoma s desne strane.

Raspon postavljanja: 1 – 60 µm
od 1 do 10 µm u rasponima povećanja od 1 µm
od 10 do 20 µm u rasponima povećanja od 2 µm
od 20 do 60 µm u rasponima povećanja od 5 µm.
Postavljena debljina nareska u svakom od slučajeva prikazuje se u prozorčiću (→ "Sl. 11-2").
Odabrana debljina nareska (na ljestvici) mora se podudarati s crvenim pokazivačem (→ "Sl. 11-1").

5.1.2 Kotač grubog umetanja

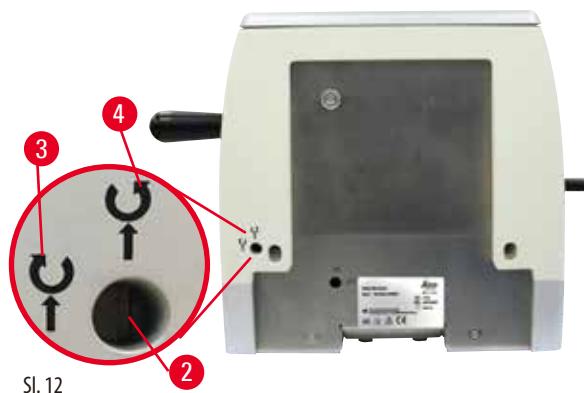

Sl. 12

Okretanje kotača grubog umetanja (→ "Sl. 12-1") može se postaviti u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu da bi se pomaknula glava predmeta. Utor za namještanje (→ "Sl. 12-2") nalazi se na poleđini aparata. Odvijačem (isporučenim u obimu isporuke) utor okrenite u vodoravni položaj (u smjeru kazaljke na satu) (→ "Sl. 12-3") ili u okomiti položaj (u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu) (→ "Sl. 12-4").

Grubo pomicanje namijenjeno je za brzo vodoravno pomicanje uzorka prema nožu i unatrag, dalje od noža.

Kotač grubog umetanja teško se okreće kada dođe do krajnjeg stražnjeg/prednjeg položaja. U krajnjem prednjem položaju više nema umetanja.



Oprez

Istovremeno okretanje ručnog kotača i kotača grubog umetanja.

Oštećenje uzorka.

- Nemojte okretati kotač grubog umetanja dok okrećete ručni kotač.

5.1.3 Retrakcija uzorka



Sl. 13

Prednost tihe retrakcije uzorka je lako povezivanje i izbjegavanje doticaja čime se štiti površina reznog sklopa i oštrica tijekom povratnog hoda glave predmeta. Osoba koja upravlja aparatom može je uključiti/isključiti.

Preporučuje se isključiti retrakciju prilikom podrezivanja u načinu rada s njihanjem. Kada je retrakcija uključena, uzorak se uvlači unatrag za približno 40 µm kada glava predmeta dostiže donju točku okreta. Vrijednost retrakcije i odabrana debljina nareska umetnut će se kada glava predmeta dosegne gornju okretnu točku.

Retrakcija uzorka može se ručno isključiti na poleđini aparata ([→ "Sl. 13"](#)), ako je to potrebno, pomoću plosnatog odvijača (isporučuje se pri isporuci). Da biste isključili retrakciju, utor okrenite u vodoravan položaj (OFF). Da biste uključili retrakciju, utor okrenite u okomit položaj (ON).

Prije uključivanja i isključivanja retrakcije glavu predmeta odvedite u krajnji gornji položaj okretanjem ručnog kotača.

5.1.4 Funkcija mehaničkog podrezivanja



Sl. 14

Aparat je opremljen funkcijom mehaničkog podrezivanja. Ručica podrezivanja ima 3 položaja ureza (0 = razina podrezivanja nije pritisnuta, 10 µm, 30 µm).

Točke ([→ "Sl. 14-1"](#)) i ([→ "Sl. 14-2"](#)) označavaju dvije razine podrezivanja:

([→ "Sl. 14-1"](#)) = 10 µm
 ([→ "Sl. 14-2"](#)) = 30 µm

Da biste uključili funkciju podrezivanja, ručicu gurnite prema dolje u jedan od dva položaja ureza i držite je pritisnutom. Nakon svakog okretaja ručnog kotača, dolazi do pomaka umetanja od 10 µm ili 30 µm.

Kada se otpusti ručica, ona se automatski vraća u svoj početni položaj (multi položaj). Funkcija podrezivanja tako se isključuje i debljina nareska odabrana tijekom ([→ str. 30 – 5.1.1](#)

Postavljanje debljine nareska) umetnut će se kod svakog okretaja ručnog kotača.



Savjet

Postavljena debljina nareska nije dodana odabranoj vrijednosti podrezivanja.


Ako je postavljena debljina nareska veća od odabrane vrijednosti podrezivanja, umeće se postavljena debljina nareska.

5.1.5 Precizno usmjeravanje pričvršćenja držača uzorka



Savjet

U brzosteznom sustavu pričvršćenja držača uzorka koje se može usmjeravati mogu se upotrebljavati sve stezaljke uzorka dostupne kao dodatni pribor.

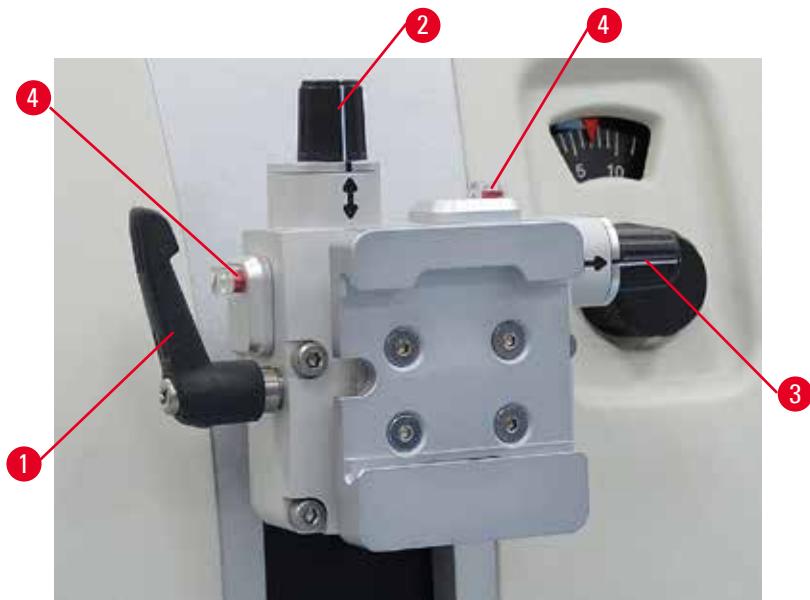

Sl. 15

Orijentacija uzorka omogućuje jednostavno ispravljanje položaja površine uzorka kada je uzorak stegnut na mjestu. Pričvršćenje držača uzorka koje se može usmjeravati može se zamijeniti pričvršćenjem držača uzorka koje se ne može usmjeravati (dodatni pribor).

Prikaz nultog položaja

Da biste imali bolji prikaz nultog položaja, orientacija ima dva indikatora (→ "Sl. 15-4").

Kada su istovremeno oba indikatora potpuno vidljiva i oba vijka u nultom položaju (bijele oznake poravnate sa strelicama), uzorak je u nultom položaju.

Orijentacija uzorka



Upozorenje

Uzorak je orijentiran u fazi retrakcije.

Oštećenje uzorka zbog ponovne orijentacije uzorka u fazi retrakcije.

- Blokovi uzorka ne smiju se orijentirati tijekom faze retrakcije. Ako se blok orijentira tijekom retrakcije, blok će se pomaknuti za vrijednost retrakcije plus debljinu odabranog nareska prije sljedećeg sekcioniranja. To može prouzročiti oštećenje uzorka i noža/oštice.

- Podignite glavu predmeta u krajnji gornji položaj i uključite mehanizam za zabravljenje ručnog kotača.
- Da biste otpustili stezaljku, okrenite ekscentričnu ručicu (→ "Sl. 15-1") u smjeru kazaljke na satu.
- Okrenite vijak (→ "Sl. 15-2") da biste uzorak usmjerili u okomitom smjeru. Okrenite vijak (→ "Sl. 15-3") da biste uzorak usmjerili u vodoravnom smjeru. Svaki cijeli okretaj vijka uzorak nagiba za 2° . Ukupno 4 cijela okretaja = 8° moguće je u svakom smjeru. Točnost je približno $\pm 0,5^\circ$. Radi lakše procjene na ručici se nalazi bijela oznaka i graničnik škljocaja koji se primjećuje prilikom okretanja.
- Da biste zabravili trenutačnu orijentaciju, ekscentričnu ručicu (→ "Sl. 15-1") okrenite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.



Savjet

Kada se upotrebljava velika standardna stezaljka uzorka (50 x 55 mm) ili super velika kasetna stezaljka uzorka, više nije moguća orijentacija uzorka od $\pm 8^\circ$ u smjeru sjever – jug. Iskoristivi kut za veliku standardnu stezaljku uzorka (50 x 55 mm) u ovom je slučaju samo oko $\pm 4^\circ$.

5.1.6 Precizno namještanje ravnoteže sile



Sl. 16

Ako se neki drugi dodatni pribor različite težine postavi na glavu predmeta (→ "Sl. 16-1"), morate provjeriti treba li ponovno namjestiti ravnotežu sile.

- Pričvrstite novi dodatni pribor i pritegnite uzorak.
 - Postavite glavu predmeta na polovicu visine raspona okomitog hoda okretanjem ručnog kotača (→ "Sl. 16").
- Ako glava predmeta ostane u točno tom položaju, postavljenje je pravilno.
- Ako se glava predmeta pomiče, odnosno podiže se ili spušta, potrebno je precizno namještanje.

**Upozorenje**

Nepravilno precizno namještanje ravnoteže sile.

Ozbiljna ozljeda osobe koja rukuje aparatom zbog doticaja s nožem i/ili oštećenje uzorka.

- Prije rada s aparatom, uvijek ponovno provjerite je li precizno namještanje ravnoteže sile pravilno postavljeno.
- Ako precizno namještanje nije pravilno postavljeno, nemojte raditi s aparatom, već obavite ponovno namještanje.
- Osobito nakon zamjene dodatnog pribora na glavi predmeta odmah obavite precizno namještanje ravnoteže sile.



Sl. 17

Ravnoteža sile namješta se pomoću vijka (→ "Sl. 17-1") kojemu se može pristupiti tako da se ukloni ladica za otpad pri sekcioniranju na dnu podnožja mikrotoma. Za namještanje upotrijebite imbus ključ veličine 5 (s ručkom).


- Ako se glava predmeta pomiče prema dolje, vijak (→ "Sl. 17-1") svaki puta okrenite za približno 1/2 okretaja u smjeru kazaljke na satu.
- Ako se glava predmeta pomiče prema gore, vijak (→ "Sl. 17-1") svaki puta okrenite za približno 1/2 okretaja u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
- Taj postupak nastavite sve dok se glava predmeta više ne pomiče nakon otpuštanja.

**Savjet**

Postupak namještanja nekoliko puta ponovite dok se glava predmeta više neće pomicati.


5.2 Umetanje držača oštice dva u jednom E

5.2.1 Postavljanje podnožja držača oštice

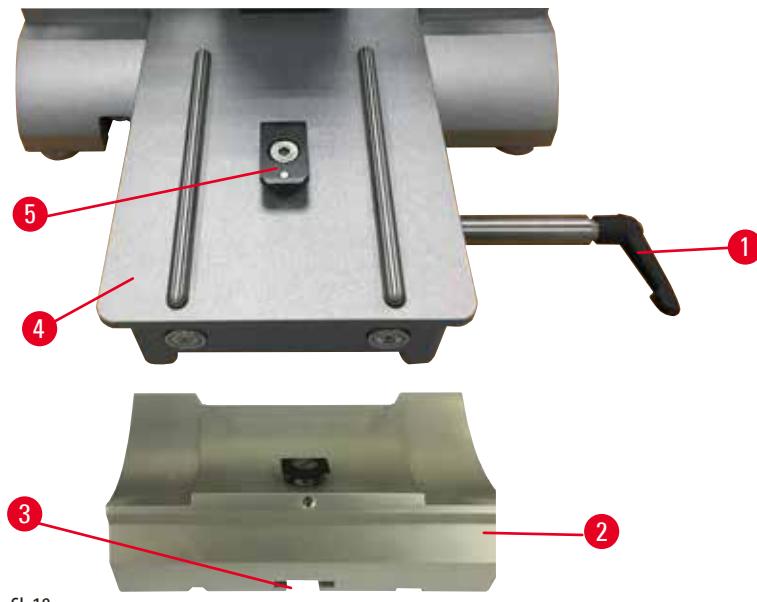


1. Otpustite steznu polugicu (→ "Sl. 18-1") tako da je okrećete u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
2. Umetnute postolje držača oštice (→ "Sl. 18-2") pomoću utora (→ "Sl. 18-3") na dnu u dio u obliku slova T (→ "Sl. 18-5") podnožja mikrotoma (→ "Sl. 18-4").
3. Postolje držača oštice (→ "Sl. 18-2") može se pomocići unatrag i prema naprijed na podnožju mikrotoma. Time se omogućuje dovođenje držača oštice dva u jednom E u optimalan položaj sekcioniranja za uzorak. Da biste učvrstili podnožje držača oštice, okrenite steznu polugicu (→ "Sl. 18-1") u smjeru kazaljke na satu.

5.2.2 Umetanje držača oštice dva u jednom E

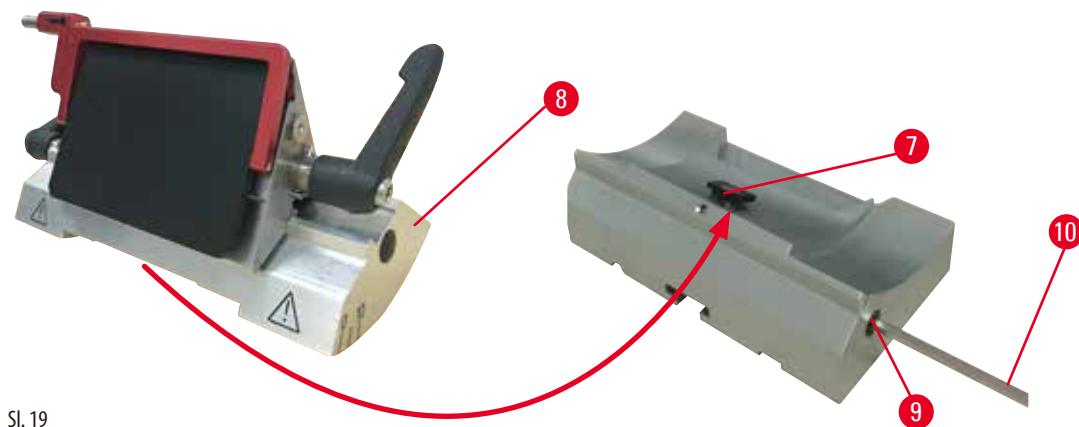

1. Otpustite ekscentrični vijak (→ "Sl. 19-9") pomoću imbus ključa veličine 4 (→ "Sl. 19-10").
2. Stavite držač oštice dva u jednom E (→ "Sl. 19-8") s donjim utorom na dio u obliku slova T (→ "Sl. 19-7") postolja držača noža (→ "Sl. 18-2").
3. Da biste stegnuli, ponovno pritegnite ekscentrični vijak (→ "Sl. 19-9").

5.3 Namještanje kutnog zazora

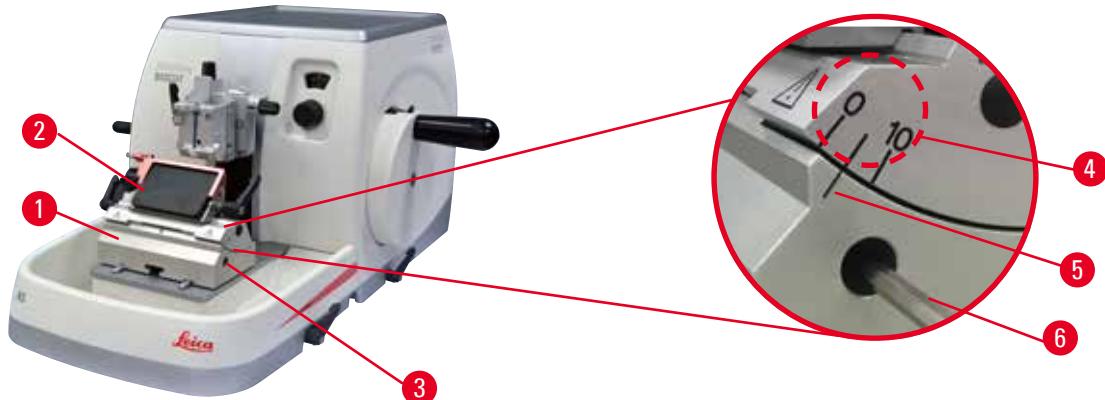

Sl. 20

Indeksne oznake (0° , 5° i 10°) za namještanje kutnog zazora (→ "Sl. 20-4") nalaze se na desnoj strani držača oštice dva u jednom E (→ "Sl. 20-2"). Indeksna oznaka (→ "Sl. 20-5") nalazi se i na desnoj strani podnožja držača oštice (→ "Sl. 20-1") koje služi kao referentna točka kod namještanja kutnog zazora.


1. Otpustite vijak (→ "Sl. 20-3") pomoću imbus ključa veličine 4 (→ "Sl. 20-6") sve dok se držač oštice dva u jednom E (→ "Sl. 20-2") može pomaknuti.
2. Pomaknite držač oštice dva u jednom E sve dok se indeksna oznaka željenog kutnog zazora ne poklopi s referentnom linijom na podnožju držača oštice. Uvećani detalj (→ "Sl. 20") prikazuje postavku kutnog zazora od 5° .

**Savjeti**

Preporučena postavka kutnog zazora za držač oštice dva u jednom E iznosi pribl. $2,5^\circ$ – 5° .

3. Zadržite držač oštice dva u jednom E u tom položaju i pritegnite vijak (→ "Sl. 20-3") za stezanje.

5.4 Umetanje univerzalne kasetne stezaljke

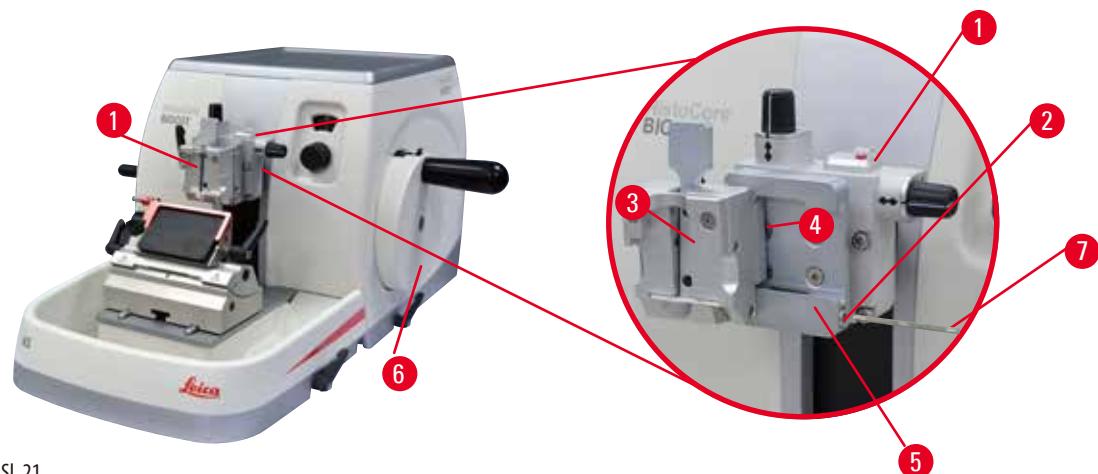

Sl. 21

Dva su pričvršćenja držača uzorka koja se usmjeravaju i jedno koje se ne usmjerava, pogledajte (→ str. 44 – 6. Dodatni pribor). Orientacija uzorka omogućuje jednostavno ispravljanje položaja površine uzorka kada je uzorak stegnut na mjestu. Možete upotrijebiti brzostezni sustav (→ "Sl. 21-5") za držanje svih dostupnih stezaljki uzorka dodatne opreme (više informacija potražite u dijelu (→ str. 44 – 6. Dodatni pribor)).

Za postavljanje aparata učinite sljedeće:

1. Pomaknite glavu predmeta (→ "Sl. 21-1") u krajnji gornji položaj okretanjem ručnog kotača (→ "Sl. 21-6") i uključite mehanizam za zabravljivanje ručnog kotača.
2. Da biste otpustili stezni sustav, okrenite vijak (→ "Sl. 21-2") brzosteznog sustava (→ "Sl. 21-5") u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu pomoću imbus ključa veličine 4 (→ "Sl. 21-7").
3. Gurnite vodilicu (→ "Sl. 21-4") univerzalne kasetne stezaljke (→ "Sl. 21-3") s lijeva u brzostezni sustav (→ "Sl. 21-5") koliko god je moguće.
4. Da biste zategnuli kasetnu stezaljku, vijak (→ "Sl. 21-2") okrenite u smjeru kazaljke na satu koliko god je moguće.



Savjet

Budući da su sve stezaljke uzorka dostupne kao dodatni pribor opremljene istom vrstom vodilice na stražnjem dijelu, one se umeću na isti, ovdje opisani način u kojem je kao primjer upotrijebljena kasetna stezaljka.

5.5 Stezanje uzorka



Upozorenje

Osoba koja rukuje aparatom hvata nož ili oštricu zbog neodgovarajućeg postupka rada.

Ozbiljne ozljede ljudi prilikom postavljanja uzorka ako su nož ili oštrica prethodno postavljeni.

- Prije umetanja uzorka u mikrotom provjerite da rezna oštrica nije prekrivena sigurnosnim štitnikom i je li uključen mehanizam za zabravljenje ručnog kotača. Kada je osoba koja rukuje aparatom učitala uzorak i umetnula nož/oštricu, blok uzorka uvijek umetnите prije postavljanja i stezanja noža/oštice.

1. Okrećite ručni kotač sve dok stezaljka uzorka ne dođe u krajnji gornji položaj.
2. Zabavite ručni kotač ili aktivirajte mehanizam za zabravljenje ručnog kotača (→ str. 18 – 2.3.1 Zabravljivanje ručnog kotača).
3. Umetanje uzorka u stezaljku uzorka.



Savjet

Detaljan opis umetanja uzorka u različite stezaljke uzorka i držače uzorka nalazi se u (→ str. 44 – 6. Dodatni pribor).

5.6 Stezanje noža/jednokratne oštice



Upozorenje

Noževima ili ošticama rukuje se i/ili se odlažu na neodgovarajući način.

Ozbiljne ozljede ljudi zbog doticaja s iznimno oštrim noževima i/ili ošticama.

- Radite posebno temeljito i oprezno kada rukujete noževima i/ili ošticama.
- Uvijek nosite namjensku odjeću (uključujući rukavice otporne na rezove) kada rukujete noževima i/ili ošticama.
- Noževe i oštice uvijek odlažite na sigurno mjesto (primjerice, posebnu kutiju za noževe) i na odgovarajući način kojim se osigurava da neće doći do ozljeda ljudi.
- Nož nikada nemojte postavljati s reznom ošticom okrenutom prema gore i nikada nemojte pokušati uhvatiti nož u padu!
- Uvijek zategnjite uzorak PRIJE postavljanja i stezanja noža/oštice.




Upozorenje


Osoba koja rukuje aparatom postavlja dva noža i/ili oštice na držač noža i/ili oštice.

Ozbiljne ozljede ljudi zbog doticaja s iznimno oštrim noževima i/ili ošticama.

- Nemojte stezati dva noža/oštice na držač noža/držač oštice. Postavite nož/oštricu u središte držača noža/oštice. Noževi/oštice ne smiju prelaziti rub držača noža/oštice.

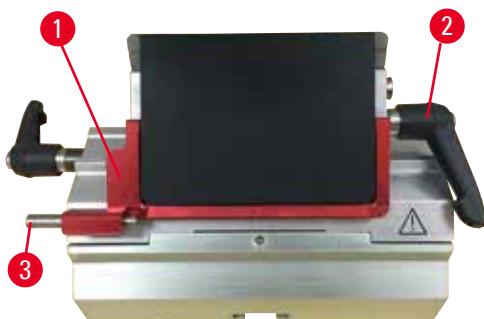Umetanje visokoprofilnih oštrica

Sl. 22

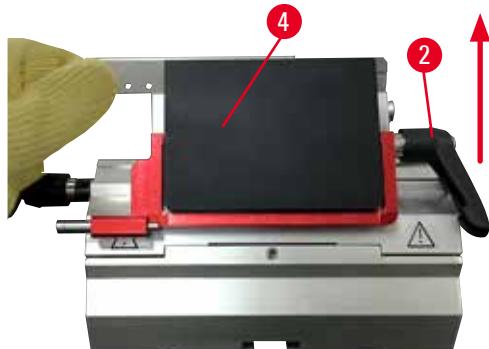

Sl. 23

1. Spustite sigurnosni štitnik ([→ "Sl. 22-1"](#)).
2. Da biste umetnuli oštricu, desnu steznu polugicu ([→ "Sl. 22-2"](#)) okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
3. Pažljivo oštricu gurnite odozgo ili sa strane. Provjerite nalazi li se oštrica u središtu i, najvažnije, je li paralelna s gornjim rubom potisne ploče ([→ "Sl. 23-4"](#)).
4. Da biste stegnuli oštricu, steznu polugicu ([→ "Sl. 22-2"](#)) okrenite u smjeru kazaljke na satu.

Umetanje niskoprofilnih oštrica

Sl. 24



Sl. 25

Kada upotrebljavate niskoprofilne oštrice, umetak ([→ "Sl. 25-1"](#)) za niskoprofilne oštrice mora se prvo postaviti u držać oštrice dva u jedan E i provjeriti prianja li donji rub umetka uz utor držača oštrice.

Dva su magneta pričvršćena na stražnji dio umetka ([→ "Sl. 24-1"](#)). Oni su usmjereni u smjeru suprotnom od operatera (prema stražnjoj potisnoj ploči) nakon umetanja umetka sa zaobljenim rubovima koji su usmjereni prema gore. Provjerite je li umetak do kraja pritisnut i omogućuje li da se oštrica postavi paralelno s reznom oštricom; ako se točno ne obavi, postoji opasnost od oštećenja uzorka.

Zatim oštricu umetnite kako je opisano (za visoko profilnu oštricu) ([→ str. 38 – Umetanje visokoprofilnih oštrica](#)).

Uklanjanje oštrica



Sl. 26



Sl. 27

1. Steznu polugicu (["Sl. 26-2"](#)) okrenite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
2. Gurnite zatik (["Sl. 26-3"](#)) na mehanizmu za izbacivanje oštrice.



Savjeti

Upotrijebite mehanizam za izbacivanje oštrice da biste izbacili oštricu.

3. Spustite sigurnosni štitnik (["Sl. 27-1"](#)). Upotrijebite četku s magnetom (["Sl. 27-4"](#)) da biste oštricu uklonili s desne strane i izvadili je.

Kada je oštrica uklonjena iz držača oštice dva u jednom E, odlaže se u spremnik rabljenih oštrica iza kutije za oštice (["Sl. 28"](#)).



Sl. 28



Upozorenje

Noževima ili oštricama rukuje se i/ili se odlažu na neodgovarajući način.

Ozbiljne ozljede ljudi zbog doticaja s iznimno oštrim noževima i/ili oštricama.

- Radite posebno temeljito i oprezno kada rukujete noževima i/ili oštricama.
- Uvijek nosite namjensku odjeću (uključujući rukavice otporne na rezove) kada rukujete noževima i/ili oštricama.
- Noževe i oštice uvijek odlažite na sigurno mjesto (primjerice, posebnu kutiju za noževe) i na odgovarajući način kojim se osigurava da neće doći do ozljeda ljudi.
- Nož nikada nemojte postavljati s reznom oštricom okrenutom prema gore i nikada nemojte pokušati uhvatiti nož u padu!
- Uvijek zategnjite uzorak PRIJE postavljanja i stezanja noža/oštice.

**Savjet**

Detaljni opisi umetanja noža u pojedinačne držače noža nalaze se u ([→ str. 44 – 6. Dodatni pribor](#)).

5.7 Obrezivanje uzorka**Upozorenje**

Smjer okretanja kotača grubog umetanja nepravilno je odabran.

Oštećenje uzorka.

- Uvijek provjerite jeste li odabrali točan smjer okretanja kotača grubog umetanja tako da provjerite postavku smjera kotača grubog umetanja na poleđini aparata.

**Oprez**

Istovremeno okretanje ručnog kotača i kotača grubog umetanja.

Oštećenje uzorka.

- Nemojte okretati kotač grubog umetanja dok okrećete ručni kotač.

**Upozorenje**

Prsti umetnuti između uzorka i noža/oštice nakon otpuštanja ručnog kotača prilikom obavljanja brzog ručnog podrezivanja.

Osoba koja rukuje aparatom može se porezati i ozlijediti zbog okretanja ručnog kotača kada nije zabravljen.

- Nemojte stavljati prste između uzorka i noža/oštice tijekom podrezivanja i sekcioniranja.
 1. Pomaknite uzorak u krajnji stražnji položaj okretanjem kotača za grubo umetanje.
 2. Držač noža/oštice gurnite na podnožju držača noža/oštice dok ne dođe tik do uzorka.
 3. Usmjerite položaj površine uzorka ovisno o položaju noža/oštice (samo kada se radi o držaćima uzorka koji se mogu okrenuti).
 4. Otpustite mehanizam za zabravljenje ručnog kotača odnosno ručicu kočnice ručnog kotača.
 5. Upotrijebite funkciju mehaničkog podrezivanja u dva koraka i pritisnite ručicu da biste odabrali željenu debljinu podrezivanja.
 6. Postupak podrezivanja započnite okretanjem ručnog kotača.
 7. Postupak prekinite kada se dosegne željena razina uzorka.
 8. Otpustite razinu podrezivanja.

5.8 Sekcioniranje**Upozorenje**

Osoblje nedovoljnih kvalifikacija radi s aparatom.

Može doći do ozbiljnih ozljeda ljudi i ili oštećenja uzorka kada se uzorak približi nožu/oštici zbog neodgovarajućeg djelovanja osobe koja rukuje aparatom, na primjer zato što glava predmeta može pasti na držač noža kada se ručni kotač otpusti.

- Uvijek pazite da jedino kvalificirano laboratorijsko osoblje koje je završilo posebnu i dovoljnu obuku rukuje aparatom.
- Uvijek pazite da je cjelokupno laboratorijsko osoblje koje će rukovati ovim uređajem pažljivo pročitalo ove upute za upotrebu i da je upoznato sa svim tehničkim značajkama aparata prije nego što pokuša njime rukovati.



Upozorenje

Ne upotrebljava se osobna zaštitna oprema.

Ozljede ljudi.

- Uvijek se morate pridržavati sigurnosnih mjera opreza prilikom rada s mikrotomima. Obavezno morate nositi zaštitnu radnu obuću, zaštitne rukavice, masku i zaštitne naočale.



Upozorenje

Rad s aparatom i lomljivim uzorkom bez odgovarajuće zaštitne odjeće.

Ozbiljne ozljede ljudi uzrokovane krhotinama prilikom rezanja lomljivog uzorka.

- Uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću (uključujući zaštitne naočale) i posebno pažljivo radite kada režete lomljivi uzorak.



Upozorenje

Nedovoljni uvjeti okvira za sekcioniranje.

Oštećenje uzorka ili loši rezultati sekcioniranja, na primjer rezovi promjenjive deblijine, sabijeni, prekopljeni ili ogoljeni rezovi.

- Nemojte nastaviti sa sekcioniranjem ako utvrdite nezadovoljavajuće rezultate sekcioniranja.
- Provjerite jesu li ispunjeni svi preduvjeti za odgovarajuće sekcioniranje. Dodatne pojedinosti potražite u dijelu o uklanjanju pogrešaka ovih uputa za upotrebu.
- Ako nemate dovoljno znanja o rješavanju pogreške nedovoljnih rezultata sekcioniranja, обратите se osobama koje to znaju, na primjer stručnjacima tvrtke Leica Biosystems.



Upozorenje

Okretanje ručnog kotača u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

Ozljede ljudi/oštećenje uzorka

- Ručni kotač nemojte okretati u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu što može dovesti do neispravnosti mehanizma za zatravljenje ručnog kotača.



Upozorenje

Brzina okretanja ručnog kotača ne odgovara tvrdoći uzorka.

Oštećenje aparata i moguće oštećenje uzorka.

- Brzina okretanja ručnog kotača mora se prilagoditi tako da odgovara tvrdoći uzorka. Sporije brzine upotrebljavajte za tvrde uzorke.



Oprez

Nakon što se držač oštice/noža bočno pomakne, uzorak nije povučen ni ponovno podrezan.

Oštećenje uzorka.

- Povucite glavu predmeta i ponovno podrežite sklop uzorka svaki put nakon bočnog pomicanja držača oštice/noža.

**Napomena**

Pribor i dijelovi uređaja će korodirati ako se na njega nanose korozivni/jako kiseli/alkalni reagensi ili otapala kao što su kisele dekalcificirane otopine, alkalni amonijev hidroksid, itd.

Pribor zbog toga može neispravno raditi.

- Ne dopustite da korozivni/jako kiseli/alkalni reagens ili otapalo kaplje po instrumentu ili po priboru.
- Ako takav reagens ili otapalo kane po instrumentu ili po priboru, obrišite ga i posušite što je prije moguće.
- Ako se takav reagens ili otapalo često koristi, obavezno svakodnevno temeljito očistite držač oštice, univerzalnu kasetnu stezaljku (UCC) i ostali pribor ako je potrebno.

1. Postavite traženu debljinu nareska odnosno provjerite postavku vrijednosti u prozoru za prikaz debljine nareska.
2. Uvijek upotrebljavajte drugo područje rezne oštice za podrezivanje i sekcioniranje. Da biste to napravili, bočno pomaknite nož u držaču noža. Kada upotrebljavate držač oštice dva u jednom E s bočnim pomakom, pomiče se cijeli gornji dio za stezanje.
3. Da biste obavili sekcioniranje, ručni kotač ravnomjerno okrenite u smjeru kazaljke na satu.

**Oprez**

Istovremeno okretanje ručnog kotača i kotača grubog umetanja.

Oštećenje uzorka.

- Nemojte okretati kotač grubog umetanja dok okrećete ručni kotač.

4. Podignite nareske, rastegnite ih i postavite na mikroskopska stakalca.

5.9 Zamjena uzorka ili prekid sekcioniranja**Upozorenje**

Ručni je kotač odbravljen i glava predmeta pada u držač noža/oštice.

Ozljede ljudi/oštećenje uzorka.

- Ručni kotač uvijek mora biti zabravljen osim u fazi sekcioniranja.

**Upozorenje**

Uzorak je orientiran u fazi retrakcije.

Oštećenje uzorka i noža/oštice zbog ponovne orientacije uzorka u fazi retrakcije.

- Blokovi uzorka ne smiju se orientirati tijekom faze retrakcije. Ako se blok orientira tijekom retrakcije, blok će se pomaknuti za vrijednost retrakcije plus debljinu odabranog nareska prije sljedećeg sekcioniranja. To može prouzročiti oštećenje uzorka i noža/oštice.

**Upozorenje**

Nož/oštica nije prekriven odgovarajućim štitnikom kada se uzorak ne sekcionira.

Ozbiljne ozljede ljudi.

- Uvijek prekrijte rub noža/oštice štitnikom noža prije rukovanja nožem/oštricom ili stezaljkom uzorka, prije zamjene sklopa uzorka i tijekom prekida u radu.



Upozorenje

Umetanje ili vađenje uzorka iz mikrotoma bez odgovarajuće odjeće i na neodgovarajući način.

Osoba koja rukuje aparatom može se porezati i ozlijediti što može imati ozbiljne posljedice.

- Uvijek upotrebljavajte rukavice otporne na rezove kada rukujete uzorkom u mikrotomu.
- Zabratite ručni kotač i prekrijte oštricu noža sigurnosnim štitnikom prije svakog rukovanja stezaljkom uzorka i prije zamjene uzorka.

1. Podignite uzorak u krajnji gornji položaj i uključite mehanizam za zabravljenje ručnog kotača.
2. Rub sekcioniranja prekrijte sigurnosnim štitnikom.
3. Uklonite uzorak iz stezaljke uzorka i postavite novi uzorak za nastavak.
4. Stezaljke uzorka s kotačem grubog umetanja pomaknite unatrag dok se novi uzorka ne počne rezati.

5.10 Završavanje dnevne rutine



Upozorenje

Ladica za otpad pri sekcioniranju pada nakon odvajanja.

Ozljede ljudi.

- Posebno pažljivo radite kada odvajate ladiciu za otpad pri sekcioniranju i stavite je na sigurno.



Upozorenje

Nož/oštrica nije skinut kada je držač noža/oštice skinut s mikrotoma.

Ozbiljne ozljede ljudi zbog doticaja s iznimno oštrim nožem/oštricom.

- Prije skidanja držača noža/oštice s mikrotoma, nož/oštricu uvijek odvojite dok nosite rukavice otporne na rezove i nož/oštricu odložite na sigurno mjesto.



Upozorenje

Nož/oštrica spremljen je na neodgovarajući način.

Ozbiljne ozljede ljudi, primjerice zbog neočekivanog pada.

- Nož/oštricu uvijek odlažite na odgovarajuće mjesto kada ih ne upotrebljavate: odložite ga, na primjer, u posebnu kutiju za noževe.
- Nož nikada nemojte postavljati s reznom oštricom okrenutom prema gore i nikada nemojte pokušati uhvatiti nož u padu.



Upozorenje

Otpad parafina pada na pod i nečisti se.

Ozbiljne ozljede ljudi, primjerice zbog zapinjanja i spoticanja o nož/oštricu.

- Uvijek očistite parafinski otpad prije no što se proširi, postane klizav i opasan.
- Nositte odgovarajuću obuću.

1. Pomaknite uzorak u krajnji gornji položaj okretanjem ručnog kotača i uključite mehanizam za zabravljenje ručnog kotača.
2. Uklonite oštricu iz držača oštice dva u jednom E i umetnite je u spremnik na dnu kutije ili izvadite nož iz držača noža i vratite ga u kutiju za noževe.
3. Uklonite uzorka iz stezaljke uzorka.
4. Pomaknite glavu predmeta u krajnji stražnji položaj ili pomaknite držač noža na postolju držača noža prema van.
5. Sve ostatke uzorka stavite u ladicu za otpad pri sekcioniranju i ispraznite ladicu.
6. Očistite aparat (→ str. 73 – 8.1 Čišćenje aparata).

6. Dodatni pribor

6.1 Sklop za pričvršćenje stezaljki uzorka



Savjeti

Osnovna verzija aparata, ovisno o narudžbenici, isporučuje se s preciznim usmjerenjem, usmjeravanjem ili krutim pričvršćenja stezaljke uzorka koji se prvi mora sastaviti. Sve stezaljke uzorka dostupne kao dodatni pribor mogu se upotrebljavati na jednom od tri pričvršćenja za stezaljke uzorka.


Prije sastavljanja pričvršćenja za stezaljke uzorka uključite mehanizam za zatravljenje ručnog kotača.

6.1.1 Kruto pričvršćenje stezaljke uzorka



Savjeti

Uklonite gumeni prsten (→ "Sl. 29-5") tek nakon pričvršćivanja glave predmeta.

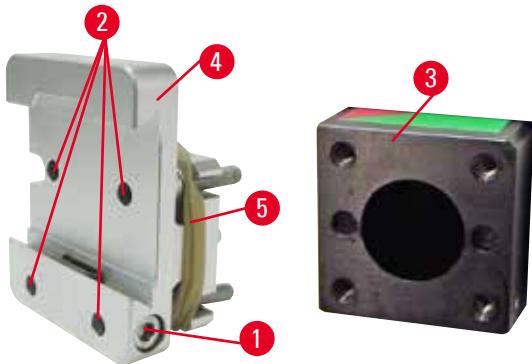


Sl. 29

Zavijte kruto pričvršćenje stezaljke uzorka (→ "Sl. 29-4") na glavu predmeta (→ "Sl. 29-3").

- Uklonite vijak (→ "Sl. 29-1"), postavite pričvršćenje stezaljke uzorka (→ "Sl. 29-4") na glavu predmeta (→ "Sl. 29-3") s prednje strane i pritegnite vijke (→ "Sl. 29-2") imbus ključem veličine 3.
- Zatim umetnite vijak (→ "Sl. 29-1") sa strane i kratko ga pritegnite imbus ključem veličine 4.


6.1.2 Pričvršćenje stezaljke uzorka s usmjerenjem

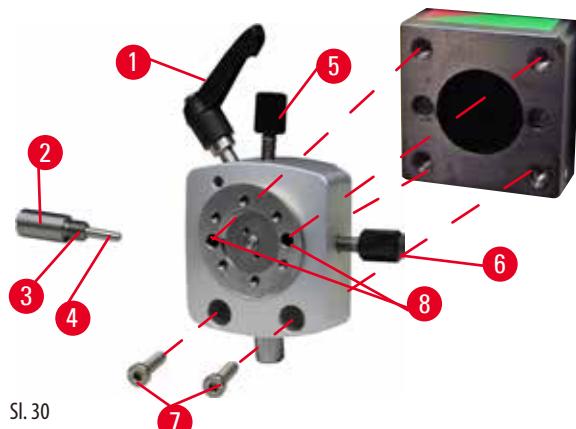

Sl. 30

- Otpustite ekscentrični vijak (→ "Sl. 30-1") tako da ga okrenete u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
- Do kraja odvijte potisni element (→ "Sl. 30-2") odvijačem s plosnatim vrhom i izvucite ga s oprugom (→ "Sl. 30-3") i zatikom (→ "Sl. 30-4").
- Do kraja odvijte navojne klinove (→ "Sl. 30-5") i (→ "Sl. 30-6").
- Umetnute pričvršćenje stezaljki uzorka s usmjerenjem tako da pritegnete vijke u provrtima (→ "Sl. 30-8") (2 su vijka dostupna kroz provrte) pomoću imbus ključa veličine 3. Umetnute vijke (→ "Sl. 30-7") u provrte kao što je prikazano i zavijte ih imbus ključem veličine 3.
- Umetnute oprugu (→ "Sl. 30-3") i zatik (→ "Sl. 30-4") s plosnatim dijelom u potisnom elementu (→ "Sl. 30-2"). Do kraja zavijte potisni element plosnatim odvijačem.
- Do kraja zavijte navojne klinove (→ "Sl. 30-5") (→ "Sl. 30-6").

6.1.3 Pričvršćenje stezaljki uzorka s preciznim usmjeravanjem

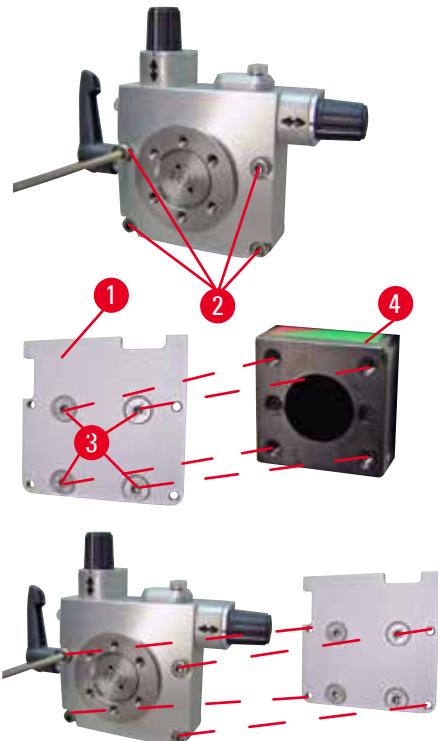

Sl. 31


- Prije no što se može postaviti pričvršćenje stezaljki uzorka s preciznim usmjeravanjem, otpustite 4 vijka (→ "Sl. 31-2") (imbus ključ veličine 3) i pažljivo uklonite pričvršćenje stezaljki uzorka s preciznim usmjeravanjem s podnožja (→ "Sl. 31-1").
- Pomoću 4 isporučena vijka (→ "Sl. 31-3") i imbus ključa veličine 3, pričvrstite podnožje na glavu predmeta (→ "Sl. 31-4").
- Sada, zavijte pričvršćenje stezaljki uzorka s preciznim usmjeravanjem pomoću 4 vijka (→ "Sl. 31-2") i imbus ključa veličine 3 na glavu predmeta.



Savjeti

Ako se pričvršćenje stezaljke uzorka s preciznim usmjeravanjem ne upotrebljava, sačuvajte podnožje (→ "Sl. 31-1") i 4 vijka (→ "Sl. 31-3") skupa s pričvršćenjem stezaljke uzorka s preciznim usmjeravanjem.

6.1.4 Brostezni sustav

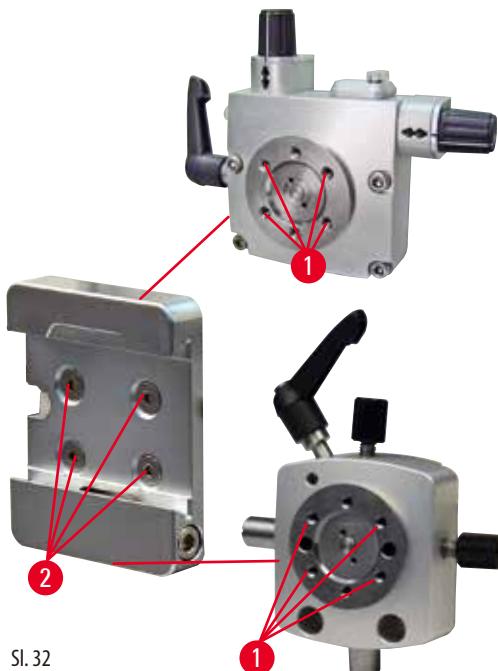

Upotrebljava se kao adapter za upotrebu s pričvršćenjem stezaljke uzorka s preciznim usmjeravanjem s indikatorima nulte točke ili pričvršćenjem stezaljke uzorka s usmjeravanjem.

Zavijte 4 vijka (→ "Sl. 32-2") u provrt (→ "Sl. 32-1") imbus ključem veličine 2,5 i pritegnite ih.


6.2 Stezaljke uzorka i držači



Savjeti

Sve stezaljke uzorka dostupne kao dodatni pribor mogu se ugraditi u pričvršćenja držača uzorka s preciznim usmjeravanje, usmjeravanjem ili bez usmjeravanja. Način postavljanja stezaljki i držača uzorka potražite u dijelu (→ str. 36 – 5.4 Umetanje univerzalne kasetne stezaljke).

6.2.1 Standardna stezaljka uzorka

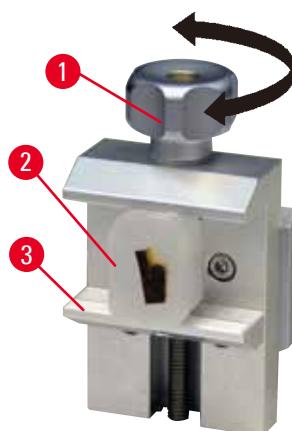

Sl. 33

Standardna stezaljka uzorka dostupna je u dvije veličine: 40 x 40 mm i 50 x 55 mm. Napravljene su za izravno zatezanje četvrtastih sklopova. Osim toga, u njima se nalazi stezaljka za foliju i umetak u obliku slova V.

- Okrenite narovašeni vijak (→ "Sl. 33-1") u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste pomični škripac (→ "Sl. 33-3") pomaknuli prema dolje.
- Uzorak (→ "Sl. 33-2") postavite na pravilan način.
- Okrenite narovašeni vijak (→ "Sl. 33-1") u smjeru kazaljke na satu tako da pomični škripac pomaknete prema gore na fiksni škripac da biste sigurno zategnuli uzorak.




Upozorenje

Nedovoljni uvjeti okvira za sekcioniranje.

Oštećenje uzorka ili loši rezultati sekcioniranja, na primjer rezovi promjenjive debljine, sabijeni, preklopjeni ili ogoljeni rezovi.

- Nemojte nastaviti sa sekcioniranjem ako utvrdite nezadovoljavajuće rezultate sekcioniranja.
- Provjerite jesu li ispunjeni svi preduvjeti za odgovarajuće sekcioniranje. Dodatne pojedinosti potražite u dijelu o uklanjanju pogrešaka ovih uputa za upotrebu.
- Ako nemate dovoljno znanja o rješavanju pogreške nedovoljnih rezultata sekcioniranja, obratite se osobama koje to znaju, na primjer stručnjacima tvrtke Leica Biosystems.

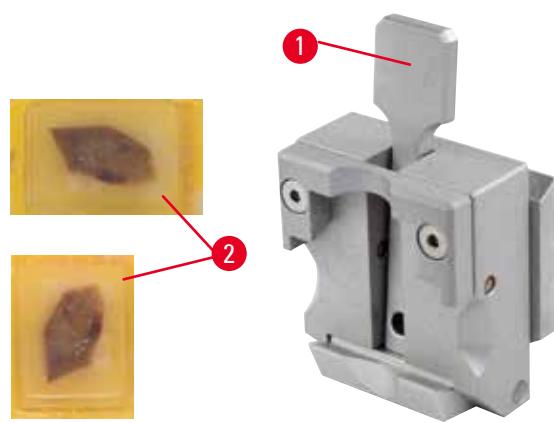

Sl. 34

Kasete Surgipath s minimalnim dimenzijama od 39,8 x 28 mm i maksimalnim dimenzijama od 40,9 x 28 mm mogu se okomito i vodoravno zategnuti na univerzalnu kasetnu stezaljku (UCC).

- Ručicu (["Sl. 34-1"](#)) povucite prema osobi koja upravlja alatom.
- Kasetu (["Sl. 34-2"](#)) postavite vodoravno ili okomito, prema potrebi.
- Da biste zategnuli kasetu, otpustite ručicu (["Sl. 34-1"](#)).



Upozorenje

Nedovoljni uvjeti okvira za sekcioniranje.

Oštećenje uzorka ili loši rezultati sekcioniranja, na primjer rezovi promjenjive debljine, sabijeni, preklopjeni ili ogoljeni rezovi.

- Nemojte nastaviti sa sekcioniranjem ako utvrdite nezadovoljavajuće rezultate sekcioniranja.
- Provjerite jesu li ispunjeni svi preduvjeti za odgovarajuće sekcioniranje. Dodatne pojedinosti potražite u dijelu o uklanjanju pogrešaka ovih uputa za upotrebu.
- Ako nemate dovoljno znanja o rješavanju pogreške nedovoljnih rezultata sekcioniranja, obratite se osobama koje to znaju, na primjer stručnjacima tvrtke Leica Biosystems.



Upozorenje

Preostali puknuti rub poklopca kasete mogao bi dovesti do loše kvalitete nareska zbog nedovoljnog zatezanja.

Ozbiljne ozljede ljudi.

- Kada upotrebljavate kasetu s oblikovanim poklopcom, pazite da puknuti rub koji nastaje prilikom skidanja poklopca ne onemoguće sigurno zatezanje uzorka. U tom slučaju, ako je potrebno, uzorak zategnite u vodoravnom položaju.

**Oprez**

Kada upotrebljavate kasete s tankom stijenkom, kasete se mogu iskriviti, slabo zategnuti ili se mogu pojaviti neki drugi problemi zbog sustava zatezanja.

Oštećenje uzorka/kašnjenje kod postavljanja dijagnoze.


- Budite oprezni prilikom upotrebe kasete s tankom stijenkom. Provjerite jesu li kasete s tankom stijenkom sigurno zategnute.
- Ako korisnik pokušava zategnuti kasetu i primijeti da nije sigurno zategnuta, treba upotrijebiti neku čvršću kasetu.

**Oprez**

Ostaci parafina s vanjske strane kasete mogu zaprljati univerzalnu kasetnu stezaljku.

Prljavština narušava stabilno stezanje kazete i može dovesti do debelo-tankih rezova, drhtaja unutar reza, a u najgorem slučaju do oštećenja uzorka.

- Korisnik prije rezanja mora provjeriti stabilno učvršćenje uzorka.
- Uklonite zalijepljeni parafin s univerzalne kasetne stezaljke.

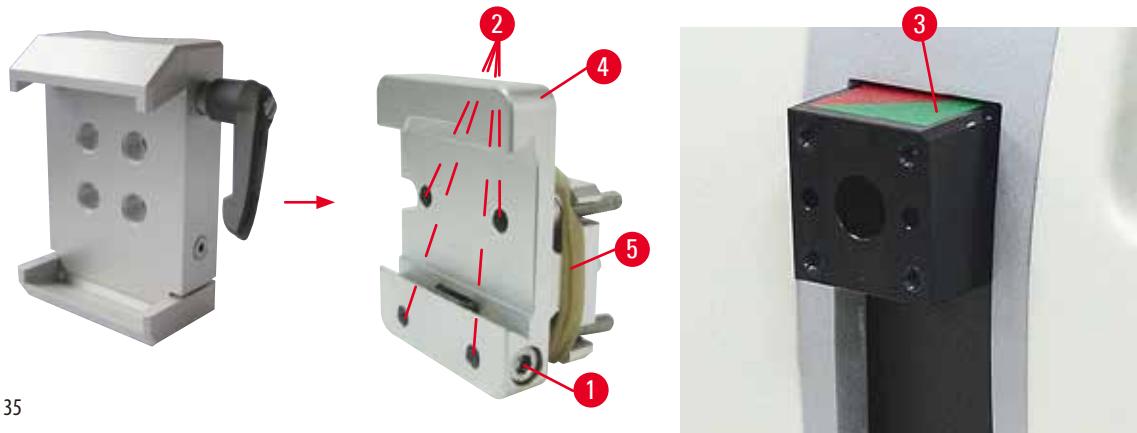6.2.3 Super velika kasetna stezaljka**Sastavljanje super velike kasetne stezaljke****Savjeti**

Gumeni prsten ([→ "Sl. 35-5"](#)) skinite tek nakon pričvršćivanja krutog pričvršćenja stezaljke uzorka na glavu predmeta.

Super velika kasetna stezaljka treba se, po mogućnosti, upotrebljavati s krutim pričvršćenjem stezaljke uzorka.

Za postavljanje aparata učinite sljedeće:

- Zavijte kruto pričvršćenje stezaljke uzorka ([→ "Sl. 35-4"](#)) na glavu predmeta ([→ "Sl. 35-3"](#)): Skinite vijak ([→ "Sl. 35-1"](#)), postavite kruto pričvršćenje stezaljke uzorka ([→ "Sl. 35-4"](#)) na glavu predmeta ([→ "Sl. 35-3"](#)) s prednje strane i pritegnite vijke ([→ "Sl. 35-2"](#)) imbus ključem veličine 3. Zatim umetnite vijak ([→ "Sl. 35-1"](#)) sa strane i malo pritegnite imbus ključem veličine 4.
- Umetnute super veliku kasetnu stezaljku s lijeve strane, na vodilicu lastin rep krutog pričvršćenja stezaljke uzorka i pritegnite vijak ([→ "Sl. 35-1"](#)).

**Oprez**

Kada upotrebljavate super veliku kasetnu stezaljku, orientacija nije postavljena u položaj "0" kada se pričvršćenje stezaljke uzorka s preciznim usmjeravanjem upotrebljava s krutim postoljem držača noža ili kada je pričvršćeno pozadinsko osvjetljenje.


Aparat možda neće pravilno raditi što može dovesti do kašnjenja kod postavljanja dijagnoze.

- Orientacija mora biti postavljena u položaj "0" i mora se otkvacići pokrov pozadinskog osvjetljenja.
- NIKADA nemojte upotrebljavati super veliku kasetnu stezaljku s pozadinskom osvjetljenjem.
- Sustav ravnoteže sila ne može se namjestiti kada se upotrebljava super velika kasetna stezaljka.

6.3 Podnožje držača noža i držač noža

Sl. 36

Plastične ručice svih steznih polugica aparata i držača noževa mogu se okrenuti u korisniku najpraktičniji položaj. Izvucite dršku (→ "Sl. 36-1") iz polugice, zadržite je u tom položaju i okrenite u željeni položaj. Automatski će se zabraviti kada se otpusti.

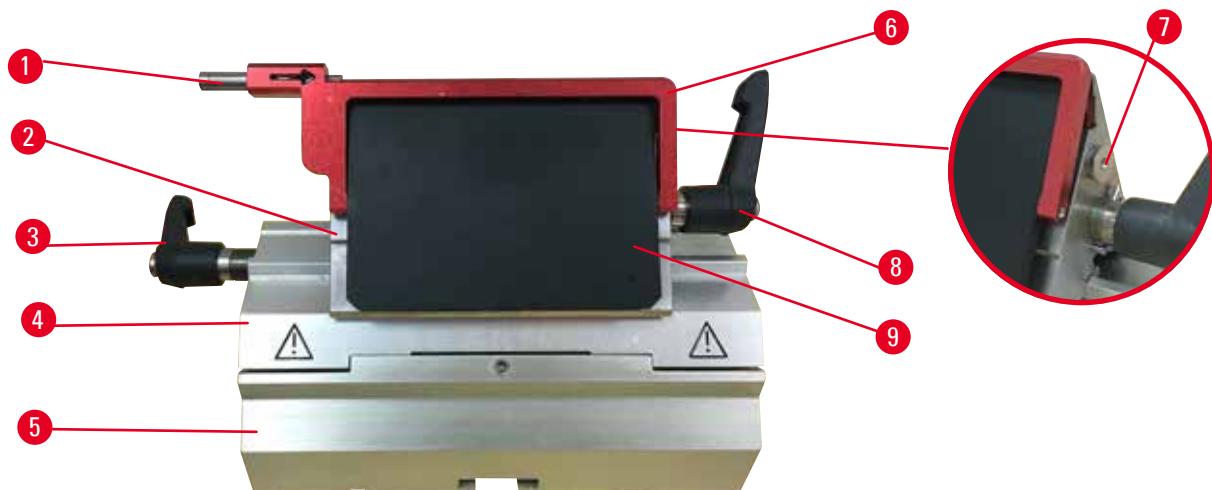6.3.1 Držač oštice dva u jednom E

Sl. 37


1	Mehanizam za izbacivanje oštice	6	Sigurnosni štitnik
2	Stezni vrh	7	Vijak
3	Stezna polugica (lijeva)	8	Stezna polugica (desna)
4	Luk segmenta	9	Potisna ploča
5	Postolje držača oštice		

Držač oštice dva u jednom E napravljen je za uobičajene oštice koje se mogu skinuti i optimiziran je za upotrebu s oštricama koje se mogu skinuti Surgipath. Može se upotrebljavati za visoko i niskoprofilne oštice koje se mogu skinuti. Držač oštice dva u jednom E opremljen je funkcijom bočnog pomicanja tako da se može upotrijebiti cijela širina oštice. Opremljen je i mehanizmom za izbacivanje oštice za sigurno uklanjanje oštice nakon upotrebe. Potisna je ploča zamjenjiva.

**Savjeti**

Stezne polugice na držaču oštice dva u jednom E ne mogu se međusobno zamjenjivati. Dvije stezne polugice (→ "Sl. 37-8") (→ "Sl. 37-3") cijelo vrijeme moraju ostati u prikazanom položaju jer u protivnom može doći do izoliranih neispravnosti držača oštice dva u jednom E.

Stezna polugica za oštricu (→ "Sl. 37-8") nalazi se s desne strane, a ona za bočno pomicanje (→ "Sl. 37-3") s lijeve strane.

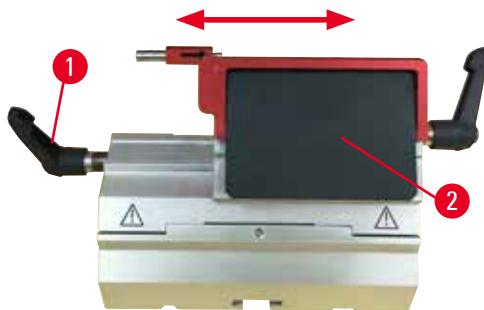

Sl. 38

Bočno pomicanje

Značajka bočnog pomicanja držača oštice dva u jednom E omogućuje upotrebu cijele duljine oštice bočnim pomicanjem steznog vrha. Tri unaprijed određena položaja zaustavljanja (lijevi, središnji, desni) koja odgovaraju širini standardne kasete mogu se upotrebljavati prema želji.

- Da biste otpustili zatezanje, ručicu (→ "Sl. 38-1") okrenite na lijevu stranu držača oštice dva u jednom E u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
- Bočno pomaknite stezni vrh (→ "Sl. 38-2").
- Da biste zategnuli, polugicu (→ "Sl. 38-1") okrenite u smjeru kazaljke na satu.

6.3.2 Postolje držača noža bez značajke bočnog pomicanja

Sl. 39

Premještanje postolja držača noža

Jednodijelno postolje držača noža (kruto) (→ "Sl. 39-2") može se pomicati prema naprijed i unatrag na podnožju mikrotoma. To okomito pomicanje omogućuje postavljanje držača noža u optimalan položaj rezanja uzorka.

- Da biste otpustili, okrenite steznu polugicu (→ "Sl. 39-1") na desnu stranu podnožja mikrotoma u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
- Premjestite držač noža zajedno s postoljem držača noža prema naprijed ili unatrag, prema potrebi.
- Učvrstite stezni mehanizam okrećući polugicu (→ "Sl. 39-1") u smjeru kazaljke na satu.

6.3.3 Držač noža E s koritom za vodu za niskoprofilne oštice



Sl. 40

Držač noža E s koritom za vodu (→ "Sl. 40") namijenjen je isključivo za niskoprofilne oštice.


Sigurnosni štitnik na držaču noža E sastoji se od crvene sklopive ručice (→ "Sl. 40-1"). Da biste prekrili reznu oštricu, preklopite ručicu sigurnosnog štitnika (→ "Sl. 40-1") u smjeru kazaljke na satu kao što je prikazano na slici.



Savjeti

Stezne polugice na držaču noža ne mogu se međusobno zamjenjivati. Dvije stezne polugice (→ "Sl. 40-2") (→ "Sl. 40-3") cijelo vrijeme moraju ostati u prikazanom položaju jer u protivnom može doći do izoliranih neispravnosti držača noža.

Stezna polugica za oštricu (→ "Sl. 40-2") nalazi se s desne strane, a ona za bočno pomicanje (→ "Sl. 40-3") s lijeve strane.

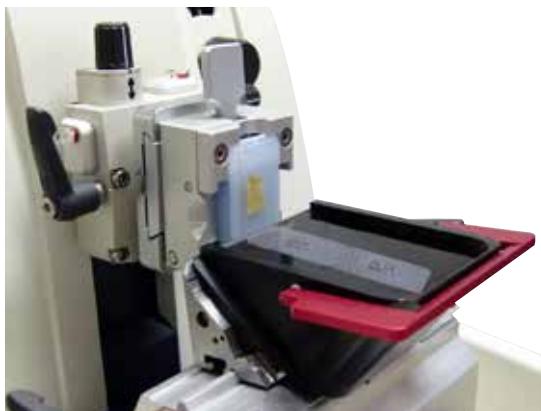

Sl. 41


Upotreba

Plutajući tanki parafinski naresci (na primjer za naknadne postupke imunohistokemijskog bojenja) na površini vode. Posuda je do oštice napunjena destiliranom ili deioniziranom vodom. Nakon podrezivanja uklonite otpad sekcioniranja iz posude i stvorite nareske koje treba pripremiti. Naresci koji plutaju na površini vode mogu se prikupite pomoću stakalca.

6.3.4 Držač noža N

Držač noža N prikladan je za standardne čelične noževe, profila c i d, duljine do 16 cm. Ugrađena značajka podešavanja prema visini omogućuje upotrebu noževa koji više puta oštreni.

- Držač noža N (→ "Sl. 42"): za uobičajene noževe duljine do 16 cm.

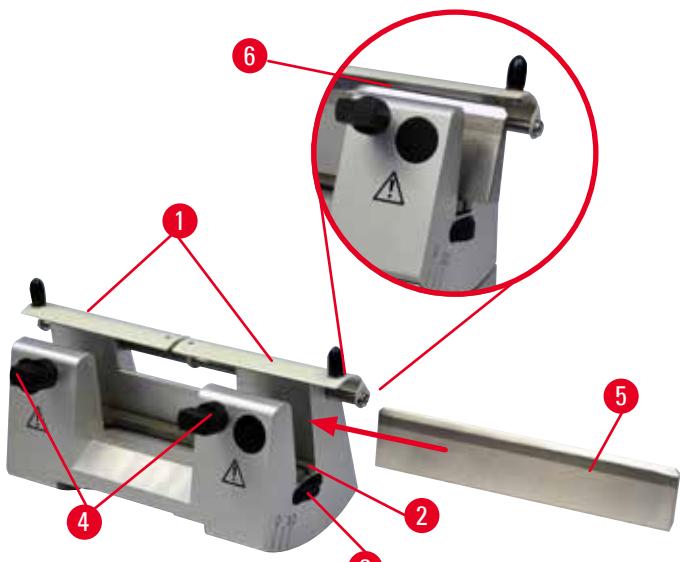

Sl. 42

Postavljanje potporne šipke noža

- Gurnite sigurnosni štitnik (→ "Sl. 42-1") u središte.
- Postavite potpornu šipku noža (→ "Sl. 42-2") na vijke za podešavanje prema visini. Plosnati vrhovi vijaka za podešavanje prema visini moraju se nalaziti u utorima na svakom kraju potporne šipke noža.



Upozorenje

Nož/oštrica postavljen je prije no što su držač noža/oštrice i postolje držača noža/oštice postavljeni na aparat.

Ozbiljne ozljede ljudi zbog doticaja s iznimno oštrim noževima i/ili oštricama.

- Prije umetanja noža/oštice, držač noža/oštice i postolje držača noža/oštice moraju se postaviti na mikrotom.

Umetanje noža

- Okrećite narovašene maticе (→ "Sl. 42-3") s lijeve i desne strane držača noža prema naprijed u suprotnom smjeru, spuštajući potpornu šipku noža u najniži mogući položaj čime osiguravate da se rub noža neće oštetiti prilikom umetanja noža.
- Odvijte stezne vijke (→ "Sl. 42-4") (okrećite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu) sve dok se nož ne može umetnuti.
- Držite nož (→ "Sl. 42-5") na postolju noža i pažljivo ga sa strane umetnite u držač, kao što je prikazano s reznom oštricom okrenutom prema gore.



Sl. 43

Svaka strana noža profila c (→ "Sl. 43-1") može se umetnuti, a kada se radi o nožu profila d, (→ "Sl. 43-2") izbrušena strana treba biti okrenuta prema osobi koja upravlja alatom. Nepravilno postavljanje noža oštetit će uzorak i nož.

Namještanje visine noža

Kada se namješta visina noža, rub noža treba biti što preciznije postaviti u središte okretanja držača noža. Rub za oslanjanje (→ "Sl. 42-6") stražnjih steznih glava služi kao referentni položaj za namještanje visine noža.

- Ravnomjerno okrećite narovašene matice (→ "Sl. 42-3") i unatrag sve dok oštrica noža ne postane paralelna s oznakama na rubovima za oslanjanje (→ "Sl. 42-6") stražnjih steznih glava.
- Da biste zategnuli nož (→ "Sl. 42-5"), ravnomjerno zavijte dva stezna vijka noža (→ "Sl. 42-4") prema unutra (okrećite u smjeru kazaljke na satu).

Bočno premještanje noža

- Gurnite sigurnosni štitnik (→ "Sl. 42-1") u središte.
- Otpustite stezne vijke (→ "Sl. 42-4") tako da ih okreće u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
- Nož (→ "Sl. 42-5") gurnite u lijevo odnosno u desno, kako je propisano.
- Kada se nož premjesti, namjestite visinu noža (→ str. 53 – Namještanje visine noža) i zatim pritegnite stezni vijak (→ "Sl. 42-4") koji se nalazi sa strane tako da ga okrećete u smjeru kazaljke na satu da biste zategnuli nož (→ "Sl. 42-5").



Oprez

Nakon što se držač oštice/noža bočno pomakne, uzorak nije povučen ni ponovno podrezan.

Oštećenje uzorka.

- Povucite glavu predmeta i ponovno podrežite sklop uzorka svaki puta nakon bočnog pomicanja držača oštice/noža.

6.4 Ladica za otpad pri sekcioniranju



Sl. 44

Antistatička ladica za otpad pri sekcioniranju lako se čisti zahvaljujući antistatičkoj površini.

Gurnite ladicu za otpad pri sekcioniranju (→ "Sl. 44-1") s prednje strane podnožja mikrotoma (→ "Sl. 44-2") sve dok je na mjestu ne zadrže dva magneta (→ "Sl. 44-3") (na prednjem dijelu podnožja mikrotoma).


6.5 Pozadinsko osvjetljenje



Savjeti

Pozadinsko osvjetljenje ne može se upotrebljavati s postoljem držača noževa držača noževa dva u jednom E.

Za upotrebu s pozadinskim osvjetljenjem na aparatu HistoCore BIOCUT, jedinica vanjskog napajanja (br. narudžbe: 14038631352) mora se posebno naručiti.

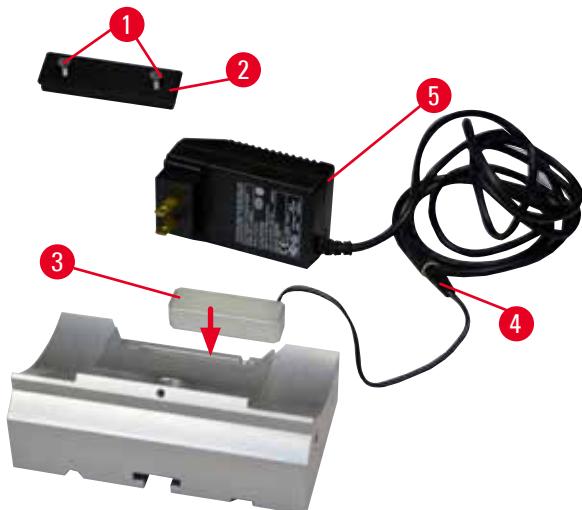

Sl. 45

- Uklonite dva vijka (→ "Sl. 45-1") pomoću odvijača s utorom i zatim skinite pokrovnu ploču (→ "Sl. 45-2").
- Pozadinsko osvjetljenje (→ "Sl. 45-3") umetnите u utor na stražnjem dijelu postola držača noževa.
- Spojite utikač (→ "Sl. 45-4") pozadinskog osvjetljenja u utičnicu jedinice napajanja (→ "Sl. 45-5").



Oprez

Kada upotrebljavate super veliku kasetnu stezaljku, orientacija nije postavljena u položaj "0" kada se pričvršćenje stezaljke uzorka s preciznim usmjeravanjem upotrebljava s krutim postoljem držača noža ili kada je pričvršćeno pozadinsko osvjetljenje.

Aparat možda neće pravilno raditi što može dovesti do kašnjenja kod postavljanja dijagnoze.

- Orientacija mora biti postavljena u položaj "0" i mora se otkvatići pokrov pozadinskog osvjetljenja.
- NIKADA nemojte upotrebljavati super veliku kasetnu stezaljku s pozadinskom osvjetljenjem.
- Sustav ravnoteže sila ne može se namjestiti kada se upotrebljava super velika kasetna stezaljka.

6.6 Gornja ladica



Sl. 46

Gornja se ladica postavlja na poklopac miktoroma. Oznaka (→ "Sl. 46-1") na gornjoj ladici i poklopcu olakšava orijentaciju gornje ladice.


Gornja ladica služi za odlaganje pribora tijekom sekcioniranja i za sekcionirane uzorke.

6.7 Univerzalni nosač mikroskopa




Savjeti

Raspakirajte sav dodatni pribor iz pakiranja i provjerite jesu li kompletni.

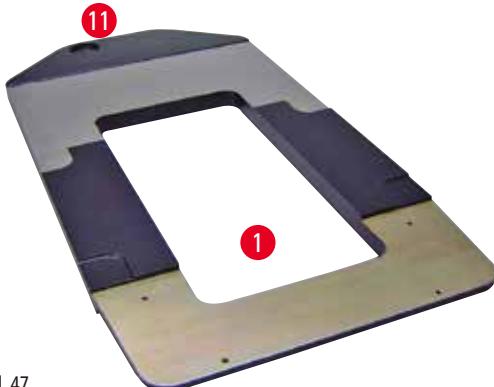

Sl. 47

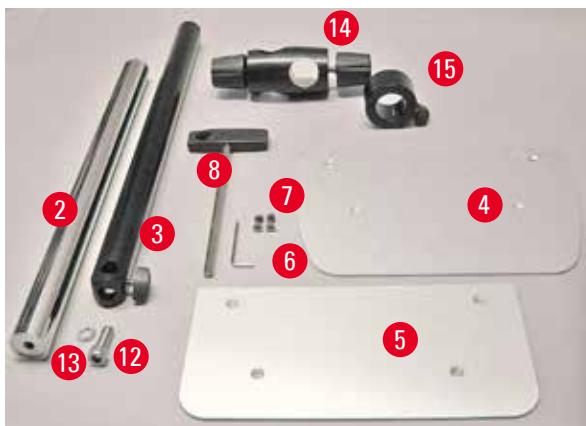

Sl. 48



Sl. 49

- (→ "Sl. 47-1"), Podnožje s bušilicom (→ "Sl. 47-11")
- (→ "Sl. 48-2"), Okomiti stup s vijkom s kapicom veličine 8 (→ "Sl. 48-12") i nazubljenom opružnom podloškom (→ "Sl. 48-13")
- (→ "Sl. 48-3"), Vodoravni kraj s poprečnim nosačem (→ "Sl. 48-14") i potpornim prstenom (→ "Sl. 48-15")
- (→ "Sl. 48-4"), Potporna ploča, velika (za BIOCUT, MULTICUT i AUTOCUT)
- (→ "Sl. 48-5"), Potporna ploča, mala (za NANOCUT R)
- (→ "Sl. 48-6"), Imbus ključ veličine 3
- (→ "Sl. 48-7"), 4 vijka s upuštenom glavom za postavljanje potporne ploče
- (→ "Sl. 48-8"), Imbus ključ veličine 8


Sastavljanje univerzalnog nosača mikroskopa

- Pričvrstite postolje. Odaberite veliku (→ "Sl. 48-5") ili malu (→ "Sl. 48-4") potpornu ploču, ovisno o vrsti mikrotoma koja će se upotrebljavati. Pričvrstite potpornu ploču na postolje s 4 uključena vijka s upuštenom glavom (→ "Sl. 48-7") pomoću imbus ključa veličine 3 (→ "Sl. 48-6").



Sl. 50

- Pričvrstite okomiti stup. Vijak s kapicom (→ "Sl. 50-12") umetnите odozdo u otvor postolja. Nazubljenu opružnu podlošku (→ "Sl. 50-13") postavite odozgo na vijak s kapicom. Navijte srebrni okomiti stup (→ "Sl. 51-2") na postolje odozgo i zategnite imbus ključem veličine 8.

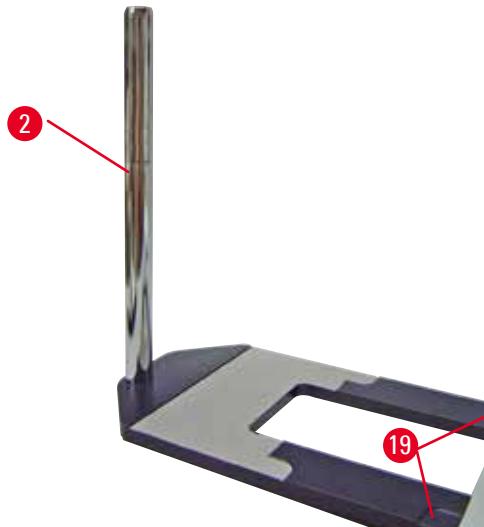

Sl. 51



Upozorenje

Savjeti za univerzalni nosač mikroskopa.


Ozbiljne ozljede ljudi.

- Nakon postavljanja okomitog stupa, mikrotom odmah postavite na podnožje tako da je prednja nožica mikrotoma u plitkim utorima (→ "Sl. 51-19").



Savjeti

Nazubljena opružna podloška mora se postaviti između podnožja i okomitog stupa kako bi se spriječilo nehotično okretanje stupa.

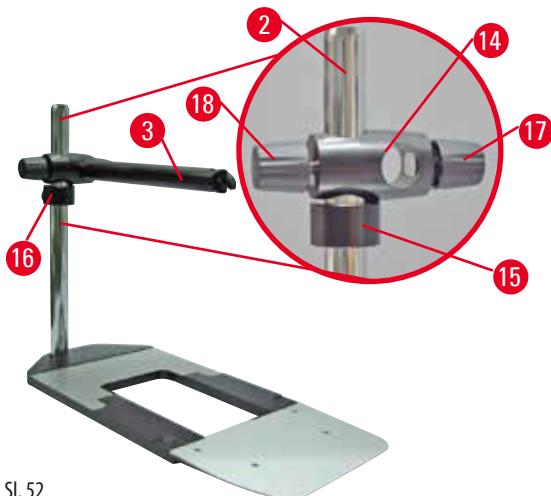

Sl. 52

- Pričvrstite vodoravni krak. Klizno pomaknite potporni prsten (["Sl. 52-15"](#)) na okomiti stup i postavite ga tako da je samokočiva matica (["Sl. 52-16"](#)) okrenuta prema stražnjem dijelu. Pritegnite samokočivu maticu. Klizno pomaknite poprečni nosač (["Sl. 52-14"](#)) na stup. Provjerite je li vijak za zabravljenje (["Sl. 52-17"](#)) okrenut prema desnoj strani podnožja. Vodoravni krak mora biti centriran preko mikroskopa. Klizno pomaknite vodoravni krak (["Sl. 52-3"](#)), s plosnatom stranom prema vijke za zabravljenje (["Sl. 52-17"](#)), na poprečni nosač (["Sl. 52-14"](#)) i pritegnite.

**Savjeti**

Više informacija o priključivanju i upotrebi mikroskopa, povećalima ili izvoru hladnog svjetla potražite u odgovarajućim uputama za upotrebu.

6.8 Povećalo, LED-osvjetljenje**Savjeti**


Povećala omogućuju dvostruko povećanje i mogu se upotrebljavati sa svim rotacijskim mikrotomima serije HistoCore.



Sl. 53

- Odvijte vijak (["Sl. 53-3"](#)) na vodoravnom kraku nosača mikroskopa u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
- Umetnute srebrni spojni dio (["Sl. 53-1"](#)) koliko je moguće. Pritegnite vijak (["Sl. 53-3"](#)).

- Adapter (→ "Sl. 53-2") omogućuje postavljanje LED-reflektora Hi-power. Priklučite LED-reflektore 1000 Hi-Power, s 2 kraka, u adapter (→ "Sl. 54"). Priklučite utikače (→ "Sl. 54-1") LED-reflektora 1000 Hi-Power, s 2 kraka, u ute (→ "Sl. 54-2") visokostrujnoga kontrolera za reflektore (→ "Sl. 54-3"). Priklučite adapter za napajanje (→ "Sl. 54-4") kontrolne jedinice LED-reflektora 1000 na visokostrujni kontroler za reflektore, potom ga priključite na strujnu mrežu. Provjerite jeste li među isporučenima odabrali ispravni utikač (→ "Sl. 54-5") s obzirom na strujni adapter za vašu regiju.
- Pritisnite tipku (→ "Sl. 54-7") na visokostrujnom kontroleru za reflektore kako biste upalili ili ugasili dva reflektora (→ "Sl. 54-6"), što će biti naznačeno i dvama zelenim svjetlima (→ "Sl. 54-8") na visokostrujnom kontroleru za reflektore. Okrenite kontrolni kotač (→ "Sl. 54-9") kako biste prilagodili intenzitet svjetlosti reflektora.

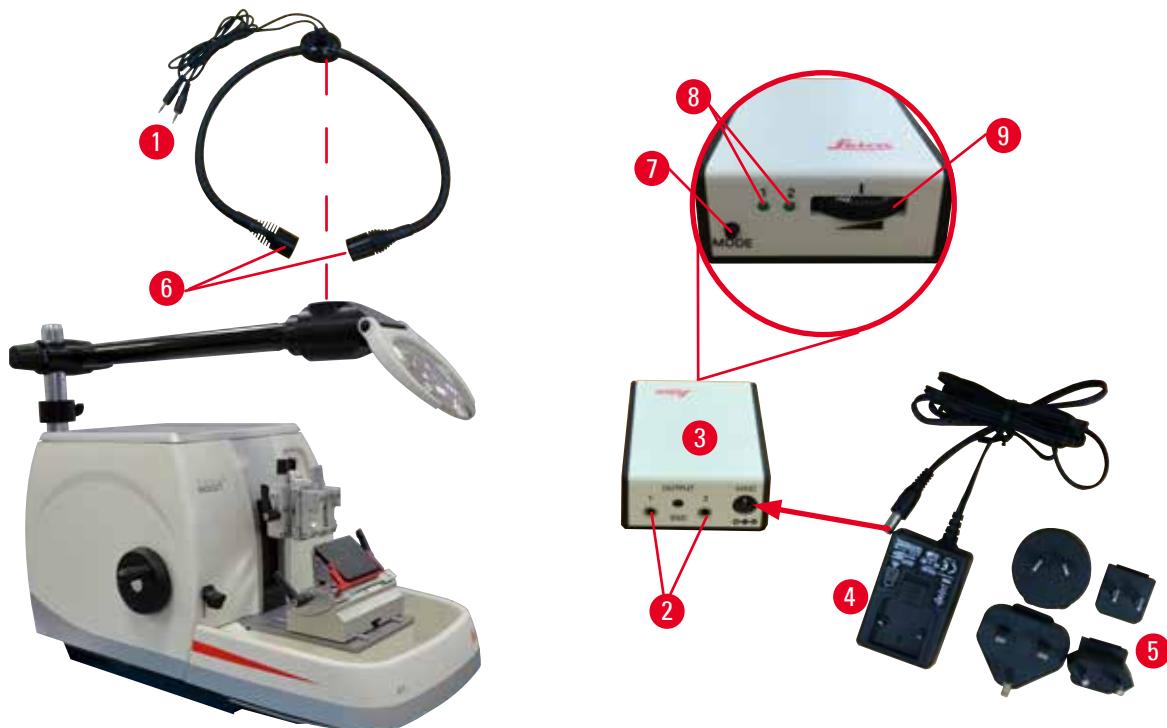

Sl. 54

- Namjestite položaj povećala prema uzorku koji se obrađuje. Povećala se mogu do kraja zakrenuti u stranu, ako je potrebno.



Upozorenje

Povećalo nije pokriveno kada radite s njim.

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine zbog efekta leće. Povećalo može izazvati požar na okolnim predmetima posebice ako je izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti.

- Povećalo uvijek prekrijte kada ne radite s njim.
- Posebice ga zaštite od izlaganja izravnoj sunčevoj svjetlosti.

- Upotrijebite isporučeni zaštitni pokrov (→ "Sl. 53-4") da biste prekrili povećala.

6.9 Dodatni pribor

Postolje držača noža koje se ne može usmjeravati



Sl. 55

Srebrno za držače noževa N, držač noževa E s kanalom

- Br. narudžbe: 14 0502 37962



Sl. 56

Srebrni, za uobičajene noževe duljine do 16 cm

Namještanje visine noža

Podešavanje kutnog zazora odvajanja

Pomični sigurnosni štitnik

- Br. narudžbe: 14 0502 37993

Držač noža E s kanalom



Sl. 57

za niskoprofilne oštice koje se mogu skinuti, (80 x 8 x 0,25 mm), srebrni, s koritom za vodu

Brzostezni sustav s mogućnosti bočnog prebacivanja steznog vrha
Graničnik s klikom u 3 položaja olakšava upotrebu cijele duljine
oštice

Sklopivi sigurnosni štitnik s oznakom u boji

- Br. narudžbe: 14 0502 38961

Postolje držača oštice za držač oštice dva u jednom E

Sl. 58

Postolje držača oštice za držač oštice dva u jednom E

- Br. narudžbe: 14 0502 55546

Držač oštice dva u jednom E

Sl. 59

za visoko i niskoprofilne oštice koje se mogu skidati
za HistoCore BIOCUT
mogućnost bočnog prebacivanja steznog vrha
Graničnik s klikom u 3 položaja olakšava upotrebu cijele duljine
oštice
Potisna je ploča zamjenjiva
Sklopivi sigurnosni štitnik s oznakom u boji
s mehanizmom za izbacivanje oštice

- Br. narudžbe: 14 0502 54497

Oštice koje se mogu skidati — niskoprofilne (819)

Sl. 60

80 x 8 x 0,25 mm


- 01 paket od 50 kom.: 14 0358 38925
- 10 paketa od 50 kom.: 14 0358 38382

Oštice koje se mogu skidati — visokoprofilne (818)

Sl. 61

80 x 14 x 0,35 mm

- 01 paket od 50 kom.: 14 0358 38926
- 10 paketa od 50 kom.: 14 0358 38383

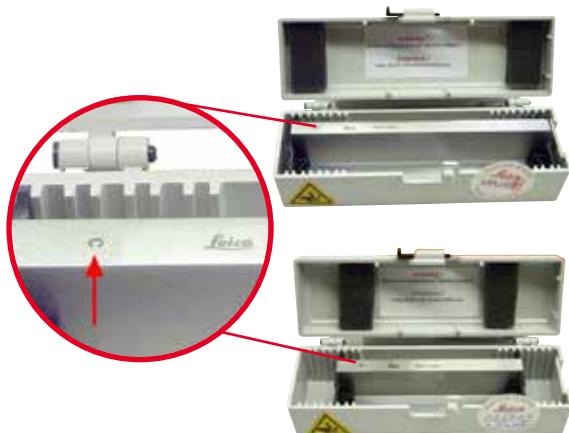Nož od 16 cm – profil c – čelični, Nož od 16 cm – profil d – čelični

Sl. 62

Nož, duljine 16 cm, profil c

Napomena: uključuju kutiju za nož 14 0213 11140

- Br. narudžbe: 14 0216 07100

Nož, duljine 16 cm, profil d

Napomena: uključuju kutiju za nož 14 0213 11140

- Br. narudžbe: 14 0216 07132

Kutija za nož

Sl. 63

Varijabilna kutija za noževe (plastična), za 1 ili 2 noža: duljine 10 – 16 cm

- Br. narudžbe: 14 0213 11140

Univerzalna kasetna stezaljka

Sl. 64

s adapterom, srebrna

Za upotrebu sa standardnim kasetama s dimenzijama od minimalno 39,8 x 28 x 5,8 mm i maksimalno 40,9 x 28,8 x 6,2 mm.

- Br. narudžbe: 14 0502 37999

Standardna stezaljka uzorka

Sl. 65

50 x 55 mm, s adapterom, srebrna

- Br. narudžbe: 14 0502 38005

Standardna stezaljka uzorka

Sl. 66

40 x 40 mm, s adapterom, srebrna

- Br. narudžbe: 14 0502 37998

Pričvršćenje držača uzorka, s usmjeravanjem

Sl. 67

Srebrno, uključujući dijelove za postavljanje.

Napomena: Brzostezni sustav 14 0502 37718 mora se posebno naručiti.

- Br. narudžbe: 14 0502 38949

Pričvršćenje držača uzorka, bez usmjerenja

Sl. 68

Srebrni, za različite stezaljke uzroka, pogledajte
(→ str. 44 – 6. Dodatni pribor), uključujući opremu za
postavljanje

- Br. narudžbe: 14 0502 38160

Pričvršćenje držača uzorka, s preciznom usmjerenjem

Sl. 69

Srebrni, s 2 indikatora nulte točke, orijentacijom XY od 8° po
smjeru, graničnicima s klikom svaka 2°
Napomena: Brzostezni sustav 14 0502 37718 mora se posebno
naručiti.

- Br. narudžbe: 14 0502 37717

Brzostezni sustav

Sl. 70

za držać uzorka koji se upotrebljava se s pričvršćenjem
stezaljke uzorka s preciznim usmjerenjem s indikatorima
nulte točke 14 0502 37717 ili pričvršćenjem stezaljke uzorka
s usmjerenjem. 14 0502 38949

- Br. narudžbe: 14 0502 37718

Super velika kasetna stezaljka

Sl. 71

s adapterom, srebrna

Napomena:

upotrebljava se jedino s pričvršćenjem držača uzorka koje se ne može usmjeravati 14 0502 38160, koje treba posebno naručiti. Pozadinsko osvjetljenje 14 0502 38719 ne može se upotrebljavati sa super velikom kasetnom stezaljkom.

Preporučujemo upotrebljavati sa super velikim kasetama i pokrovima Surgipath, bijelim (VSP 59060B-BX, VSP 59060-CS) metalni kalupima za umetanje Super (VSP58166) (DxŠxV) 75 x 52 x 35 mm

- Br. narudžbe: 14 0502 38967

Stezaljka RM CoolClamp

Sl. 72

Univerzalna kasetna stezaljka s električnim hlađenjem s adapterom za rotacijske mikrotome HistoCore. Za upotrebu sa standardnim kasetama s dimenzijama od minimalno 39,8 x 28 mm i maksimalno 40,9 x 28 mm.

Ravnomjerno sekcioniranje mikrotoma zahvaljujući električnom hlađenju univerzalne kasetne stezaljke pomoću stezaljke RM CoolClamp. Štedi energiju hlađenje pomoću sustava za rasipanje topline.

Patentirani sustav ravnoteže sila rotacijskih mikrotoma HistoCore omogućuje brzu i pouzdanu zamjenu stezaljki uzorka, a da nije potrebno obavljati izmjenu opreme. Antistatički materijali olakšavaju čišćenje. Može se naknadno ugraditi u sve rotacijske mikrotome serije HistoCore.

Tehnički podaci:

Vrijeme predhlađenja do početka rada: 30 minuta

Temperatura: 20 K ispod temperature okoline

Raspon temperature okoline: +10 °C do +35 °C

Relativna vлага: maks. 80 %, bez kondenzacije

Težina: pribl. 650 g

Dimenzije (Š x V x D): 80 x 114 x 204 mm

Ulaz struje: 100 - 240 V / 50/ 60 Hz

Certifikati: CE, c_CSA_US

Standardni obim isporuke:

Stezaljka RM CoolClamp

Napajanje preko kabala i 4 adaptera (UK, SAD, EU, AUS)

5 stezaljki kabala

Upute za upotrebu i DVD

- Br. narudžbe: 14 0502 46573

**Savjeti**

Stezaljka RM Coolclamp ne može se upotrebljavati s mikroskopom ili povećalom.

Povećalo

Sl. 73

za postavljanje na nosače mikroskopa (14 0502 40580),
uvećanje 2x

Napomena:

Povećalo uključuje adapter za držanje opciskog LED svjetla

- Br. narudžbe: 14 0502 42790

Univerzalni nosač mikroskopa

Sl. 74

Univerzalni sklop

- Br. narudžbe: 14 0502 40580

Pozadinsko osvjetljenje

Sl. 75

Napomena:

Za aparate HistoCore BIOCUT i MULTICUT samo s vanjskim utorom napajanja 14 0500 31244.

Pozadinsko osvjetljenje ne može se upotrebljavati sa super velikom kasetnom stezaljkom 14 0502 38967.

- Br. narudžbe: 14 0502 38719

Jedinica vanjskog napajanja



Sl. 76

Za upotrebu s pozadinskim osvjetljenjem 14 0502 38719,
za rotacijske mikrotome serije HistoCore BIOCUT i MULTICUT

Uključeni su sljedeći adapteri:

Ujedinjeno Kraljevstvo, Europa, SAD/Japan, Australija

- Br. narudžbe: 14 0386 31352

Gornja ladica



Sl. 77

Za rotacijske mikrotome serije HistoCore

- Br. narudžbe: 14 0517 56261

Ladica za otpad pri sekcioniranju



Sl. 78

Za rotacijske mikrotome serije HistoCore

- Antistatička ladica za otpad nakon reza
Br. narudžbe: 14 0517 56237

Četka

Sl. 79

S magnetom alata za skidanje oštrice za držać oštrice dva u jednom E.

- Br. narudžbe: 14 0183 40426

Zaštitne rukavice

Sl. 80

Veličina M, 250 ± 20 mm, žute

- Br. narudžbe: 14 0340 29011

Zaštitne rukavice otporne na rezove, veličina S, 250 ± 20 mm

- Br. narudžbe: 14 0340 40859

6.10 Informacije o naručivanju

Postolje držaća noža	14 0502 37962
Držać noža N	14 0502 37993
Držać noža E, niskoprofilni, sa žlijebom	14 0502 38961
Postolje držaća oštrice	14 0502 55546
Držać oštrice tipa "dva u jednom" E	14 0502 54497
Oštrice koje se mogu skidati – niskoprofilne, 1 paket od 50 (80 x 8 x 0,25 mm)	14 0358 38925
Oštrice koje se mogu skidati – niskoprofilne, 10 paketa od 50	14 0358 38382
Oštrice koje se mogu skidati – visokoprofilne, 1 paket od 50 (80 x 14 x 0,35 mm)	14 0358 38926
Oštrice koje se mogu skidati – visokoprofilne, 10 paketa od 50	14 0358 38383
Nož duljine 16 cm – profil c – čelični	14 0216 07100
Nož duljine 16 cm – profil d – čelični	14 0216 07132
Univerzalna kasetna stezaljka	14 0502 37999
Standardna stezaljka uzorka 50x55 mm	14 0502 38005
Standardna stezaljka uzorka 40x40 mm	14 0502 37998
Pričvršćenje stezaljke uzorka s usmjeravanjem	14 0502 38949
Kruto pričvršćenje stezaljke uzorka	14 0502 38160

Pričvršćenje stezaljke uzorka s preciznim usmjeravanjem	14 0502 37717
Brostezni sustav	14 0502 37718
Super velika kasetna stezaljka	14 0502 38967
Stezaljka RM CoolClamp	14 0502 46573
Povećalo	14 0502 42790
Univerzalni nosač mikroskopa	14 0502 40580
LED reflektor 1000 Hi-Power, s 2 kraka (Ovaj modul može raditi samo s upravljačkom jedinicom LED 1000, Br. narudžbe: 14 6000 04825.)	14 6000 04826
Upravljačka jedinica LED 1000 (Ovaj modul može raditi samo s LED reflektrom 1000 Hi-power, s 2 kraka, Br. narudžbe: 14 6000 04826.)	14 6000 04825
Pozadinsko osvjetljenje (Pozadinsko osvjetljenje može se upotrebljavati samo s postoljem držača noža Br. narudžbe: 14 0502 37962.)	14 0502 38719
Sklop vanjskog napajanja	14 0500 31244
Gornja ladica	14 0517 56261
Antistatička ladica za otpad	14 0517 56237
Četka s magnetom	14 0183 40426
Zaštitne rukavice, veličina M	14 0340 29011
Zaštitne rukavice, veličina S	14 0340 40859

Više podataka o potrošnom materijalu potražite na mrežnom katalogu proizvoda na našem web-mjestu www.LeicaBiosystems.com.

7. Uklanjanje pogrešaka

U sljedećoj tablici su navedeni najčešći poznati problemi, koji mogu nastati za vrijeme rada s uređajem, zajedno s mogućim uzrocima i postupkom njihova rješavanja.

7.1 Moguće pogreške

Problem	Mogući uzrok	Korektivna radnja
Debeli/tanki naresci Kod rezova postoje naizmjence tanki i deblji rezovi ili drhtaji pri rezovima ili se uzorak istrgne iz uležištenja. U ekstremnim slučajevima uopće nema rezova.	<ul style="list-style-type: none"> Oštrica, držać noža ili orijentacija nisu dovoljno stegnuti. Uzorak nije pravilno zategnut. Uzorak nije pravilno zategnut. Oštrica je tupa. Potisna ploča je oštećena ili nepravilno namještena. Premali kutni zazor noža/oštrice. Parafin se nije dovoljno stisnuo za ove uvjete. 	<ul style="list-style-type: none"> Ponovno zategnite oštricu, držače noževa ili orijentaciju. Provjerite je li kasetna čvrsto zategnjuta u univerzalnoj kasetnoj stezaljci. Ako je univerzalna kasetna stezaljka zaprljana parafinom, očistite je (→ str. 73 – 8.1 Čišćenje aparat). Pri upotrebi kasete s oblikom prilagođenim poklopcem provjerite dozvoljava li rub odlamanja stabilno stezanje kasete; po potrebi, uklonite šav ili zategnite kasetu vodoravno, a ne okomito u univerzalnu kasetnu stezaljku. Ako su dimenzije kasete u navedenim tolerancijama, a kasetna stezaljka možda pogrešno namještena odnosno neispravna. U tom slučaju prepustite provjeru i ponovno namještanje univerzalne kasetne stezaljke tehničkoj službi. Prilikom upotrebe kasete, posebice kasete s tankom stijenkicom, marke koja nije Leica Biosystems, kasetna stezaljka možda pogrešno namještena odnosno neispravna. U tom slučaju utvrđi da ona nije stabilno pričvršćena, valja koristiti alternativnu zateznu stezaljku. Bocno pomaknite držać noža/oštrice ili umetnите novi nož/oštricu. Umetnute novu potisnu ploču ili upotrijebite novi držać noževa dva u jednom. Ponovno namjestite potisnu ploču. Sustavno isprobajte nekoliko podešavanja kutnog zazora, dok ne pronađete optimalan kut. Primijenite višu točku topljenja parafina ili rashladite sklop.


Sabijanje rezova Rezovi su jako sabijeni, na njima ima pregiba ili su stisnuti zajedno.	<ul style="list-style-type: none"> Oštrica je tupa. Uzorak je previše zagrijan. Prevelika brzina rezanja. 	<ul style="list-style-type: none"> Upotrijebite drugo područje oštice ili novu oštricu. Uzorak ohladite prije rezanja. Smanjite brzinu rezanja.
"Trake" u rezovima za držač oštice dva u jednom E	<ul style="list-style-type: none"> Na stražnjoj potisnoj ploči držača noža nakupio se parafin. Retrakcija nije odabrana. Kutni je zazor preoštar, gotovo nula stupnjeva. Na reznoj oštici ima porezotina. 	<ul style="list-style-type: none"> Redovito uklanjajte parafin iz tog područja. Uključite funkciju retrakcije. Namjestite kutni zazor. Zamijenite oštricu.
Zvukovi tijekom rezanja Nož škripi pri rezanju tvrdih uzoraka. Rezovi pokazuju ogrebotine odnosno znakove oštećenja.	<ul style="list-style-type: none"> Prevelika brzina rezanja. Kutni je zazor prevelik. Nedovoljno zategnut uzorak i/ili držač noža. Retrakcija je isključena tijekom rezanja umetnutih uzoraka smole/plastike. Primjenjuje se prevelika sila rezanja. Preoštar kutni zazor. 	<ul style="list-style-type: none"> Polako okrenite ručni kotač. Sustavno smanjujte kutni zazor dok se ne dobije optimalan kut. Provjerite sve vijke i spojeve sa stezaljkama na sustavu držača objekta i držaču noža. Prema potrebi pritegnite polugice i vijke. Uključite retrakciju. Namjestite brzinu rezanja i/ili debljinu nareska prilikom podrezivanja. Odaberite manju debljinu reza, sporije pomičite ručni kotač. Namjestite kutni zazor.
Velika potrošnja oštice		

7.2 Neispravnosti aparata


Problem	Mogući uzrok	Korektivna radnja
Više nema pomaka umetanja, a time ni rezanja.	<ul style="list-style-type: none"> Dosegnut je krajnji prednji položaj. 	<ul style="list-style-type: none"> Pomaknite uzorak unatrag okretanjem kotača grubog umetanja.

7.3 Neispravnosti držača oštice dva u jednom E

7.3.1 Zamjena potisne ploče

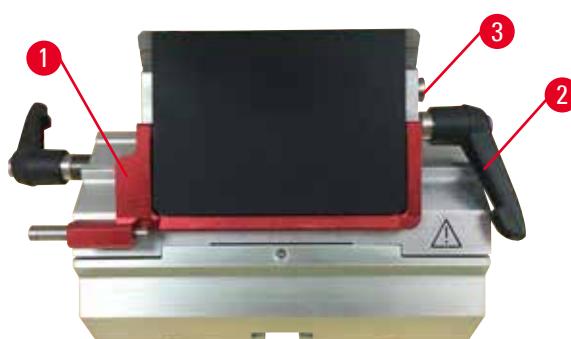

Sl. 81

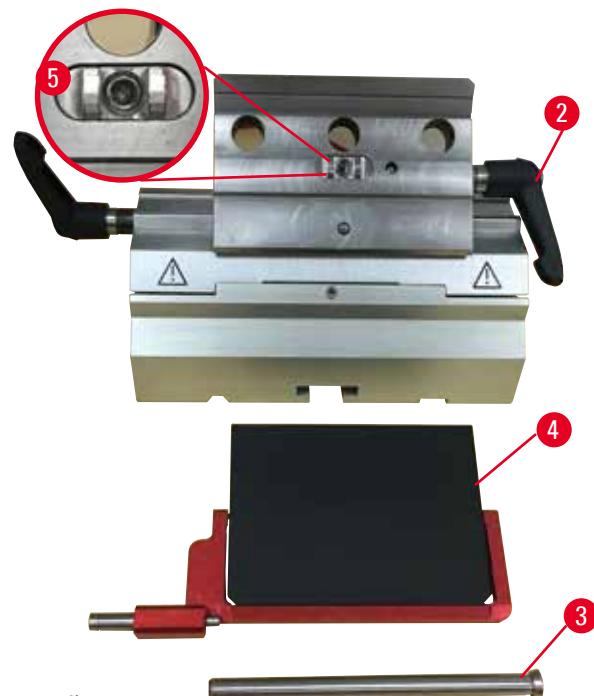

Sl. 82

1. Spustite sigurnosni štitnik (→ "Sl. 81-1").
2. Steznu polugicu okrenite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu (→ "Sl. 81-2").
3. Izvucite vijak (→ "Sl. 81-3") (→ "Sl. 82-3").
4. Skinite oštećenu potisnu ploču (→ "Sl. 82-4").




Savjeti

Provjerite je li umetak steznog vrha postavljen kako je prikazano (→ "Sl. 82-5"), ako slučajno pada. Ako nije pravilno postavljen, potisna se ploča ne može stegnuti.

5. Postavite novu potisnu ploču.
6. Umetnute vijak (→ "Sl. 82-3").
7. Okrenite steznu polugicu u smjeru kazaljke na satu (→ "Sl. 82-2").


7.3.2 Postavljanje steznog vrha na luk segmenta

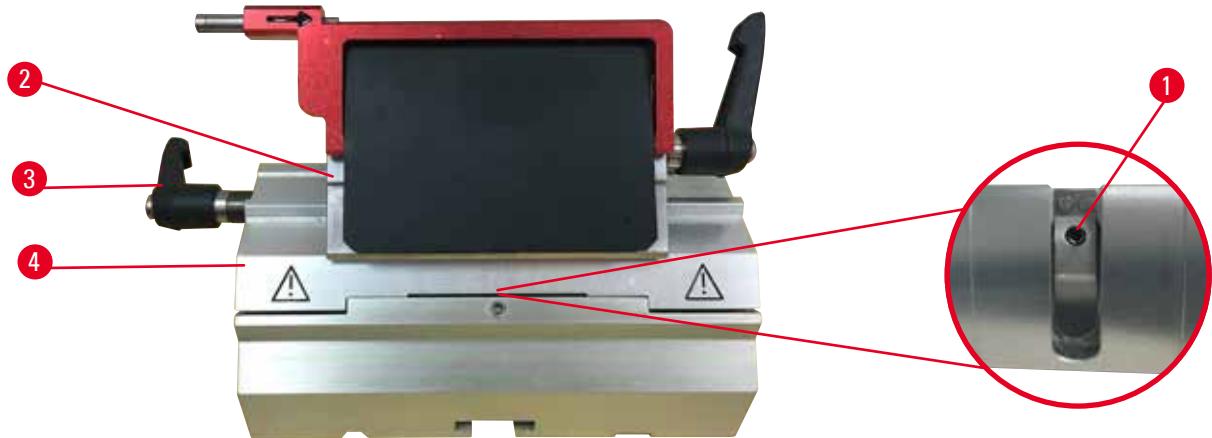

Sl. 83

Da biste osigurali dobre rezultate rezanja, stezni se vrh (→ "Sl. 83-2") mora čvrsto zategnuti na luk segmenta (→ "Sl. 83-4"). Zatezanje se obavlja pomoću ekscentrične polugice (→ "Sl. 83-3"). Sila zatezanja namješta se pomoću navojnog klinja (→ "Sl. 83-1") ispod luka segmenta. Namještanje zatezanja obavlja se tako da se stezna polugica može okretati do graničnika uz neprestano rastući otpor. Namjestite zatezanje pomoću imbus ključa veličine 2,5 mm na navojnom klinu (→ "Sl. 83-1") tako da polugica u početku klizne kada se ona uključi. Nastavite još malo okretati navojni klin (→ "Sl. 83-1") (približno za 1/4 okretaja ulijevo ili udesno) tako da polugica više ne klizi, već da se čvrsto zaglavi.

7.4 Postavljanje zateznog sustava nosača stezaljke na podnožju

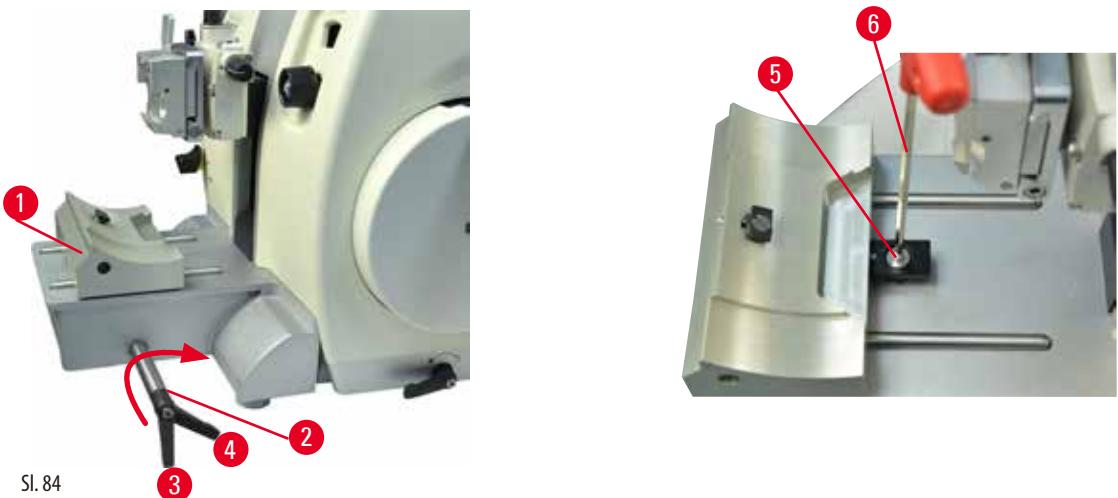

Sl. 84

Udaljenost zatezanja od ekscentričnog vijka do 270° postavite na sljedeći način.

1. Postavite postolje držača noža (→ "Sl. 84-1") na podnožje aparata.
2. Namjestite tako da zavijete ili odvijete vijak s upuštenom glavom (→ "Sl. 84-5") na stezni dio na podnožju pomoću imbus ključa veličine 3 (→ "Sl. 84-6"), tako da se ekscentrični vijak (→ "Sl. 84-2") može zategnuti u položaju 0° (→ "Sl. 84-3") i položaju 270° (→ "Sl. 84-4").

8. Čišćenje i održavanje

8.1 Čišćenje aparata



Upozorenje

Tekućine ulaze u unutrašnjost aparata.

Ozbiljne ozljede aparata/ljudi ili oštećenje imovine.

- Provjerite da tekućine ne ulaze u unutrašnjost aparata prilikom rada i održavanja.



Upozorenje

Nož/oštrica nije skinut kada je držač noža/oštrice skinut s mikrotoma.

Ozbiljne ozljede ljudi zbog doticaja s iznimno oštrim nožem/oštricom.

- Prije skidanja držača noža/oštice s mikrotoma, nož/oštricu uvijek odvojite dok nosite rukavice otporne na rezove i nož/oštricu odložite na sigurno mjesto.



Upozorenje

Nož/oštrica spremlijen je na neodgovarajući način.

Ozbiljne ozljede ljudi, primjerice zbog neočekivanog pada.

- Nož/oštricu uvijek odlažite na odgovarajuće mjesto kada ih ne upotrebljavate: odložite ga, na primjer, u posebnu kutiju za noževe.
- Nož nikada nemojte postavljati s reznom oštrom okrenutom prema gore i nikada nemojte pokušati uhvatiti nož u padu.



Upozorenje

Držač noža/oštice isпадa s aparata.

Ozbiljne ozljede ljudi i/ili oštećenje imovine.

- Ako držač noža/oštice nije pričvršćen, prilikom postavljanja ili čišćenja, osobito pazite da držač noža/oštice ne isпадa.
- Kada god je moguće, pričvrstite držač noža/oštice da biste izbjegli ispadanje.



Oprez

Upotreba neodgovarajućih otapala ili sredstava za čišćenje ili oštih/tvrdih predmeta za čišćenje aparata ili dodatnog pribora.

Moguća neispravnost aparata ili kašnjenje kod postavljanja dijagnoze.

- Za čišćenje nemojte upotrebljavati otapala koja sadrže aceton ili ksilen.
- U slučaju upotrebe sredstava za čišćenje, pridržavajte se sigurnosnih uputa proizvođača i laboratorijskih sigurnosnih odredbi.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštре ili tvrde predmete za grebanje površine aparata.
- Dodatni pribor nikada nemojte potapati ni u koje otapalo za čišćenje ili vodu.
- Čelične noževe čistite otapalima na bazi alkohola ili acetonom.
- Za čišćenje i uklanjanje parafina nemojte upotrebljavati ksilen ili tekućine za čišćenje koje sadrže alkohol (na primjer sredstvo za čišćenje stakla).



Napomena

Pribor i dijelovi uređaja će korodirati ako se na njega nanose korozivni/jako kiseli/alkalni reagensi ili otapala kao što su kisele dekalcificirane otopine, alkalni amonijev hidroksid, itd.

Pribor zbog toga može neispravno raditi.

- Ne dopustite da korozivni/jako kiseli/alkalni reagens ili otapalo kaplje po instrumentu ili po priboru.
- Ako takav reagens ili otapalo kane po instrumentu ili po priboru, obrišite ga i posušite što je prije moguće.
- Ako se takav reagens ili otapalo često koristi, obavezno svakodnevno temeljito očistite držaća oštice, univerzalnu kasetnu stezaljku (UCC) i ostali pribor ako je potrebno.

Prije svakog čišćenja provedite sljedeće pripremne korake:

- Podignite stezaljku uzorka u krajnji gornji položaj i uključite mehanizam za zabravljenje ručnog kotača.
- Uklonite oštricu iz držaća oštice i umetnite je u spremnik na dnu kutije ili izvadite nož iz držaća noža i vratite ga u kutiju za noževe.
- Uklonite postolje držaća noža i držaća noža radi čišćenja.
- Uklonite uzorka iz stezaljke uzorka.
- Otpad rezanja uklonite suhom četkom.
- Uklonite stezaljku uzorka i odvojeno je očistite.

Aparat i vanjske površine

Da biste uklonili ostatke parafina, nadomjeske ksilena, parafinsko ulje ili parafin, možete upotrijebiti sredstva za uklanjanje parafina. Aparat mora biti potpuno suh prije ponovne upotrebe.




Upozorenje

Brisanje noža u netočnom smjeru prilikom čišćenja.

Ozbiljne ozljede ljudi.

- Nož uvijek brišite od stražnjeg dijela noža prema reznoj oštrici.

Držač oštice dva u jednom E

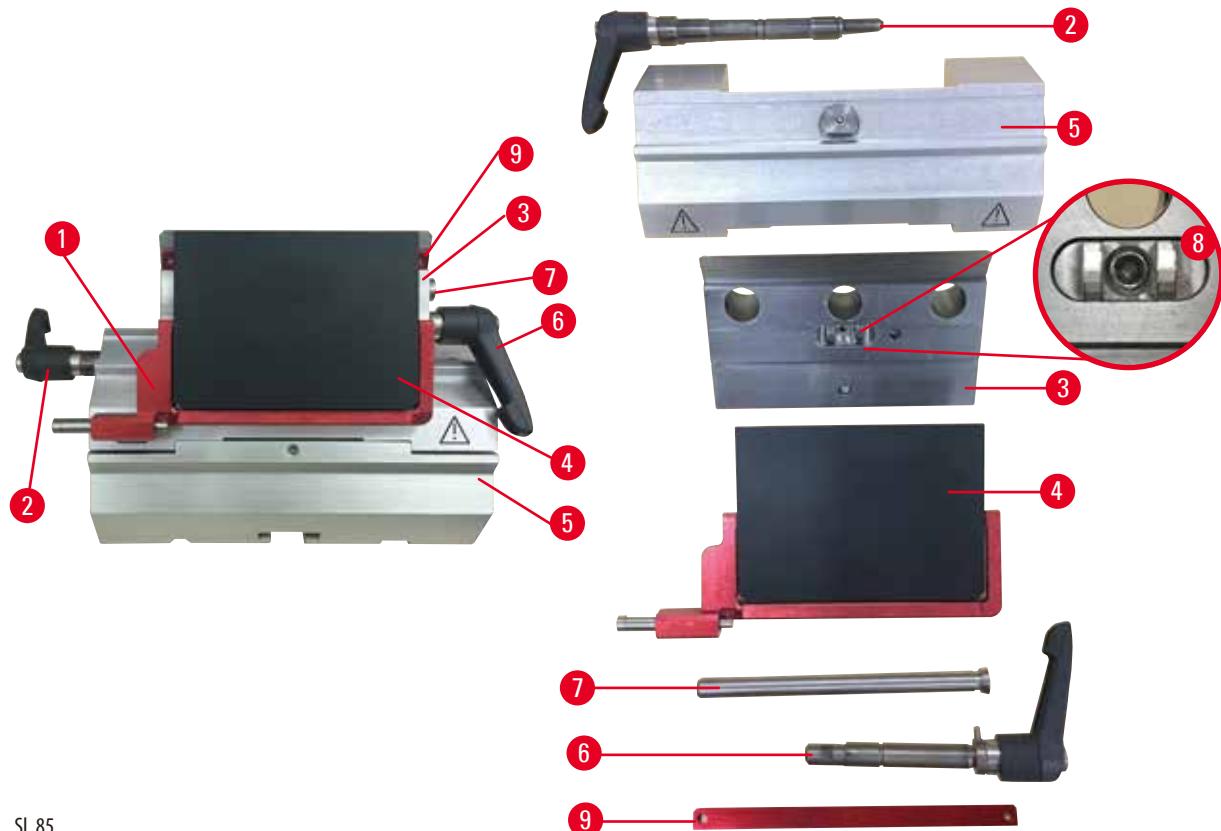

1. Uklonite umetak ([→ "Sl. 85-9"](#)) za niskoprofilne oštice.
2. Uklonite potisnu ploču ([→ "Sl. 85-4"](#)) sa steznog vrha. Da biste to napravili, okrećite steznu polugicu oštice ([→ "Sl. 85-6"](#)) u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu i izvucite je na stranu; izvucite vijak ([→ "Sl. 85-7"](#)) i skinite potisnu ploču.
3. Skinite stezni vrh. Da biste to napravili, okrećite steznu polugicu ([→ "Sl. 85-2"](#)) bočnog pomaka u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu i izvucite je na stranu; gurnite stezni vrh ([→ "Sl. 85-3"](#)) sve dok se više ne može pomaknuti s luka segmenta ([→ "Sl. 85-5"](#)).
4. Otpustite ekscentrični vijak imbus ključem veličine 4 i uklonite luk segmenta s postolja držača oštice.
5. Očistite sve dijelove držača oštice dva u jednom E.

**Oprez**

Tijekom čišćenja pomiješani su dijelovi držača oštice.

Loša kvaliteta reza.

- Nemojte miješati držače oštice prilikom čišćenja.

6. Skinute dijelove složite na upijajuću krpnu u komoru za sušenje (do maks. 65 °C) i pustite da odu ostaci parafina.



Upozorenje

Tijekom čišćenja držača noža/oštice dijelove izvadite iz komore za sušenje (65 °C).

Opasnost od opekotina.

- Nosite rukavice za zaštitu od topline prilikom vađenja dijelova iz komore za sušenje (65 °C).


7. Obrišite držač oštice dva u jednom E i omogućite da se ohladi na sobnu temperaturu pa ga ponovno sastavite.
8. Nakon čišćenja pomicne dijelove držača noža dva u jednom E podmažite uljem za pogonske dijelove u tankom sloju.
9. Prilikom postavljanja potisne ploče (→ "Sl. 85-4"), provjerite je li stezni vrh pravilno postavljen na prikazani način (→ "Sl. 85-8") i je li gornji rub potisne ploče paralelan s i na razini stražnjeg ruba steznog vrha (→ "Sl. 85-3").



Savjeti

Ako umetak steznog vrha nije pravilno postavljen, potisna se ploča ne može stegnuti.

Univerzalna kasetna stezaljka

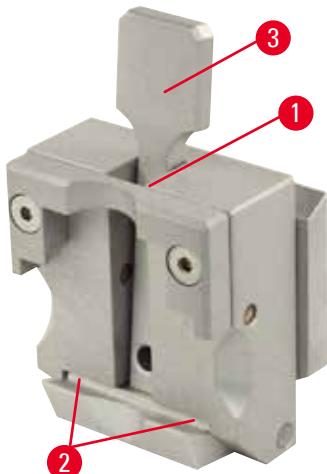

Sl. 86

- Odvojite kasetnu stezaljku (→ "Sl. 86-1") radi temeljitog čišćenja i uklanjanja svih ostataka parafina.
- Za čišćenje nemojte upotrebljavati ksilen. Upotrijebite nadomjeske ksilena ili sredstva za uklanjanje parafina.
- Kasetna stezaljka (→ "Sl. 86-1") također se može postaviti u komoru zagrijanu na najviše 65 °C, sve dok parafin ne ishlapi.
- Ostatke parafina uklonite suhom krpom.
- Nakon takvog postupka čišćenja u komori, obvezno uvijek podmažite spiralne opruge (→ "Sl. 86-2") potisne polugice (→ "Sl. 86-3"). Pustite da se kasetna stezaljka do kraja ohladi prije no što je ponovno postavite na aparat.

8.2 Upute za održavanje



Savjeti

Popravak aparata i pristup njegovim unutarnjim sastavnim dijelovima dopušten je isključivo kvalificiranom servisnom osoblju!

Aparat u pravilu ne treba održavati.

Za osiguranje rada aparata bez poteškoća tijekom duljeg vremena tvrtka Leica Biosystems preporučuje:

1. Svakodnevno temeljito očistiti aparat.
2. Potpišite ugovor o servisiranju barem po isteku jamstva. Dodatne informacije o tome potražite u lokalnom tehničko-servisnom centru Leica Biosystems.
3. Kvalificirani tehničar kojeg je ovlastila tvrtka Leica Biosystems neka redovito pregledava aparat. Intervali ovise o učestalosti korištenja uređaja.

Preporučujemo sljedeće intervale ovisno o općem radno opterećenju aparata kao što je određeno u dvjema kategorijama u tablici:

Kategorija I	Kategorija II
Broj rezova dnevno: > 8.000 rezova dnevno	< 8.000 rezova dnevno
Opterećenje (sati dnevno): > 5 sati dnevno	≤ 5 sati dnevno
Brzina rezanja: Uglavnom velika brzina rezanja	Mala do srednja brzina rezanja
Materijal uzorka: Rad s mekim i tvrdim uzorcima	Uglavnom meki materijali uzoraka
Održavanje: Svakih 12 mjeseci	Svaka 24 mjeseca

8.3 Podmazivanje aparata

Jednom mjesечно podmažite sljedeće dijelove s uključenim pogonskim uljem (dovoljne su 1 – 2 kapi).




Upozorenje

Ulje se proljeva i ne čisti se odmah.

Ozbiljne ozljede ljudi, primjerice zbog proljevanja i doticaja s opasnim dijelovima kao što su nož/oštrica aparata.

- Uvijek pazite da se ulje ne prolijeva.
- Ako se ulje prolije, odmah ga očistite, u potpunosti i do kraja.

Aparat

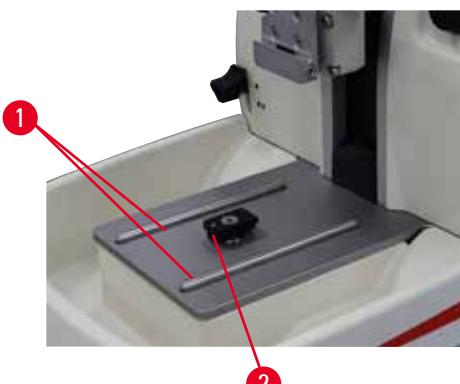


Sl. 87

- Vodilice (→ "Sl. 87-1") za postolje držača noževa podnožja mikrotoma.
- Dio u obliku slova T (→ "Sl. 87-2") na podnožju mikrotoma.

Držač oštice dva u jednom E

Sl. 88

- Stezna polugica (→ "Sl. 88-1") za bočno pomicanje.
- Stezna polugica (→ "Sl. 88-2") za oštricu.

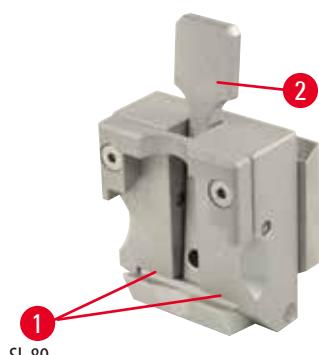Univerzalna kasetna stezaljka

Sl. 89

Podmažite spiralne opruge (→ "Sl. 89-1") potisne polugice (→ "Sl. 89-2") i pomaknite je nekoliko puta naprijed – natrag.

9. Jamstvo i servis

9.1 Jamstvo

Leica Biosystems Nussloch GmbH jamči da je ugovoreni proizvod isporučen sukladno ugovoru prošao sveobuhvatne kontrole kvalitete sukladno standardima ispitivanja tvrtke Leica Biosystems te je kao takav bez kvarova i sukladan svim tehničkim specifikacijama i/ili ugovorenim zajamčenim karakteristikama.

Obim jamstva temelji se na sadržaju zaključenog ugovora. Vrijede isključivo uvjeti jamstva vaše prodajne organizacije Leica Biosystems ili organizacije od koje ste ugovorni proizvod kupili.

9.2 Servisne informacije

Ako vam je potrebna tehnička korisnička podrška ili zamjenski dijelovi, обратите se prodajnom predstavniku ili distributeru tvrtke Leica Biosystems koji vam je proizvod prodao.

Pritom navedite sljedeće informacije:

- Naziv modela i serijski broj aparata.
- Mjesto gdje se aparat nalazi i osobu za kontakt.
- Razlog pozivanja servisa.
- Datum isporuke.

9.3 Povlačenje iz uporabe i zbrinjavanje

Aparat i dijelovi aparata moraju se zbrinuti u skladu s postojećim važećim lokalnim zakonskim propisima.

10. Potvrda o dekontaminaciji

Svaki proizvod koji se vraća tvrtki Leica Biosystems ili mu treba održavanje na licu mjesta treba temeljito očistiti i dekontaminirati. Poseban predložak potvrde o dekontaminaciji potražite na našem web-mjestu www.LeicaBiosystems.com u izborniku proizvoda. Taj predložak mora se upotrebljavati za prikupljanje svih potrebnih podataka. Prilikom vraćanja proizvoda kopiju ispunjene i potpisane potvrde treba priložiti uz aparat ili predati servisnom tehničaru. Za proizvode poslane bez ove potvrde ili s nepotpunom potvrdom odgovoran je pošiljatelj. Vraćena roba koju tvrtka smatra potencijalnom opasnošću šalje se nazad o trošku i na rizik pošiljatelja.

www.LeicaBiosystems.com

